

San Lorenzo Valle, 18 de Junio 2020.

Licenciada

Lesly Barahona Vivas

Jefe de la Unidad de Transparencia Secretaria de Salud
Su Oficina

Estimada Licenciada Barahona,

Adjunto a la presente el reporte de las compras efectuadas en el Hospital San Lorenzo para atender emergencia decretada por el Presidente de la Republica ante el COVID-19.

Las compras que se reportan fueron financiadas con presupuesto del convenio anual de gestión suscrito con la Secretaria de Salud para el año 2020; el Hospital San Lorenzo ya cuenta con fondos externos para realizar la compra de insumos y contratación de personal sin embargo estos los procesos no están contemplados en el plan aprobado con fondos externos en la Secretaria de Salud por lo antes expuesto estas compras fueron financiadas por fondos nacionales.

- Contratación de personal: Se contrató personal asistencial y técnicos de laboratorio por servicios profesionales a partir del 18 de mayo, pagos que serán reportados en la semana del 25 de junio 2020.
- Licitaciones Públicas y Privadas: No se han realizado a la fecha.
- Compras Menores: Se adjunta el reporte de las compras efectuadas según orden de compra No. 181-2020, 182-2020 y 183-2020, se adjunta documentos respaldo.
- Contrataciones de Servicios: Se contrató servicio de transporte contrato vence el 11 de junio se reportará en la semana del 25 de junio 2020.
- Donaciones: Se recibió una donación del Estado Mayor conjunto, se adjunta documentos respaldo.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,


Miriam Reyes



Gestión Financiera Hospital San Lorenzo

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	OP-318-2020	AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD No.
		AD0001-66014
A FAVOR DE:	GRUPO MEY-KO S.A.	
VALOR	L.	5,750.00
EN LETRAS:	Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	99	FUENTE	11	CUENTA	01424551	SUBCUENTA	7028695
TIPO DE PAGO	CHEQUE	EMITIR					
	TRANSFERENCIA						
DESCRIPCION							
DESCRIPCION	PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 181-2020 (PAGO CONTRA ENTREGA, SOLO SE COMPRARA LOS ESFIGNOMANOMETROS YA QUE NOTIFICARON QUE LOS MANOMETROS NO TIENEN EN EXISTENCIA)						
OBJETO DE GASTO	VALOR						
42400	L. 5,000.00						
ISV	L. 750.00						
TOTAL	L. 5,750.00						

VALOR EN LETRAS

Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos

FECHA: 11/6/2020

Lic. Miriam Reyes
Gestion Financiera

Anulacion de Cheques

Monica Maria Henriquez Rojas <monica.henriquez@fichosa.com>
Para: Mirian Reyes <mreyes@hospitalsanlorenzo.com>
CC: Angel Edgardo Sanchez Cruz <angel.sanchez@fichosa.com>

10 de junio de 2020 a las 12:50

Hola Angel

Su ayuda con lo solicitado.

Saludos

El mié., 10 jun. 2020 a las 9:01, Mirian Reyes (<mreyes@hospitalsanlorenzo.com>) escribió:
Buenos días Monica,

Favor su autorizacion para aceptar en deposito a la cuenta de Fideicomiso No. 7028695 los siguientes cheques:

Cheque No. 01996013 Grupo Meyko L. 33,749.97
Cheque No. 01957479 Equipos Industriales L. 234,786.88

Lo anterior debido a que no podrán entregar el producto solicitado.

Saludos,



Mónica Henríquez
Ejecutivo Sr | Fideicomiso
Banco Fichosa
monica.henriquez@fichosa.com
Tel (504) 2239-6410, Ext. 1138

*****AVISO LEGAL*****

La informacion contenida en este mensaje es privilegiada y confidencial y esta dirigida exclusivamente para la persona a la que va dirigido. No hay renuncia a los derechos de confidencialidad o privilegio por cualquier transmision mala o erronea. Si el lector de este mensaje no es el receptor para el que va dirigido, por este medio se le notifica que cualquier diseminacion, distribucion o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida.

Si usted ha recibido esta comunicacion por error por favor contacte al remitente mediante reenvio de este correo y destruya su original y todas las copias del mensaje original. Usted No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o reproducir ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier opinion expresada en este mensaje proviene del remitente como individuo, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente esta autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de cualquiera de las companias miembro de GFF (Grupo Financiero Fichosa). Notese que el correo electronico via Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los Mensajes que se transmiten ni la correcta recepcion de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilizacion del correo electronico via Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

*****DISCLAIMER*****

The information contained in this e-mail message is privileged and confidential and is intended exclusively for the use of person named above. No confidentiality or privilege rights are waived by any mistransmission. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this e-mail message is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please contact the sender by reply E-mail and destroy its original and all copies of the original message.

Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or reproduce any part of this message if you are not the intended recipient. Any opinions expressed in this message are those of the individual sender, except when the message states otherwise and the sender is authorized to establish such opinions as those issued by any of the companies members of GFF (Grupo Financiero Fichosa). Please note that Internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the proper receipt of the message sent. If the addressee of this message does not consent the use of e-mail by internet, please inform it to us immediately.

Movimientos Histórico

RESUMEN DE LA CUENTA

Cuenta	0-0-7028695	Titular	BANCO FICOMSA
Fecha Inicial	10-06-2020	Fecha Final	10-06-2020
Saldo Promedio Mes Anterior (05/2020)		Saldo Día Anterior	26,857,172.55
Saldo Sobregiro/UFR/AE	0.00		

Haga click en la columna de descripción para imprimir la nota

Fecha	Descripción	No. Doc.	No. Ref.	Debitos	Creditos	Saldo
10/06/2020	Deposito de	1957479	TT201628JB6K		234,786.86	27,091,959.43
	Cheque					
10/06/2020	Deposito de	1996013	TT201620TW08		33,749.97	27,125,709.40
	Cheque					
	Totales			0.00	268,536.83	

Anulación cheque anterior

* Los movimientos recientes y del día los puede consultar en la opción Consulta de Movimientos Recientes.

--	--	--

NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. OC-181-2020

9 de junio de 2020 a las 14:48

Alan Nuñez <operaciones.demh@grupomeyko.hn>

Para: Danamy Lopez <dlopez@hospitalsanlorenzo.com>

CC: Mirian Reyes <mreyes@hospitalsanlorenzo.com>, Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>, Ada Sanchez <asistenteproyectos@grupomeyko.hn>, Valeria Sabillon <valeria.sabillon@grupomeyko.hn>, Juan Ramón Osorio <josorio@hospitalsanlorenzo.com>, Rosa María Cárcamo <rcarcamo@hospitalsanlorenzo.com>, Claudia Torres <ctorres@hospitalsanlorenzo.com>, María Amparo Leiva <mleiva@hospitalsanlorenzo.com>

Buen día Dra. Lopez,

Si, los esfigmomanómetros si están disponibles y voy a solicitar que me los entreguen para asegurarlos físicamente.

Quedo atento.

Saludos,

Alan N.

[Texto citado oculto]

Fecha Limite de Emision

21/01/2021

No. Factura 000-002-01-00008732

Documento SAP: 1100010502

Fecha 12/06/2020 2:25 p.m.

Condición de pago

Empleado de ventas

Orden de compra

Contado T01

TGU- Alan Nuñez

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Darío, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN
RTN:08019002062818

CAI:BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA

Rango:8001 - 10000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCL-0078

17099010303801 FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
7762	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE SENCILLO ADULTO Economico- ADC	MS-LMC1	10	*500.00	0.00	5,000.00

*Producto exento

Total:cinco mil setecientos cincuenta lempiras 00/100

Observaciones

RTN: 17099010303801 Basado en Pedidos de cliente 1000013135.

Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Total Gravado:	5,000.00
Descuentos y Rebajas	0.00
ISV 15%:	750.00
ISV 16%:	0.00
Total LPS.	5,750.00

Devoluciones:

- *Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado.
- *No se aceptan devoluciones sin facturas, tiempo de devolución es de 4 días hábiles.
- *Producto esteril debe estar completamente sellado.
- *Cheque devuelto se cobrara Lps. 1,000.00
- *Factura de crédito pagada después de la fecha de vencimiento, se cobrara 5% de recargo.

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Grupo MEY-KO

Cliente

HOSPITAL SAN LORENZO	
ALMACEN	
RECEPCIONARIO	
Fecha	12-06-2020
Firma y Sello	


ACTA DE RECEPCION

Por este medio, hacemos constar que hemos recepcionados de la Empresa : "GRUPO MEY-KO S.A." los bienes y/o servicios que fueron adquiridos mediante Orden de Compra No. 181-2020 ,Según Factura No.000-002-01-00008732 que se detallan a continuación:

Nº	DESCRIPCION	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD ENTREGADA UNIDAD
1	Esfigmomanómetro Manual para paciente adulto (Esfigmomanómetro anerode sencillo de adulto).Marca: ADC Modelo 766Z	Unidad	10
2	UL.....		
3			

Los bienes y/o servicios, antes descritos han sido previamente verificados, se encuentran físicamente en buen estado y han sido recibidos con satisfacción, por lo cual se firma la presente acta de recepción en, San Lorenzo Valle, a los ____12____ días del mes de ____Junio____ del año 2020

Recibi conforme: _____

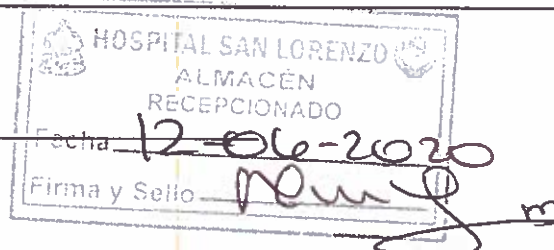



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9438

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO MEY-KO ,S.A.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002062818**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9438 en fecha 22/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25716155866 de fecha 18/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/05/2020 hasta 20/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9438** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002062818

Nombre o Razón Social: GRUPO MEY-KO, S.A.

Nombre Comercial: GRUPO MEY-KO, S.A.

Teléfono: 22323544 94819699

Email: contabilidad@grupomeyko.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA RUBEN DARIO,
CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA RUBEN
DARIO, PRINCIPAL, No. S/N,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00008732

Fecha de Autorización: 21/01/2020

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/01/2021

CAI: BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00008001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00010000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn



RECIBO

REFERENCIA SAP

40 5441

FECHA:

12-junio 2020

5,750.00

RECIBI DE:

Fundación de Apoyo al Hospital

LA CANTIDAD DE:

Cinco mil setecientos cincuenta lempiras

POR CONCEPTO DE:

Pago de factura #

000-002-01-00008732

R.T.N. 00019003002318

SALDO ANTERIOR LPS.		
ABONO LPS.		
SALDO ACTUAL LPS.		

CHEQUE ☒	EFFECTIVO ☐
NO. 1996025	
BANCO Ficobsa	

Oda



CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01996025

AGN SAN LORENZO SLO
Lugar y Fecha

11 JUNIO
2020

*GRUPO MEYKO SA

Páguese a la orden de

* Cinco mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

L *****5,750.00

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆01996025

NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. OC-181-2020

Alan Nuñez <operaciones.demh@grupomeyko.hn>

8 de junio de 2020 a las 19:09

Para: Danamy Lopez <dlopez@hospitalsanlorenzo.com>

CC: Mirian Reyes <mreyes@hospitalsanlorenzo.com>, Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>, Ada Sanchez <asistenteproyectos@grupomeyko.hn>, Valeria Sabillon <valeria.sabillon@grupomeyko.hn>, Juan Ramón Osorio <josorio@hospitalsanlorenzo.com>, Rosa María Cárcamo <rcarcamo@hospitalsanlorenzo.com>, Claudia Torres <ctorres@hospitalsanlorenzo.com>, María Amparo Leiva <mleiva@hospitalsanlorenzo.com>

Buen día Dra. Lopez,

En primer lugar quisiera ofrecer mis disculpas por el impase del día de hoy.

Me confirmaron que durante la semana pasada fueron vendidos y entregados los reguladores de presión para cilindros que estaban en stock, mientras que los esfigmomanómetros si se mantienen disponibles de entrega inmediata.

Según el departamento de logística se espera que podamos tener disponibles más reguladores de presión en aproximadamente en 2 meses.

Entiendo la urgencia de disponer de los accesorios y la finalidad que tendrán en el hospital, por lo que quedamos atentos de las decisiones que tome el hospital.

Saludos,

MEY-KO
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONORAS DESDE 1969

Alan Nuñez | Jefe de Línea USG

☎ + (504) 9437-5146

☎ + (504) 2232-3544 / 2232-2503

✉ operaciones.demh@grupomeyko.hn

🌐 www.grupomeyko.hn

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO



HOSPITAL SAN LORENZO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	OP-297-2020	AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD No. AD0001-66014
A FAVOR DE:	GRUPO MEY-KO S.A.	
VALOR	L.	33,749.97
EN LETRAS:	Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 97/100	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	99	FUENTE	11	CUENTA	01424551	SUBCUENTA	7028695
TIPO DE PAGO	CHEQUE	EMITIR					
	TRANSFERENCIA						

DESCRIPCION

PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181-2020, (pago contra entrega).

DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	VALOR
	39510	L. 24,347.80
	42400	L. 5,000.00
	ISV	L. 4,402.17
	TOTAL	L. 33,749.97

VALOR EN LETRAS

Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 97/100

FECHA: 5/6/2020

Dr. Miriam Reyes
Gestion Financiera

Cheque emitido anulado ya que no entregaron los monederos.



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. OC-181-2020

Alan Nuñez <operaciones.demh@grupomeyko.hn>

1 de junio de 2020 a las 09:58

Para: Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

CC: Juan Ramón Osorio <josorio@hospitalsanlorenzo.com>, Rosa María Cárcamo <rcarcamo@hospitalsanlorenzo.com>, Mirian Reyes <mreyes@hospitalsanlorenzo.com>, Danamy Lopez <dlopez@hospitalsanlorenzo.com>, Claudia Torres <ctorres@hospitalsanlorenzo.com>, Grupo Meyko <valeria.sabillon@grupomeyko.hn>

Buen día estimado Lic. Sierra,

Gracias por el documento de orden de compra.

He conversado con gerencia para la entrega de estos insumos, pero me confirman que actualmente las entregas se están haciendo contra pago, por lo que le pediría su apoyo con esta gestión.

De antemano le agradezco.

Saludos,

Alan Nuñez

+504 9832-2026

[Texto citado oculto]

INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION	
Modalidad de Compra	Invitación a Cotizar Personalizada: FAHSL No. 080-2020
Objetivo de Compra:	Adquisición de 10 Manómetros y 10 Esfigmomanómetros
Fecha límite para presentación de ofertas:	27/05/2020
Lugar en que se realizó la evaluación:	Hospital San Lorenzo
Fecha de evaluación:	28/05/2020

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Laura Castillo	Control Interno
Noel Matute	Administrador de Inventario
Danamy López	Jefe de Almacén

I. INTRODUCCION

Se procedió a enviar la solicitud de cotización a las empresas que se detallan a continuación:

- DICOSA
- VISION MEDICA
- NIPRO MEDICAL CORPORATION
- ✓ GRUPO MEY-KO
- DROGUERIA MEDIMAS
- LIFE MEDICAL INTERNATIONAL
- DIMEX MEDICA
- INVERSIONES Y EQUIPOS

El procedimiento de evaluación acordado por los miembros de la Comisión Evaluadora fue el siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las Instrucciones Especiales pactadas en la cotización.
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones solicitadas,
- Evaluación económica.

II. EVALUACION

1. Apertura

A continuación, se detallan las empresas que presentaron oferta en respuesta a esta Solicitud a Cotizar: (Ver anexo)

- DICOSA
- ✓ GRUPO MEY-KO
- DROGUERIA MEDIMAS
- DIMEX MEDICA
- INVERSIONES Y EQUIPOS

2. Verificación de cumplimiento de requisitos formales

- Las empresas que presentaron ofertas lo hicieron dentro del plazo fijado.

3. Evaluación Económica y Reporte de Adjudicación

Cuadro Resumen de las Ofertas (Ver anexo II)

La verificación aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de



28-05-2020

5:04 PM.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos en las ofertas presentadas.


4. RECOMENDACION DE ADJUDICACION


La Adquisición de 10 Manómetros y 10 Esfigmomanómetros para adulto solicitados por Almacén del Hospital San Lorenzo se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización con el objeto de promover la competencia en precio, "Conforme a lo establecido en el artículo; 38 y 63 de la Ley de Contratación del Estado, artículo: 139, 152; del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 70 de las Disposiciones Generales Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2020" **Se recomienda la adjudicación de la siguiente manera:**

✓
Adjudicar a GRUPO MEY-KO: La partida 1 por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y dado que DIMEX MEDICA que es el oferente con el menor precio oferta tiempo de entrega a 30 días y este producto se requiere de carácter urgente para atención de los pacientes hospitalizados en la Sala de Aislamiento por COVID-19. La partida 2 por cumplir con las especificaciones técnicas solicitados y ser el oferente con el menor precio.

MONTO TOTAL NETO: VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (LPS.29,347.80)✓

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, a los 28 días del mes de Mayo del 2020.

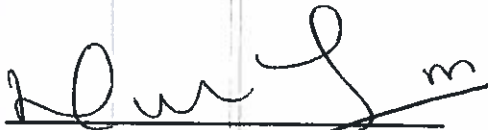
DANAMY LOPEZ
JEFE DE ALMACÉN


LAURA CASTILLO
CONTROL INTERNO


ABEL MATUTE
ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS

Anexos:

Anexo	I	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo	II	Cuadro Resumen de Ofertas
Anexo	III	Ofertas
Anexo	IV	Solicitudes de Invitaciones Cotizaciones
Anexo	V	Solicitud de Adquisicion



FUNDACION DE APOYO DEL HOSPITAL SAN LORENZO, VALLE



Colonia Morazán San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781- 1434

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No: 080-2020

Tipo de Proceso: Invitación a Cotizar Personalizada

Objetivo de la compra: Adquisición de 10 Manómetros y 10 Esfigmomanómetros

I.-Lugar, fecha y hora de apertura de las Sobres que contienen las Ofertas:


Fecha de Invitación:	26/05/2020	Fecha y hora de apertura de ofertas:	28 de Mayo del 2020 a las 3 :10 p.m.
No. de oferentes invitados:	8	No. de ofertas recibidas:	5
Fecha y hora de presentación de ofertas:	27 de Mayo del 2020 hasta las 2:00 p.m.	Lugar: Departamento de Logística y Suministros	Hospital San Lorenzo

II.- Monto de las Ofertas de los Proveedores participantes que cumplieron con los requisitos:

No	Oferente	Monto de la oferta Lps.
1	Grupo Mey-Ko	Lps.33,750.00 ✓
2	Inversiones y Equipos S. de R.L. de C.V.	Lps.22,425.00
3	Dimex Medica S.A. de C.V.	Lps.42,130.16
4	Droguería Medimas	Lps.49,416.30
5	Distribuidora Comercial S.A.	Lps.54,031.12

[Handwritten signatures and initials]

III.- Nombre y firma de la Comisión de Adquisiciones para la evaluación de las ofertas:

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Laura Castillo	Control Interno		28/05/2020
Noel Matute	Administrador de Inventarios		28/05/2020
Danamy López	Jefe de Almacén		28/05/2020

IV. Analisis de Documentación:

La Comisión de Evaluación de las ofertas recomienda:

En vista de que las empresas enviaron sus permisos de operación con vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2019 aduciendo que el trámite respectivo aún no ha sido emitido en el ente correspondiente, por la pandemia del COVID-19 de común acuerdo establece efectuar la recomendación de adjudicación tomando en consideración los Permisos de Operación de 2019, hasta que se establezca la situación en el país.

RESUMEN DE INVITACIÓN A COTIZAR: 080-2020

Nº	Cantidad	Presentación	DESCRIPCIÓN	DROGUERIA MEDIMAS		DISTRIBUIDORA COMERCIAL		GRUPO MEY-KO		INVERSIONES Y EQUIPOS		DIMEX	
				PU	PT	PU	PT	PU	PT	PU	PT	PU	PT
1	10	Unidad	Manometro para tanque de oxígeno medica con rosca de salida CGA-540, Capacidad de presión 200 psi	4230.63	42,306.30	3,114.33	31,143.28	2,434.78	24,347.80	NO HAY	NO HAY	2,098.27	20,982.70
2	10	Unidad	Esfigmomanometro manual para paciente adulto	711.000	7,110.00	1,584.03	15,840.30	800.00	5,000.00	1,950.00	19,500.00	1,565.22	15,652.20
3													
			MONTO TOTAL ADJUDICADO						29,347.80				

Observaciones: La Comisión de Evaluación de las ofertas recomienda adjudicar la partida 1 a GRUPO MEY-KO dado que DIMEX MEDICA que es el oferente con el menor precio oferta tiempo de entrega a 30 días y este producto se requiere de carácter urgente para atención de los pacientes hospitalizados en la Sala de Aislamiento por COVID-19.

DANIEL LOPEZ
JEFE DE ALMACÉN

LAURA CASTILLO
CONTROL INTERNO

ROSEMARY TE
ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2020

INVITACION A COTIZAR PERSONALIZADA: FAHSL NO. 080-2020

Nombre del Oferente	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.
RTN	0801-9013-553050
Dirección del Proveedor :	
Teléfono	2228-5021
Identidad No.	
Nombre del Titular del RTN o Identidad	
Correo Electrónico	Invequipos2014@hotmail.com

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, Valle: por este medio invita a presentar Cotización para los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

No. DE PARTIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO DÍA	VALOR TOTAL
1	10	Unidad	Manómetro para Tanque de Oxígeno Médico Con Rosca de Salida CGA-540, Capacidad de Presión 2000 psi,	NO HAY	NO HAY
2	10	Unidad	Esfigmomanómetro Manual para Paciente Adulto MARCA: WELCH ALLYN MODELO: DS44-11 ENTREGA: INMEDIATA	L.1,950.00	L.19,500.00
			Nota: Se Requiere entrega inmediata de los productos solicitados,	Sub-Total	L.19,500.00
				Impuesto Sobre Ventas	L. 2,925.00
				TOTAL	L.22,425.00

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

- 1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por partida y el precio total. Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.
- 2.-Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado Indicando el Número de Invitación a Cotizar.
- 3.-Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.



4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la Oferta.
5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: 27 DE MAYO DEL 2020 , hasta las 2:00 PM hora oficial de la República de Honduras.
6.- Adjuntar a su oferta fotocopia de: a.- Registro Tributario Nacional (RTN). b.- Permiso de Operación de la Empresa.
II.- Condiciones Especiales :
1.- La fecha de vencimiento de los bienes al momento de la recepción en el Almacén del Hospital deberá ser igual o mayor a doce (12) meses
2.- El Oferente se Compromete: a reponer sin costo alguno para La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, Valle; Cualquier cantidad de bienes que no se ajustan estrictamente a las especificaciones solicitadas y que se presentan en la oferta, a los que le sobrevienen fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o irregularidades de cualquier tipo.
3.- Tiempo de entrega: Indicar en su oferta el tiempo de entrega del producto después de recibida la orden de compra aprobada. Pasado el tiempo de entrega se cobrará multa en función a lo establecido en las Disposiciones Presupuestarias del presupuesto de ingresos y egresos vigentes. El no colocar el tiempo de entrega en cada producto, se entiende que el producto es de entrega inmediata (El Hospital considera entrega inmediata: 3 días hábiles después de notificada la Orden de Compra).
III.- CONDICIONES GENERALES:
1.- Lugar de entrega: Hospital de San Lorenzo, Valle.
2.- Moneda y Forma de Pago: La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, efectuará el pago en moneda nacional (Lempira.) dentro de los 30 días calendarios después de la recepción de los bienes, mediante la emisión de cheque de caja del FIDEICOMISO que se mantiene en el Banco FICOHSA, a favor del proveedor debiéndose presentar para el mismo los siguientes documentos: a.- Factura comercial a nombre de: Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo. RTN: 17099010303801 b.- Comprobante de Entrega. c.- Recibo de pago firmado y sellado d.- Solvencia Fiscal
3.- Las instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas arriba indicadas constituyen la base de cualquier oferta y se consideran incluidas en ella, y formarán parte integral de la orden de compra; a su vez constituye la aceptación incondicional por el oferente de las condiciones generales, especiales y especificaciones Técnicas. Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos aquí solicitados, por lo que firmo a continuación la presente.
Firma y Sello del oferente:
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de mayo de 2020

[Handwritten signature and initials]



INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L DE C.V

Col. Kennedy 5ta entrada contiguo a maquilas, Complejo de
Bodega Simón. Bod #3 Telefono. 22 28 50 21

Correo electronico: invequipos2014@hotmail.com

RTN:0801-9013-553050

COTIZACION N° 000188-2020

REFERENCIA: INVITACION A COTIZAR FAHSL NO. 080-2020

FECHA
27/5/2020

CLIENTE
Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo

DIRECCION
San Lorenzo

CAI: 096B9D-67080E-BA4F90-042FF6-525A90-25

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	ISV S/N	TOTAL
1	10	Unidad	Manómetro para Tanque de Oxígeno Medico Con Rosca de Salida CGA-540, Capacidad de Presión 2000 psi,	NO HAY		NO HAY
2	10	Unidad	Esfigmomanómetro Manual para Paciente Adulto MARCA: WELCH ALLYN MODELO: DS44-11 ENTREGA: INMEDIATA	L. 1,950.00	SI	L. 19,500.00
.....U.I.....						
				SUB TOTAL		19,500.00
				ISV		2,925.00
				TOTAL		22,425.00



TANIA BARAHONA
0708-1994-00177
DEPTO. DE ICITACIONES

ACEPTADO CLIENTE

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 173398

Permiso No: 169783
Declaración No: DI-7441
Fecha de emisión: 26/04/2019
Fecha de vencimiento: 31/12/2019

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L

Ciudad:
Barrio o Colonia:
Clave Catastral:
Dirección:
RTN o Identidad:
No. de Negocio:

DISTRITO CENTRAL
2001-KENNEDY (2001)
20-0255-025
COMPLEJO DE BODEGAS COL. KENNEDY
08019013553050
ICS-97601

CONTRIBUYENTE:

INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
330401 FABRICA DE MUEBLES Y ACCESORIOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



000G0-0000-04PR-YH21-0PCH-MA00-0000-0000-1LHUG



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal

Pedro J. Ruiz



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 21/05/2019

RTN: 08019013553050

INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R. L. DE C. V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 266 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 66 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 68 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministro Director




SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3200739

Transacción: 069D58

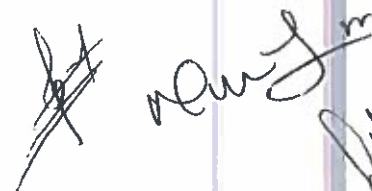



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

CONSTANCIA No. 097/2020 GAC-AMDC

El suscrito Gerente de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace CONSTAR que la **INVERSIONES Y EQUIPOS, S. de R.L. con RTN 0801-9013-553050** tiene en trámite el Permiso de


Operación del año 2020 en esta Alcaldía Municipal.

Y para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los **veintisiete** días del mes de **mayo** del año **dos mil veinte**.

PD/ La presente Constancia es válida por Treinta (30) días a partir de la fecha de emisión de la misma.


GERENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia: archivo

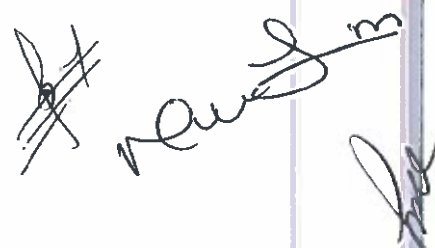

A premium professional line of quality
sphygmomanometers



In traditional aerial splyzometer design, several chains and gears convert and amplify vertical movement of the plumb to rotational movement to turn the pointer. The DuraStretch gear-less design, however, uses a superior single ball spring to directly convert the vertical movement of the plumb to rotation of the pointer without the use of a multi-step gear arrangement.

By creating a one-face design, Welch Allen products with DuraCheck technology have fewer moving parts, providing a gauge that is shock resistant and lighter than traditional gauges. Until now, a dependant displacementmeter required recalibration or replacement. The DuraCheck gauges in the Bronze, Silver, and Gold line can fall 30 inches onto a hard surface and still remain accurate. The DuraCheck gauges in the Platinum line can fall 60 inches onto a hard surface and still remain accurate.

Weich Allyn Silver Series
An entry-level line of quality
sphygmomanometers

Welsh Allyn Bronze Series
An economy line of quality
sphygmomanometers

[illegible]

- | | |
|-----------|---|
| D684 | Auroral oval |
| D926-11 | Auroral with adult dermal two-piece cuff and zipper case |
| D926-12H | Auroral with adult dermal two-piece cuff and shoulder and zipper case |
| D926-4C | Auroral with large adult, small, and child graft suitable two-piece cuff and shoulder and zipper case |
| D926-4CTZ | Auroral with large adult, small, and child graft suitable two-piece cuff and shoulder and zipper case |
| D926-FD | Auroral with adult graft, small child, infant, and youth dermal two-piece cuff and zipper case |
| D926-PDCB | Auroral with adult graft, small child, and baby dermal two-piece cuff and shoulder and zipper case |
| D926-10 | Small zipper case |
| D926-11 | Large zipper case |

Received 10 June 2004; accepted 10 June 2004
Published online 10 June 2004

- | | |
|-------|--|
| OS-10 | Personal only |
| OS-11 | Approved with audit details one-page self and upper case |
| OS-12 | Small paper size |

DOI: 10.1002/anie.200500000

- Product group labels on two-piece call and blunder:**
- | | |
|-----------|---|
| CG-1A | Aspiral only |
| CG-1A-1C3 | Aspiral with white double two-piece call and blunder and aspiral line |
| CG-1B | Small plastic case |

Model 2. ADF, 0.526 (1999)

- 5889-25 Assorted white, double two-piece cuff and zipper coat
 5889-27 Assorted white, double two-piece cuff and shoulder and zipper coat
 5890-2728 Assorted white, double two-piece cuff and shoulder and zipper coat
 5889-38 Assorted white, large white, double two-piece cuff and zipper coat
 5890-38 Assorted white, large white, double two-piece cuff and shoulder and zipper coat
 5891-47 Single zipper coat
 5892-48 Double zipper coat

Welch Align USAs integrated
mounting plate will return

- 00-05 *Arctostaphylos*
 00-05-01 *Arctostaphylos* with small shrubs one-plant only
 00-05-01C *Arctostaphylos* with small shrubs one-plant only and other plants
 00-05-01CB *Arctostaphylos* with integrated groups of shrubs and small shrubs one-plant only and other plants
 00-05-02 *Single plant only*

WILSON: A 20% loss in the population

- | | |
|------------|---|
| DC-44 | Assorted only |
| DC-44-11 | Assorted white solid double two-piece roll |
| DC-44-17C | Assorted white solid double two-piece roll and color bumper variety pack |
| DC-44-17C | Assorted white solid double two-piece roll and paper cone |
| DC-44-11CB | Assorted cone wrapped gauge cones and solid double two-piece roll and blister |
| DC-44-20 | White cone only |

22/08/2013

American National Standard ANSI/AIAA-87F-10.1, Manual, electronic,
in unlimited quantities.

American National Standard ANSI/AIAA-87F-10.1, Non-extracted
microfilm edition (grades D64 and D65 only)



Welch Allyn Blood Pressure Products
featuring DuraShock™ Technology

Welch Allyn
Advancing Health Care™

4341 State Street Road PO Box 228 Stoneman Falls, NY 13793-0228 USA
(607) 538-5993 (315) 685-2174
www.mik-bell.com

© 2003 United Nations. All rights reserved. This report and the findings and recommendations it contains should not be used for political or commercial purposes.

WelchAllyn®
Advancing Patient Care™

Maintain Accurate Blood Pressure Readings with Lower Lifetime Cost

Welch Allen's complete line of aneroid sphygmomanometers incorporating our shock-resistant DuraShock technology offers practical benefits compared to traditional aneroid sphygmomanometers. With gear-free DuraShock technology, you can count on Welch Allen gauges to:

- Retain high precision for over 10 years. DuraShock technology keeps gauges accurate for decades, not months or years.
- Withstand the stresses of use. The shock-resistant design allows the gauge to be dropped 10 feet without damage. The shock-resistant design also allows the gauge to be used in the field without damage.

Platinum Series

All products in the Platinum Series incorporate the following features:

- Large, easy-to-read dial
- Shock-resistant design
- Integrated, self-contained design
- Durable, high-quality materials
- High-precision accuracy
- Shock-resistant design

Types: Classic Models: DS58, DS48, DS40A

The Welch Allen Types DS58 Classic is one of these premium models in this new Welch Allen product range. In addition to the features listed here, the DS58 comes with an ergonomic inflation bulb designed to enhance comfort while inflating a cuff.

The DS48 Classic aneroid plugs directly into an integrated cuff, providing a more robust design that is twice as shock-resistant as the current DS44 and DS45 integrated gauges from Welch Allen. The gauge rotates 360° for easy viewing from any angle.

The DS48A Classic pocket-style aneroid is lightweight and will not weigh down a cuff on a patient's arm.

Gold Series

All products in the Gold Series incorporate the following features:

- Shock-resistant design
- Integrated, self-contained design
- Durable, high-quality materials
- High-precision accuracy
- Shock-resistant design

Welch Allen DS66 Trigger
In addition to the features listed above, the DS66 Trigger features a shock, trigger-style air release valve and ergonomic design with soft plastic covers at key touch points for comfort.

Silver Series

All products in the Silver Series product range incorporate the following features:

- Shock-resistant design
- Integrated, self-contained design
- Durable, high-quality materials
- High-precision accuracy
- Shock-resistant design

Welch Allen DS45 Integrated
The DS45 Integrated features a unique integrated, self-contained design that is compact and lightweight for ease of use. The gauge rotates 360° for easy viewing from any angle. A bumper around the dial provides added protection, and a large inflation bulb and high-quality air-release valve make inflation easy.

Bronze Series

All products in the Bronze Series product range incorporate the following features:

- Shock-resistant design
- Integrated, self-contained design
- Durable, high-quality materials
- High-precision accuracy
- Shock-resistant design

Welch Allen DS44 Integrated
The DS44 Integrated features a unique integrated, self-contained design that is compact and lightweight for ease of use. The gauge rotates 360° for easy viewing from any angle. A bumper around the dial provides added protection. The DS44 is available with four optional color bumpers for variety—blue, purple, red, and green.



Welch Allen's aneroid sphygmomanometers incorporating shock-resistant DuraShock technology offer award-winning design for superior movement and accuracy. It's the first gear-free aneroid capable of meeting the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) Shock-Resistant specification.



Award-Winning Technology

Patented DuraShock technology is the first major innovation in aneroid sphygmomanometer technology in nearly 100 years. It has received international recognition for medical design and technological significance in the marketplace.



High Precision Dial Face

All Welch Allen Platinum, Gold, and Silver line sphygmomanometers feature a gauge that is calibrated by a computer and laser-engraved with a custom made dial face that accurately reflects the readings of the DuraShock aneroid movement inside. This proprietary production process is unique to Welch Allen and provides you with a sphygmomanometer of excellent accuracy.

Handwritten signature and initials.

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2020

INVITACION A COTIZAR PERSONALIZADA: FAHSL NO. 080-2020

Nombre del Oferente	DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.
RTN	0801-9001-262611
Dirección del Proveedor :	BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO NO. 3002, ATRÁS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA.
Teléfono	(504) 2280-4444
Identidad No.	
Nombre del Titular del RTN o Identidad	
Correo Electrónico	jaguilar@dimexmedica.com

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, Valle: por este medio invita a presentar Cotización para los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

No. DE PARTIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO DÍA	VALOR TOTAL
1	10	Unidad	Manómetro para Tanque de Oxígeno Medico Con Rosca de Salida CGA-540, Capacidad de Presión 2000 psi,	L. 2,098.27	L. 20,982.72
2	10	Unidad	Esfigmomanómetro Manual para Paciente Adulto	L. 1,565.22	L. 15,652.20
			Nota: Se Requiere entrega inmediata de los productos solicitados,	Sub-Total	L. 36,634.92
			NOTA: ÍTEM 1 ENTREGA DE 30 DÍAS, ÍTEM 2 ENTREGA INMEDIATA.	Impuesto Sobre Ventas	L. 5,495.24
				TOTAL	L. 42,130.16

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

- 1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por partida y el precio total. **Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.**
- 2.- Presentar cotización debidamente **firmada y sellada en sobre cerrado** Indicando el Número de la Invitación a Cotizar.
- 3.- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la Oferta.
- 5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: **27 DE MAYO DEL 2020, hasta las 2:00 PM** hora oficial de la República de Honduras.

[Firma manuscrita]

- 6.- Adjuntar a su oferta fotocopia de:
- a.- Registro Tributario Nacional (RTN).
 - b.- Permiso de Operación de la Empresa.

II.- Condiciones Especiales :

1.- La fecha de vencimiento de los bienes al momento de la recepción en el Almacén del Hospital deberá ser igual o mayor a doce (12) meses

2.- El Oferente se Compromete: a reponer sin costo alguno para La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, Valle; Cualquier cantidad de bienes que no se ajustan estrictamente a las especificaciones solicitadas y que se presentan en la oferta, a los que le sobrevienen fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o irregularidades de cualquier tipo.

3.- Tiempo de entrega: Indicar en su oferta el tiempo de entrega del producto después de recibida la orden de compra aprobada. Pasado el tiempo de entrega se cobrará multa en función a lo establecido en las Disposiciones Presupuestarias del presupuesto de ingresos y egresos vigentes. El no colocar el tiempo de entrega en cada producto, se entiende que el producto es de entrega inmediata (El Hospital considera entrega inmediata: 3 días hábiles después de notificada la Orden de Compra).

III.- CONDICIONES GENERALES:

1.- Lugar de entrega: Hospital de San Lorenzo, Valle.

2.- Moneda y Forma de Pago: La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, efectuará el pago en moneda nacional (Lempira.) dentro de los 30 días calendarios después de la recepción de los bienes, mediante la emisión de cheque de caja del FIDEICOMISO que se mantiene en el Banco FICOHSA, a favor del proveedor debiéndose presentar para el mismo los siguientes documentos:


- a.- Factura comercial a nombre de: Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo. RTN: 17099010303801
- b.- Comprobante de Entrega.
- c.- Recibo de pago firmado y sellado
- d.- Solvencia Fiscal

3.- Las instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas arriba indicadas constituyen la base de cualquier oferta y se consideran incluidas en ella, y formarán parte integral de la orden de compra; a su vez constituye la aceptación incondicional por el oferente de las condiciones generales, especiales y especificaciones Técnicas.
Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos aquí solicitados, para fe de lo cual firmo a continuación la presente.


Firma y Sello del oferente:

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 27-5-2020



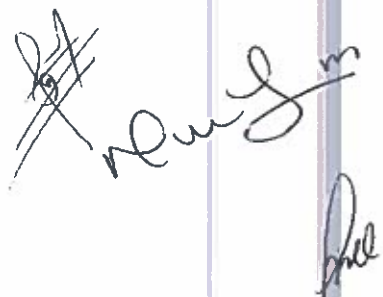

Mada Oxygen Therapy Regulators

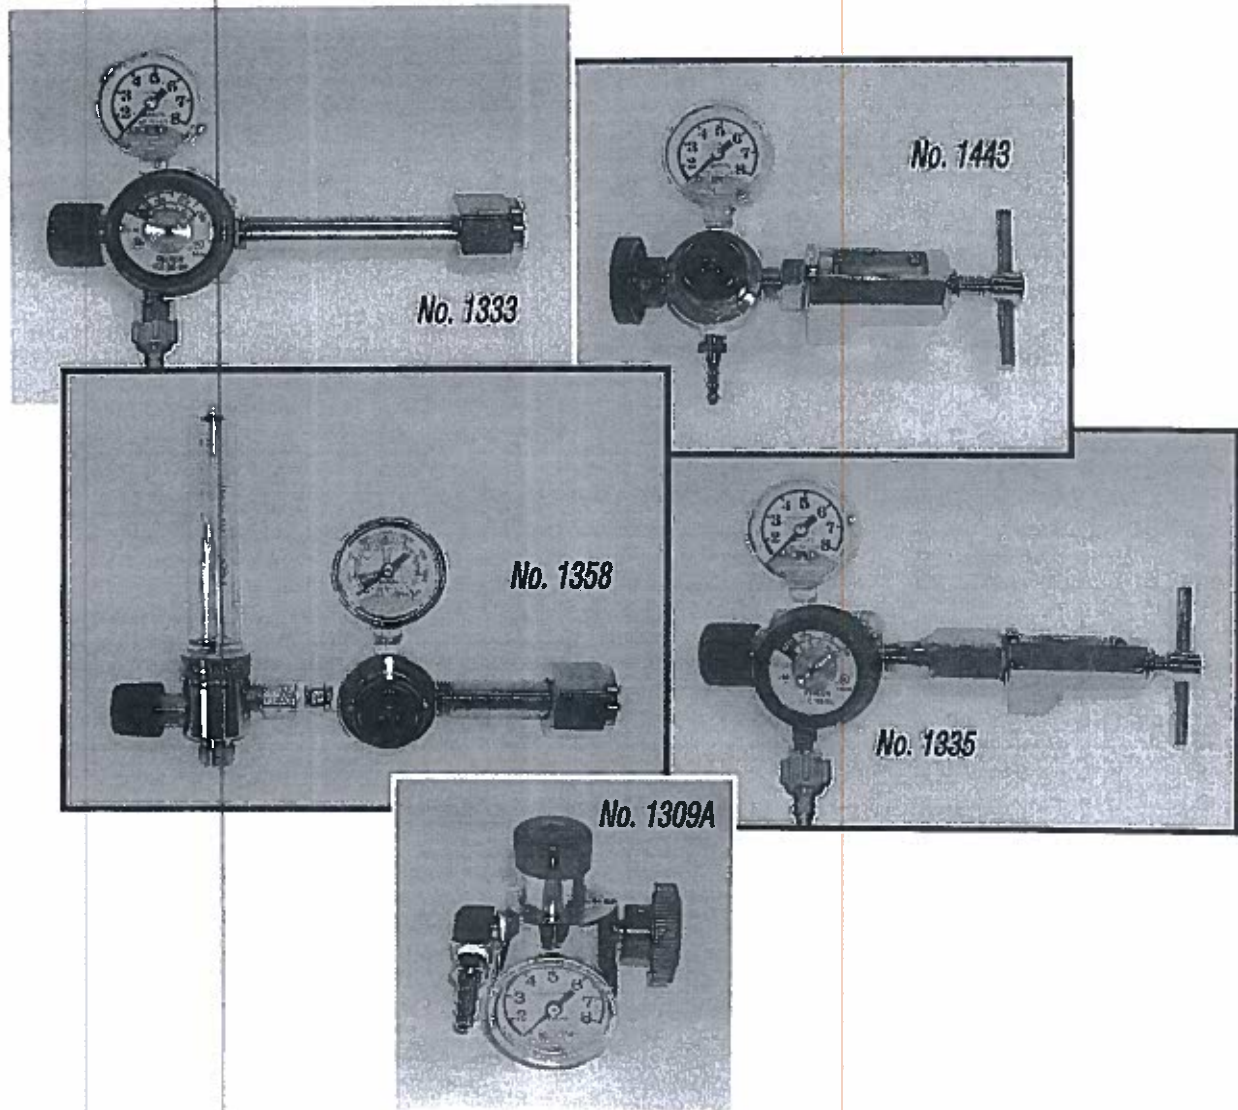

Features:

- Solid Brass Regulator Body.
- Easy to adjust liter flow.
- Individually tested and inspected .
- Economically priced.
- Designed for Homecare/Hospital use.
- Lifetime Piston Warranty.
- Five Year Warranty on balance of regulator.
- Sintered filter for safety.
- 1 1/2" diameter Gauges.
- Chrome plated brass body.
- Accuracy: $\pm 10\%$.
- Manufactured in the USA.
- Now over 41 years of proven reliability.



MADA, INC.

DOMESTIC/INTERNATIONAL
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

To Order Call Toll Free: **800-526-6370**

Web Site: www.madamedical.com

Handwritten signatures and initials.

Mada Regulator Guide

Oxygen Adjustable Flow Regulators (Gauge Flowmeter Style)

PRODUCT NO.	FLOW RATE	FLOW INDICATOR	CONNECTION TYPE	OUTLET TYPE
1309A	2 - 8 LPM	Bourdon Gauge	MadaValve System	Barb
1309A-1	1/16 - 1 LPM	Bourdon Gauge	MadaValve System	Barb
1309A-5	1/2 - 5 LPM	Bourdon Gauge	MadaValve System	Barb
1309A-15	2 - 15 LPM	Bourdon Gauge	MadaValve System	Barb
1333	2 - 8 LPM	Bourdon Gauge	CGA-540, Large Cylinder	DISS Male
1333-1	1/16 - 1 LPM	Bourdon Gauge	CGA-540, Large Cylinder	DISS Male
1333-5	1/2 - 5 LPM	Bourdon Gauge	CGA-540, Large Cylinder	DISS Male
1333-15	2 - 15 LPM	Bourdon Gauge	CGA-540, Large Cylinder	DISS Male
1333HT	2 - 8 LPM	Bourdon Gauge	CGA-540, Hand Tight Knob	DISS Male
1333HT-15	2 - 15 LPM	Bourdon Gauge	CGA-540, Hand Tight Knob	DISS Male
1335	2 - 8 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870, Small Cylinder	DISS Male
1335-1	1/16 - 1 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870, Small Cylinder	DISS Male
1335-5	1/2 - 5 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870, Small Cylinder	DISS Male
1335-15	2 - 15 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870, Small Cylinder	DISS Male
1358	1/2 - 8 LPM	Flowmeter	CGA-540, Large Cylinder	DISS Male
1358-1	1/10 - 1 LPM	Flowmeter	CGA-540, Large Cylinder	DISS Male
1358-15	1 - 15 LPM	Flowmeter	CGA-540, Large Cylinder	DISS Male
1359	1/2 - 8 LPM	Flowmeter	CGA-870, Small Cylinder	DISS Male
1359-1	1/10 - 1 LPM	Flowmeter	CGA-870, Small Cylinder	DISS Male
1359-15	1 - 15 LPM	Flowmeter	CGA-870, Small Cylinder	DISS Male
1443	2 - 8 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870, Small Cylinder, No PSI Gauge	Barb
1443-5	1/2 - 5 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870, Small Cylinder, No PSI Gauge	Barb
1443-15	2 - 15 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870, Small Cylinder, No PSI Gauge	Barb
1443-S	2 - 8 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870 Small Cylinder, No PSI Gauge	DISS Male
1443S-15	2 - 15 LPM	Bourdon Gauge	CGA-870 Small Cylinder, No PSI Gauge	DISS Male

Oxygen Fixed-Flow Regulators

PRODUCT NO.	FLOW RATE	FLOW INDICATOR	FITTING	OUTLET TYPE
1308A	6 LPM Avg.	Fixed	MadaValve System	Barb
1441	6 LPM Avg.	Fixed	CGA-870, Small Cylinder	Barb
1442	6 LPM Avg.	Fixed	CGA-870, Small Cylinder, No PSI Gauge	Barb

50 PSI High-Flow Regulators


PRODUCT NO.	FITTING	NO. OF OUTLETS	FLOW RATES	OUTLET TYPE
1633-1	CGA-540	1	Min. 180 LPM	DISS Male
1633-2	CGA-540	2	Min. 180 LPM	DISS Male
1635-1	CGA-870	1	Min. 180 LPM	DISS Male
1635-2	CGA-870	2	Min. 180 LPM	DISS Male

Air Regulators (50 PSI)

PRODUCT NO.	FLOW RATE	CONNECTION
1358-15A	1 - 15 LPM	CGA-346, Large Cylinder
1633-1A	180 LPM	CGA-346 Nut, Large Cylinder
1635-1A	180 LPM	CGA-950 Yoke, Small Cylinder

Nitrous Oxide Regulators (50 PSI)

PRODUCT NO.	PRESSURE	INLET FITTING
2633-1	50 PSI	CGA-326 Nut, Large Cylinder




MADA, INC.

DOMESTIC/INTERNATIONAL

625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

To Order Call Toll Free: **800-526-6370**

Web Site: www.madamedical.com

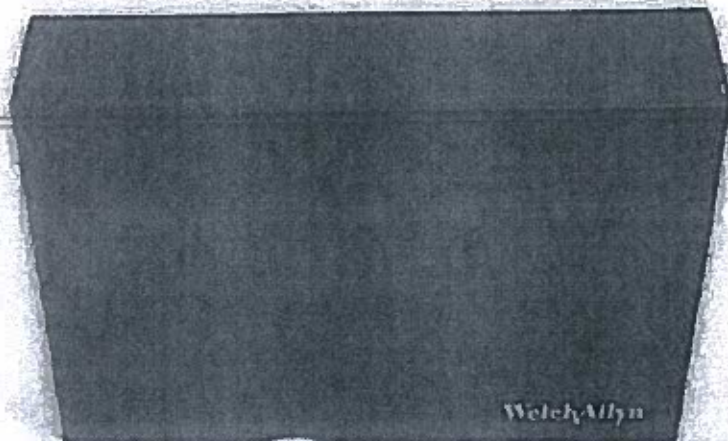


Welch Allyn
DuraShock™ Arterial
Sphygmomanometer with
Integrated Gauge Adapter
100% Plastic, 5.25" High



Model 1000 and 1000-2000 Gauge Adapter

Welch Allyn

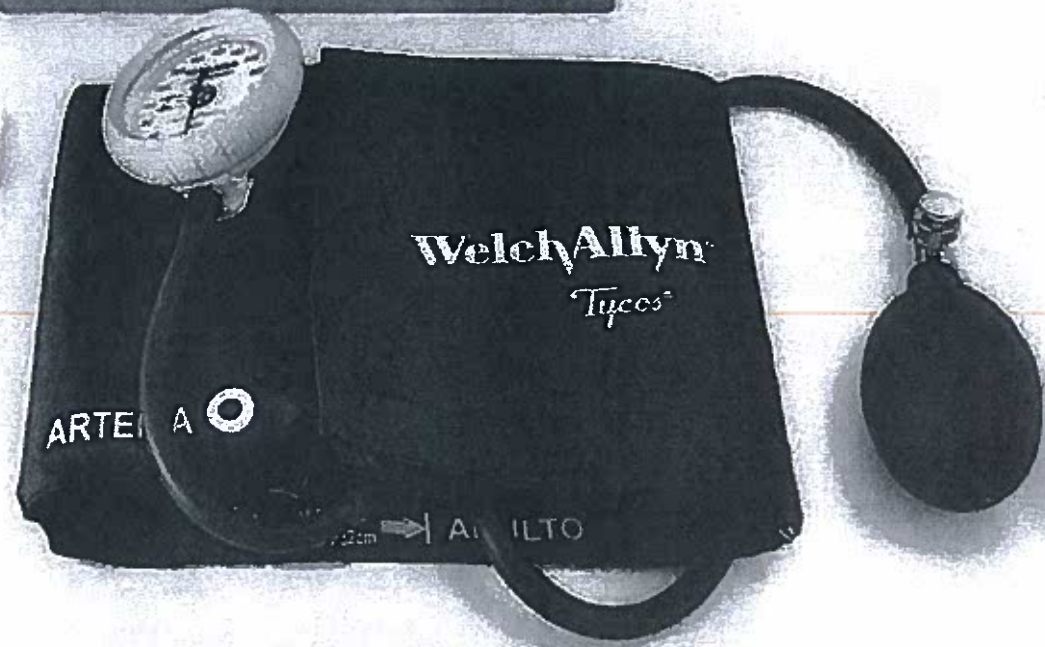

Handwritten signature



FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO
SUBDIRECCION DE GESTION DE RECURSOS
UNIDAD DE LOGISTICA Y SUMINISTROS



FECHA: 26 DE MAYO DEL 2020

INVITACION A COTIZAR PERSONALIZADA: FAHSL NO. 080-2020

Nombre del Oferente	Distribuidora Comercial S.A.
RTN	08019002278310
Dirección del Proveedor :	Calle Bustamante y Rivero, entre final de Ave. Los Proceres y Boulevard Morazán
Teléfono	2221-1970
Identidad No.	0501-1963-02961
Nombre del Titular del RTN o Identidad	Juan Carlos Hasbun Handal
Correo Electrónico	rpalma@dicosa.net


La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, Valle: por este medio invita a presentar Cotización para los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

No. DE PARTIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO DÍA	VALOR TOTAL
1	10	Unidad	Manómetro para Tanque de Oxígeno Medico Con Rosca de Salida CGA-540, Capacidad de Presión 2000 psi, (Ofrezco REGULADOR DE OXIGENO T/GRANDE CAT. 1333-15 MADA)	3114.328	31,143.28
2	10	Unidad	Esfigmomanómetro Manual para Paciente Adulto (Ofrezco ESFIGNO. VELCRO ADULTO S/LATEX AZUL PIZARRA 1517)	L 1,584.03	L 15,840.30
			Nota: Se Requiere entrega inmediata de los productos solicitados, Entrega Inmediata	Sub-Total	46,983.58
				Impuesto Sobre Ventas	7,047.537
				TOTAL	L 54,031.12

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

- 1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por partida y el precio total. Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.
- 2.-Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado Indicando el Número de la Invitación a Cotizar.
- 3.-Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la

Oferta.
5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: 27 DE MAYO DEL 2020, hasta las 2:00 PM hora oficial de la República de Honduras.
6.- Adjuntar a su oferta fotocopia de: a.- Registro Tributario Nacional (RTN). b.- Permiso de Operación de la Empresa.
II.- Condiciones Especiales :
1.- La fecha de vencimiento de los bienes al momento de la recepción en el Almacén del Hospital deberá ser igual o mayor a doce (12) meses
2.- El Oferente se Compromete: a reponer sin costo alguno para La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, Valle; Cualquier cantidad de bienes que no se ajustan estrictamente a las especificaciones solicitadas y que se presentan en la oferta, a los que le sobrevienen fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o irregularidades de cualquier tipo.
3.- Tiempo de entrega: Indicar en su oferta el tiempo de entrega del producto después de recibida la orden de compra aprobada. Pasado el tiempo de entrega se cobrará multa en función a lo establecido en las Disposiciones Presupuestarias del presupuesto de ingresos y egresos vigentes. El no colocar el tiempo de entrega en cada producto, se entiende que el producto es de entrega inmediata (El Hospital considera entrega inmediata: 3 días hábiles después de notificado la Orden de Compra).
III.- CONDICIONES GENERALES:
1.- Lugar de entrega: Hospital de San Lorenzo, Valle.
2.- Moneda y Forma de Pago: La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, efectuará el pago en moneda nacional (Lempira.) dentro de los 30 días calendarios después de la recepción de los bienes, mediante la emisión de cheque de caja del FIDEICOMISO que se mantiene en el Banco FICOHSA, a favor del proveedor debiéndose presentar para el mismo los siguientes documentos: a.- Factura comercial a nombre de: Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo. RTN: 17099010303801 b.- Comprobante de Entrega. c.- Recibo de pago firmado y sellado d.- Solvencia Fiscal
3.- Las instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas arriba indicadas constituyen la base de cualquier oferta y se consideran incluidas en ella, y formarán parte integral de la orden de compra; a su vez constituye la aceptación incondicional por el oferente de las condiciones generales, especiales y especificaciones Técnicas. Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos aquí solicitados, para fe de lo cual firmo a continuación la presente.
Firma y Sello del oferente: Rosa Palma
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 28-05-2020



Rosa Palma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 177787

Permiso No: 178184
Declaracion No: DI-21881
Fecha de emisión: 27/01/2020
Fecha de vencimiento: 31/12/2020

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A (DICOSA)

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0419 SABANAGRANDE (419)
Clave Catastral: 04-0132-009
Dirección: FINAL BLV. LOS PROCERES
RTN o Identidad: 08019002278310
No. de Negocio: ICS-31807

CONTRIBUYENTE:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A (DICOSA)

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
610905 DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



MC 30-000 06U5- X8-JE -P000 300-00 -IP5W



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002278310

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A
Domicilio Fiscal: SABANA GRANDE Calle: AVE LOS PROCERES N.
Casa: 4002
Representante Legal: JUAN CARLOS HASBUN HANDAL
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Menor De Productos
Farmacéuticos Y Medicinales Y Artículos De Tocador

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador



Imprentas
Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente



Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 445 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-378186

Transacción: F88363

Handwritten signature and initials

ESFIGNO. VELCRO ADULTO S/LATEX AZUL
PIZARRA 1517



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



1

5
Dane

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2020

INVITACION A COTIZAR PERSONALIZADA: FAHSL NO. 080-2020


Nombre del Oferente	DROGUERIA MEDIMAS
RTN	05019007491865
Dirección del Proveedor:	RESIDENCIAL EL PORTAL SP.S
Teléfono	2565-3151
Identidad No.	DROGUERIA MEDIMAS
Nombre del Titular del RTN o Identidad	05019007491865
Correo Electrónico	ventas@medimashn.com

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, Valle: por este medio invita a presentar

 Cotización para los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

No. DE PARTIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO DÍA	VALOR TOTAL
1	10	Unidad	Manómetro para Tanque de Oxígeno Medico Con Rosca de Salida CGA-540, Capacidad de Presión 2000 psi,	L.4,230.63	L.42,306.30
2	10	Unidad	Esfigmomanómetro Manual para Paciente Adulto/ Marca DYNAREX	L.711	L.7,110
			Nota: Se Requiere entrega inmediata de los productos solicitados,	Sub-Total	
			 	Impuesto Sobre Ventas	
			COTIZACION VALIDA POR 24 HORAS, TERMINOS DE CONTADO	TOTAL	L.49,416.30

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

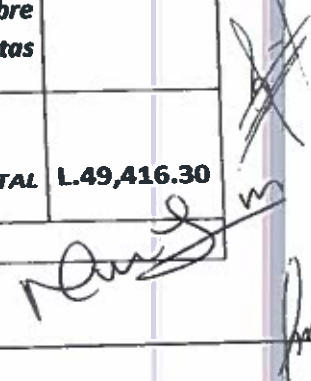

- 1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por partida y el precio total. Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.
- 2.- Presentar cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado indicando el Número de la Invitación a Cotizar.
- 3.- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la Oferta.
- 5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: **27 DE MAYO DEL 2020**, hasta las **2:00 PM** hora oficial de la República de Honduras.
- 6.- Adjuntar a su oferta fotocopia de:
 - a.- Registro Tributario Nacional (RTN).
 - b.- Permiso de Operación de la Empresa.

II.- Condiciones Especiales :

- 1.- La fecha de vencimiento de los bienes al momento de la recepción en el Almacén del Hospital deberá ser igual o mayor a doce (12) meses
- 2.- El Oferente se Compromete: a reponer sin costo alguno para La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, Valle; Cualquier cantidad de bienes que no se ajustan estrictamente a las especificaciones solicitadas y que se presentan en la oferta, a los que le sobrevienen fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o irregularidades de cualquier tipo.
- 3.- Tiempo de entrega: Indicar en su oferta el tiempo de entrega del producto después de recibida la orden de compra aprobada. Pasado el tiempo de entrega se cobrará multa en función a lo establecido en las Disposiciones Presupuestarias del presupuesto de ingresos y egresos vigentes. El no colocar el tiempo de entrega en cada producto, se entiende que el producto es de entrega inmediata (El Hospital considera entrega inmediata: 3 días hábiles después de notificada la Orden de Compra).


III.- CONDICIONES GENERALES:

- 1.- Lugar de entrega: Hospital de San Lorenzo, Valle.
- 2.- Moneda y Forma de Pago: La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, efectuará el pago en moneda nacional (Lempira.) dentro de los 30 días calendarios después de la recepción de los bienes, mediante la emisión de cheque de caja del FIDEICOMISO que se mantiene en el Banco FICOHSA, a favor del proveedor debiéndose presentar para el mismo los siguientes documentos:
 - a.- Factura comercial a nombre de: Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo. RTN: 17099010303801
 - b.- Comprobante de Entrega.
 - c.- Recibo de pago firmado y sellado
 - d.- Solvencia Fiscal
- 3.- Las Instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas arriba indicadas constituyen la base de cualquier oferta y se consideran incluidas en ella, y formarán parte integral de la orden de compra; a su vez constituye la aceptación incondicional por el oferente de las condiciones generales, especiales y especificaciones Técnicas. Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos aquí solicitados, para fe de lo cual firmo a continuación la presente.

Firma y Sello del oferente:

Lugar y Fecha: Residencial el portal S.P.S, 27 De mayo del año 2020



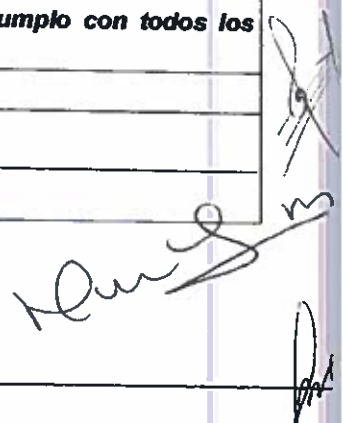




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20/01/2020

RTN: 05019007491865

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3362802

Transacción: 0882A1

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



SAN PEDRO SULA

Obras. Orden. Honestidad.

PERMISO No. 41745 29/01/2020 Renovación
DECLARACIÓN No. 72499
FECHA EMISIÓN 2020 1 03/02/2020

FECHA VENCIMIENTO 31 de diciembre del 2020

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos de la Ordenanza Municipal que institucionaliza y regula el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio de San Pedro Sula (Aprobado en punto de #15, Acta #13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26/Oct/2006) se otorga el presente permiso a:

DROGUERIA MEDIMAS
DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L DE C.V.

Ubicado en : NOR-OESTE URBANO RESIDENCIAL EL PORTAL Calle: - Ave: - Local: Categoría: C2
R.T.N. o Ident.: 05019007491865 Expediente: 001 Sucursal: 001 Clave Catastral: NO023001004
Zonificación: ZR4 Horario de Atención: Horario no controlado RIC/RMC: 1265790

GIRO COMERCIAL
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y DE HERBORISTE

AUTORIZACION DE ROTULO

LEYENDA

NO TIENE ROTULO

TIPO

ANCHO ALTO AREA

REGULACION DE INGRESOS



IMPRIMIO : blara
FECHA : 03/02/2020 04:32:59 PM



EXHIBIR ESTE PERMISO EN LUGARES VISIBLES DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2020

INVITACION A COTIZAR PERSONALIZADA: FAHSL NO. 080-2020

Nombre del Oferente	Grupo Mey-Ko
RTN	08019002062818
Dirección del Proveedor:	Colonia Ruben Dario. Frente al Campo Scout y a la par de Llanticofero.
Teléfono	+504 2232-3544
Identidad No.	0801-1990-14649
Nombre del Titular del RTN o Identidad	Alan Josue Nuñez Ramos
Correo Electrónico	Operaciones.demh@grupomeyko.hn

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, Valle: por este medio invita a presentar Cotización para los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

No. DE PARTIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO DÍA	VALOR TOTAL
1	10	Unidad	Manómetro para Tanque de Oxígeno Medico Con Rosca de Salida CGA-540, Capacidad de Presión 2000 psi,	L. 2,434.78	L. 24,347.82
2	10	Unidad	Esfigmomanómetro Manual para Paciente Adulto. MARCA: ADC Modelo: 766Z	L. 500.00	L. 5,000
			Nota: Se Requiere entrega inmediata de los productos solicitados,	Sub-Total	L. 29,347.82
				Impuesto Sobre Ventas	L. 4,402.17
				TOTAL	L. 33,750.00

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

[Handwritten signature and initials]

1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por partida y el precio total. **Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.**

2.- Presentar cotización debidamente **firmada y sellada en sobre cerrado** Indicando el Número de la Invitación a Cotizar.

3.- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.

4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la Oferta.

5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: **27 DE MAYO DEL 2020**, hasta las **2:00 PM** hora oficial de la República de Honduras.

6.- Adjuntar a su oferta fotocopia de:

a.- Registro Tributario Nacional (RTN).

b.- Permiso de Operación de la Empresa.

II.- Condiciones Especiales :

1.- La fecha de vencimiento de los bienes al momento de la recepción en el Almacén del Hospital deberá ser igual o mayor a doce (12) meses

2.- El Oferente se Compromete: a reponer sin costo alguno para La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, Valle; Cualquier cantidad de bienes que no se ajustan estrictamente a las especificaciones solicitadas y que se presentan en la oferta, a los que le sobrevienen fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o irregularidades de cualquier tipo.

3.- Tiempo de entrega: Indicar en su oferta el tiempo de entrega del producto después de recibida la orden de compra aprobada. Pasado el tiempo de entrega se cobrará multa en función a lo establecido en las Disposiciones Presupuestarias del presupuesto de ingresos y egresos vigentes. El no colocar el tiempo de entrega en cada producto, se entiende que el producto es de entrega inmediata (El Hospital considera entrega inmediata: 3 días hábiles después de notificada la Orden de Compra).

III.- CONDICIONES GENERALES:

1.- Lugar de entrega: Hospital de San Lorenzo, Valle.

2.- Moneda y Forma de Pago: La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, efectuará el pago en moneda nacional (Lempira.) dentro de los 30 días calendarios después de la recepción de los bienes, mediante la emisión de cheque de caja del FIDEICOMISO que se mantiene en el Banco FICOHSA, a favor del proveedor debiéndose presentar para el mismo los siguientes documentos:

a.- Factura comercial a nombre de: Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo. RTN: 17099010303801

b.- Comprobante de Entrega.

c.- Recibo de pago firmado y sellado

d.- Solvencia Fiscal

3.- Las instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas arriba indicadas constituyen la base de cualquier oferta y se consideran incluidas en ella, y formarán parte integral de la orden de compra; a su vez constituye la aceptación incondicional por el oferente de las condiciones generales, especiales y especificaciones Técnicas.

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

Firma y Sello del oferente:



Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de Mayo 2020.

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 182198

Permiso No. 182697

Declaración No: DI-31675

Fecha de emisión: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/12/2020 ✓

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

GRUPO MEY-KO

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1002-RUBEN DARIO (1002)
Clave Catastral: 10-0038-019
Dirección: FRENTE CANCHA BOY SCOOT
RTN o Identidad: 08019002062818
No. de Negocio: ICS-30243

CONTRIBUYENTE:

GRUPO MEY-KO, S.A.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
960115 VENTA DE EQUIPO MEDICO

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



MW: 00-000 06BQ- E2-1C 1-L4R 0000-0 3-1J9V



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002062818

GRUPO MEY-KO S.A.
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores

Fecha de Inscripción: 20120921

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Director Adjunto de Rentes Internas **Señor Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1158268 **Transacción: 0B1E95**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2020

INVITACION A COTIZAR PERSONALIZADA: FAHSL NO. 080-2020

Nombre del Oferente	
RTN	
Dirección del Proveedor :	
Teléfono	
Identidad No.	
Nombre del Titular del RTN o Identidad	
Correo Electrónico	

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, Valle: por este medio invita a presentar Cotización para los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

No. DE PARTIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO DÍA	VALOR TOTAL
1	10 ✓	Unidad	Manómetro para Tanque de Oxígeno Medico Con Rosca de Salida CGA-540, Capacidad de Presión 2000 psi,		
2	10 ✓	Unidad	Esfigmomanómetro Manual para Paciente Adulto		
			Nota: Se Requiere entrega inmediata de los productos solicitados,	Sub-Total	
				Impuesto Sobre Ventas	
				TOTAL	

I.- Instrucciones para la presentación de la Oferta:

- 1.- La cotización deberá indicar el precio unitario por partida y el precio total. **Se deberá indicar el Impuesto Sobre Venta cuando aplique.**
- 2.-Presentar cotización debidamente **firmada y sellada en sobre cerrado** Indicando el Número de la Invitación a Cotizar.
- 3.-Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4.- El plazo de validez de la oferta o plazo de mantenimiento será de 30 días a partir de la fecha de recepción de la Oferta.

[Handwritten signatures and initials]

5.- Fecha Máxima de entrega de la Oferta: 27 DE MAYO DEL 2020, hasta las 2:00 PM hora oficial de la República de Honduras.

6.- Adjuntar a su oferta fotocopia de:

a.- Registro Tributario Nacional (RTN).

b.- Permiso de Operación de la Empresa.

II.- Condiciones Especiales :

1.- La fecha de vencimiento de los bienes al momento de la recepción en el Almacén del Hospital deberá ser igual o mayor a doce (12) meses

2.- El Oferente se Compromete: a reponer sin costo alguno para La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, Valle; Cualquier cantidad de bienes que no se ajustan estrictamente a las especificaciones solicitadas y que se presentan en la oferta, a los que le sobrevienen fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o irregularidades de cualquier tipo.

3.- Tiempo de entrega: Indicar en su oferta el tiempo de entrega del producto después de recibida la orden de compra aprobada. Pasado el tiempo de entrega se cobrará multa en función a lo establecido en las Disposiciones Presupuestarias del presupuesto de ingresos y egresos vigentes. El no colocar el tiempo de entrega en cada producto, se entiende que el producto es de entrega inmediata (El Hospital considera entrega inmediata: 3 días hábiles después de notificada la Orden de Compra).

III.- CONDICIONES GENERALES:

1.- Lugar de entrega: Hospital de San Lorenzo, Valle.

2.- Moneda y Forma de Pago: La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, efectuará el pago en moneda nacional (Lempira.) dentro de los 30 días calendarios después de la recepción de los bienes, mediante la emisión de cheque de caja del FIDEICOMISO que se mantiene en el Banco FICOHSA, a favor del proveedor debiéndose presentar para el mismo los siguientes documentos:

a.- Factura comercial a nombre de: Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo. RTN: 17099010303801

b.- Comprobante de Entrega.

c.- Recibo de pago firmado y sellado

d.- Solvencia Fiscal

3.- Las instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas arriba indicadas constituyen la base de cualquier oferta y se consideran incluidas en ella, y formarán parte integral de la orden de compra; a su vez constituye la aceptación incondicional por el oferente de las condiciones generales, especiales y especificaciones Técnicas.

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos aquí solicitados, para fe de lo cual firmo a continuación la presente.

Firma y Sello del oferente:

Lugar y Fecha:







Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

INVITACIÓN A COTIZAR NO. 080-2020 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>
Para: jaguilar@dimexmedica.com

26 de mayo de 2020 a las 16:41

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "DIMEX MÉDICA"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

A los interesados en participar les rogamos revisar las Condiciones de la Invitación y enviarnos sus ofertas a más tardar el día **Miércoles 27 de mayo del 2020, antes de las 2:00pm, en vista de la Situación actual que enfrenta nuestro país, ante la Emergencia decretada por el Gobierno de la República ante la presencia del VIRUS COVID-19, algunas empresas se les dificulta enviar sus ofertas en físico, debido a esta situación las empresas pueden enviar su oferta a la siguiente dirección de correo electrónico: esierra@hospitalsanlorenzo.com**

Adjuntar los siguientes documentos:

1. Favor Adjunta Permiso de Operación de la Empresa
2. Registro Tributario Nacional (RTN) e requiere entrega inmediata de los productos solicitados

La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, para efectuará el pago solicitará los siguientes documentos:

1. Factura Comercial a nombre de: Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo
2. Comprobante de Entrega
3. Recibo de Pago Firmado y Sellado
4. Solvencia Fiscal Vigente

Favor Acusar de Recibido.

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta.
Atentamente.

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



 INVITACION A COTIZAR NO. 080-2020.docx
153K



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

INVITACIÓN A COTIZAR NO. 080-2020 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

26 de mayo de 2020 a las 16:48

Para: Rosa Palma <rpalma@dicosa.net>, Gabriela Dacosta <gdacosta@dicosa.net>, dicosa34@dicosa.net

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "DISTRIBUIDORA COMERCIAL" DICOSA

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

A los interesados en participar les rogamos revisar las Condiciones de la Invitación y enviarnos sus ofertas a más tardar el día **Miércoles 27 de mayo del 2020, antes de las 2:00pm, en vista de la Situación actual que enfrenta nuestro país, ante la Emergencia decretada por el Gobierno de la República ante la presencia del VIRUS COVID-19, algunas empresas se les dificulta enviar sus ofertas en físico, debido a esta situación las empresas pueden enviar su oferta a la siguiente dirección de correo electrónico: esierra@hospitalsanlorenzo.com**

Adjuntar los siguientes documentos:

1. Favor Adjunta Permiso de Operación de la Empresa
2. Registro Tributario Nacional (RTN) e requiere entrega inmediata de los productos solicitados

La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, para efectuar el pago solicitará los siguientes documentos:

1. Factura Comercial a nombre de: Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo
2. Comprobante de Entrega
3. Recibo de Pago Firmado y Sellado
4. Solvencia Fiscal Vigente

Favor Acusar de Recibido.

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta.
Atentamente.

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN LORENZO
(El paciente, nuestra razón de ser)



INVITACION A COTIZAR NO. 080-2020.docx
153K

[Handwritten signatures and initials]



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

INVITACIÓN A COTIZAR NO. 080-2020 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

26 de mayo de 2020 a las 16:53

Para: Eybi Madrid <eybimadrid@hotmail.com>, alihernandez@visionmedicahn.com

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "VISIÓN MÉDICA"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

A los interesados en participar les rogamos revisar las Condiciones de la Invitación y enviarnos sus ofertas a más tardar el día ***Miércoles 27 de mayo del 2020, antes de las 2:00pm, en vista de la Situación actual que enfrenta nuestro país, ante la Emergencia decretada por el Gobierno de la República ante la presencia del VIRUS COVID-19, algunas empresas se les dificulta enviar sus ofertas en físico, debido a esta situación las empresas pueden enviar su oferta a la siguiente dirección de correo electrónico: esierra@hospitalsanlorenzo.com***

Adjuntar los siguientes documentos:

1. Favor Adjunta Permiso de Operación de la Empresa
2. Registro Tributario Nacional (RTN) e requiere entrega inmediata de los productos solicitados

La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, para efectuará el pago solicitará los siguientes documentos:

1. Factura Comercial a nombre de: Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo
2. Comprobante de Entrega
3. Recibo de Pago Firmado y Sellado
4. Solvencia Fiscal Vigente

Favor Acusar de Recibido.

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta.
Atentamente.

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



 INVITACION A COTIZAR NO. 080-2020.docx
153K

[Handwritten signatures]



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

INVITACIÓN A COTIZAR NO. 080-2020 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

26 de mayo de 2020 a las 16:57

Para: Paola Ventura <PaolaV@nipromed.com>, Kriszia Pavon <krisziap@nipromed.com>, Nadia Maldonado <nadiam@nipromed.com>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "NIPRO MEDICAL CORPORATION"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

A los interesados en participar les rogamos revisar las Condiciones de la Invitación y enviarnos sus ofertas a más tardar el día ***Miércoles 27 de mayo del 2020, antes de las 2:00pm, en vista de la Situación actual que enfrenta nuestro país, ante la Emergencia decretada por el Gobierno de la República ante la presencia del VIRUS COVID-19, algunas empresas se les dificulta enviar sus ofertas en físico, debido a esta situación las empresas pueden enviar su oferta a la siguiente dirección de correo electrónico: esierra@hospitalsanlorenzo.com***

Adjuntar los siguientes documentos:

1. Favor Adjunta Permiso de Operación de la Empresa
2. Registro Tributario Nacional (RTN) e requiere entrega inmediata de los productos solicitados

La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, para efectuará el pago solicitará los siguientes documentos:

1. Factura Comercial a nombre de: Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo
2. Comprobante de Entrega
3. Recibo de Pago Firmado y Sellado
4. Solvencia Fiscal Vigente

Favor Acusar de Recibido.

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta.
Atentamente.

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



 INVITACION A COTIZAR NO. 080-2020.docx
153K



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

INVITACIÓN A COTIZAR NO. 080-2020 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>
Para: Alan Nuñez <operaciones.demh@grupomeyko.hn>

26 de mayo de 2020 a las 16:38

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "GRUPO ME-Y-KO"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

A los interesados en participar les rogamos revisar las Condiciones de la Invitación y enviarnos sus ofertas a más tardar el día ***Miércoles 27 de mayo del 2020, antes de las 2:00pm, en vista de la Situación actual que enfrenta nuestro país, ante la Emergencia decretada por el Gobierno de la República ante la presencia del VIRUS COVID-19, algunas empresas se les dificulta enviar sus ofertas en físico, debido a esta situación las empresas pueden enviar su oferta a la siguiente*** dirección de correo electrónico: esierra@hospitalsanlorenzo.com

Adjuntar los siguientes documentos:

1. Favor Adjunta Permiso de Operación de la Empresa
2. Registro Tributario Nacional (RTN) e requiere entrega inmediata de los productos solicitados

La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, para efectuará el pago solicitará los siguientes documentos:

1. Factura Comercial a nombre de: Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo
2. Comprobante de Entrega
3. Recibo de Pago Firmado y Sellado
4. Solvencia Fiscal Vigente

Favor Acusar de Recibido.

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta.
Atentamente.

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



 INVITACION A COTIZAR NO. 080-2020.docx
153K



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

INVITACIÓN A COTIZAR NO. 080-2020 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

26 de mayo de 2020 a las 16:44

Para: Roger Larios <life.medical@yahoo.com>, Miriam Lainez <mlainezlifecompany@gmail.com>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "LIFE MEDICAL INTERNATIONAL"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

A los interesados en participar les rogamos revisar las Condiciones de la Invitación y enviarnos sus ofertas a más tardar el día ***Miércoles 27 de mayo del 2020, antes de las 2:00pm, en vista de la Situación actual que enfrenta nuestro país, ante la Emergencia decretada por el Gobierno de la República ante la presencia del VIRUS COVID-19, algunas empresas se les dificulta enviar sus ofertas en físico, debido a esta situación las empresas pueden enviar su oferta a la siguiente*** dirección de correo electrónico: esierra@hospitalsanlorenzo.com

Adjuntar los siguientes documentos:

1. Favor Adjunta Permiso de Operación de la Empresa
2. Registro Tributario Nacional (RTN) e requiere entrega inmediata de los productos solicitados

La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, para efectuará el pago solicitará los siguientes documentos:

1. Factura Comercial a nombre de: Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo
2. Comprobante de Entrega
3. Recibo de Pago Firmado y Sellado
4. Solvencia Fiscal Vigente

Favor Acusar de Recibido.

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta.
Atentamente.

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN LORENZO
(El paciente, nuestra razón de ser)



INVITACION A COTIZAR NO. 080-2020.docx

153K

[Handwritten signature]



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

INVITACIÓN A COTIZAR NO. 080-2020 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>
Para: ventas@medimashn.com

26 de mayo de 2020 a las 17:52

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "DROGUERÍA MEDIMAS"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

A los interesados en participar les rogamos revisar las Condiciones de la Invitación y enviarnos sus ofertas a más tardar el día **Miércoles 27 de mayo del 2020, antes de las 2:00pm, en vista de la Situación actual que enfrenta nuestro país, ante la Emergencia decretada por el Gobierno de la República ante la presencia del VIRUS COVID-19, algunas empresas se les dificulta enviar sus ofertas en físico, debido a esta situación las empresas pueden enviar su oferta a la siguiente dirección de correo electrónico: esierra@hospitalsanlorenzo.com**

Adjuntar los siguientes documentos:

1. Favor Adjunta Permiso de Operación de la Empresa
2. Registro Tributario Nacional (RTN) e requiere entrega inmediata de los productos solicitados

La Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo, para efectuar el pago solicitará los siguientes documentos:

1. Factura Comercial a nombre de: Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo
2. Comprobante de Entrega
3. Recibo de Pago Firmado y Sellado
4. Solvencia Fiscal Vigente

Favor Acusar de Recibido.

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta.
Atentamente.

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



 INVITACION A COTIZAR NO. 080-2020.docx
153K



FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO, VALLE

Colonia Morazán San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781- 11-58

Solicitud de Adquisición de Bienes

Departamento/Unidad/Servicio/Sala/ Solicitante:	Fecha de Elaborada la solicitud
ALMACÉN	25/5/2020
Dirigida a la SUB-DIRECCION ASISTENCIAL	Fecha de Recibida
	25-Mayo-2020

No.	Descripción del Bien/Servicio (Especificaciones Técnicas)	Presentación (Tipo de Unidad)	Cantidad Solicitada
1	Manómetros de Oxígeno	Unidad	10 ✓
2	Esfigmomanómetros para pacientes Adultos	Unidad	10 ✓
*****UL*****			

Justificación del Bien/Servicio: Los productos solicitados se requieren de carácter urgente dado que el Hospital se encuentra dentro de los hospitales priorizados para atender la emergencia por CORONAVIRUS. Cabe mencionar que no contamos con estos productos y es de urgente necesidad para la dispensación de oxígeno medicinal a los pacientes y toma de presión arterial.

SOLICITANTE- Unidad/Departamento que solicita: ALMACÉN

Nombre y Apellido: Dra. Danamy López

Firma y Sello del Solicitante:



Línea Presupuestaria Aprobada por la Sub-Dirección de Gestión de Recursos

Nombre y Apellido:	GRUPO DEL GASTO:
Fecha, Firma y Sello:	OBJETO DEL GASTO:
Observación:	

Vo.Bo. Sub-Dirección Ejecutiva

Nombre y Apellido:

[Handwritten signature and stamp of the Sub-Directorate of Management of Resources]

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	OP-324-2020	AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD No.	AD0001-66014
A FAVOR DE:	DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.		
VALOR	L	29,747.86	
EN LETRAS:	Veinte y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 86/100		

PROGRAMA	99	FUENTE	11	CUENTA	01424551	SUBCUENTA	7028695
TIPO DE PAGO	CHEQUE	EMITIR					
	TRANSFERENCIA						
DESCRIPCION	PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182-2020, FACTURA No. 000-002-01-00008943.						
OBJETO DE GASTO	VALOR						
42400	L. 25,867.70						
ISV	L. 3,880.16						
TOTAL	L. 29,747.86						
VALOR EN LETRAS							

FECHA: 15/6/2020

Veinte y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 86/100

M. Adam Reyes
Gestión Financiera



FUNDACION HOSPITAL SAN LORENZO, VALLE
Colonia Morazán San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781- 1434




ACTA DE RECEPCION

Por este medio, hacemos constar que hemos recepcionados de la Empresa : "DIMEX MEDICA S.A. DE C.V." los bienes y/o servicios que fueron adquiridos mediante Orden de Compra No. 182-2020 ,Según Factura No.000-002-01-00008943 que se detallan a continuación:

Nº	DESCRIPCION	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD ENTREGADA UNIDAD
1	Electrocardiografo Cardiovascular (Minimo 3 Canales) (Incluir 10 unidades de Papel para Electrocardiografo) Marca: Edam Modelo: SE-1/SE-3 SMART ECG SE-3	Unidad	1 ✓
2	UL.....		
3			
Los bienes y/o servicios, antes descritos han sido previamente verificados, se encuentran fisicamente en buen estado y han sido recibidos con satisfacción, por lo cual se firma la presente acta de recepción en, San Lorenzo Valle, a los 4 días del mes de Junio del año 2020			


Recibí conforme: _____

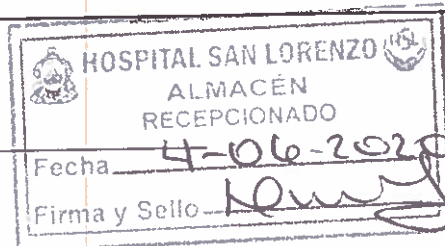

Cliente: 2-01-0064 FUNDACION DE APOYO HOSPITAL SAN LORENZO
Dirección: SAN LORENZO, VALLE 2781-1433
R.T.N. Cliente: 17099010303801
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: 2480C0-41177B-BC4C9C-251684-46CCDB-F6 ✓
Fecha Limite de Emision: 17/12/2020 ✓
Rango Autorizado: del 000-002-01-00008101 al 000-002-01-00011700
Observación: OC. 182-2020

Vendedor: JULIO AGUILAR
Fecha: 04/06/2020
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 04/07/20

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
104-0001	UND	1	✓ 0		ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES SMART ECG SE-3	001	25,867.7	0.00	15	25,867.70

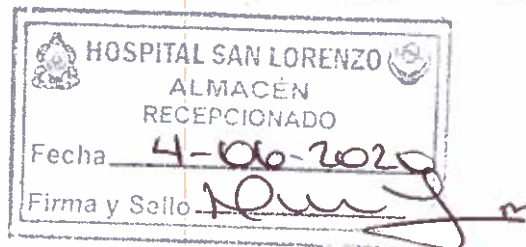

COPIA



VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 86/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 25,867.70
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 3,880.16
Total a Pagar: 29,747.86

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001262611

Nombre o Razón Social: DIMEX MEDICA S. A. DE C. V.

Nombre Comercial: DIMEX MEDICA S A DE C V

Teléfono: 31772500

Email: dimexmedica@dimexmedica.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: SAN FELIPE, CASA NO.: SN,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, No. SN,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00008943 ✓

Fecha de Autorización: 17/12/2019

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA ✓

Fecha de Vencimiento: 17/12/2020 ✓

CAI: 2480C0-41177B/BC4C9C-251684-46CCDB-F6 ✓

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00008101

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00011700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01996035

AGN SAN LORENZO SLO

17 JUNIO

2020

Lugar y Fecha

*DIMEX MEDICA SA DE CV

*****29,747.86

Páguese a la orden de

* Veintinueve mil setecientos cuarenta y siete lempiras con 86/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa**
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆01996035

RS Hondureña de Honduras, S.A. de CV



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. OC-182-2020

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

4 de junio de 2020 a las 15:52

Para: Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>

CC: Juan Ramón Osorio <josorio@hospitalsanlorenzo.com>, Rosa María Cárcamo <rcarcamo@hospitalsanlorenzo.com>, Mirian Reyes <mreyes@hospitalsanlorenzo.com>, Danamy Lopez <dlopez@hospitalsanlorenzo.com>, Claudia Torres <ctorres@hospitalsanlorenzo.com>

ESTIMADOS SEÑORES: DIMEX MEDICA ✓

Por este medio Estoy Notificando la Orden de Compra que encontraran adjunta. Favor acusar recibo y uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto con ustedes para coordinar la entrega del producto.

Por favor tomar en cuenta la siguiente información al momento de elaborar la factura.

Nombre: Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo

RTN 17099010303801

Teléfono: 2781-1166

Dirección, Barrio Morazán

Así mismo entregar en almacén los siguientes documentos al momento de la entrega del producto:

Factura Original

Comprobante de entrega

Solvencia Fiscal

Constancia de Estar Sujetos Pagos A cuenta (SAR).

Si la entrega del producto es Parcial la Factura debe ser emitida por la cantidad entregada,
Nota: De no Adjuntar los documentos Solicitados no se podrá recibir el producto.
Favor acusar de recibido.

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN LORENZO
¡El paciente, nuestra razón de ser!

OC-182-2020 DIMEX MEDICA.pdf
2293K



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>

4 de junio de 2020 a las 14:30

Para: Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

Buenas tardes estimado,

Tiempo de garantía 1 año por desperfectos de fábrica, estamos en la disposición de brindar capacitación de usuario vía vídeo llamada o presencial si vienen a la oficina por el tema que estamos pasando con la emergencia nacional.

Se pueden reforzar conocimientos las veces que necesiten.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>
Para: Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>

4 de junio de 2020 a las 14:20

Estimado Ing. Aguilar

En seguimiento a la Cotización de los equipos solicitados, favor indíquenos cuál es el tiempo de garantía que ofrecen para los equipos, y cual es el soporte o asistencia técnica que nos brindarán.

Quedo atento a su pronta respuesta,

Atentamente,

El mié., 3 de jun. de 2020 a la(s) 17:06, Julio Aguilar (jaguilar@dimexmedica.com) escribió:

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION	
<i>Modalidad de Compra</i>	<i>Invitación a Cotizar Personalizada: Equipo Médico para el Hospital San Lorenzo</i>
<i>Objetivo de Compra:</i>	<i>Adquisición de Equipo Médico para el Hospital San Lorenzo</i>
<i>Fecha límite para presentación de ofertas:</i>	<i>3/06/2020</i>
<i>Lugar en que se realizó la evaluación:</i>	<i>Hospital San Lorenzo</i>
<i>Fecha de evaluación:</i>	<i>4/06/2020</i>

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Laura Castillo	Control Interno
Noel Matute	Administrador de Inventario
Danamy López	Jefe de Almacén

I. INTRODUCCION

Se procedió a enviar la solicitud de cotización a las empresas que se detallan a continuación:

- **AMESY**
- **SIMEDIC**
- **NOSTRAPHARMA**
- **INVERSIONES Y EQUIPO**
- **DISTRIBUIDORA COMERCIAL**
- **DIMEX MEDICA**

El procedimiento de evaluación acordado por los miembros de la Comisión Evaluadora fue el siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las Instrucciones Especiales pactadas en la cotización.
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones solicitadas,
- Evaluación económica.

II. EVALUACION

1. Apertura

A continuación, se detallan las empresas que presentaron oferta en respuesta a esta Solicitud a Cotizar: (Ver anexo)

- **INVERSIONES Y EQUIPO**
- **DISTRIBUIDORA COMERCIAL**
- **DIMEX MEDICA**

2. Verificación de cumplimiento de requisitos formales

- Las empresas que presentaron ofertas lo hicieron dentro del plazo fijado.

3. Evaluación Económica y Reporte de Adjudicación

Cuadro Resumen de las Ofertas (Ver anexo II)

La verificación aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos en las ofertas presentadas.

4. RECOMENDACION DE ADJUDICACION

La Adquisición de Equipo Médico para el Hospital San Lorenzo solicitados por Sub-

[Handwritten signature]

Dirección Asistencial del Hospital San Lorenzo se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización con el objeto de promover la competencia en precio, "Conforme a lo establecido en el artículo; 38 y 63 de la Ley de Contratación del Estado, artículo: 139, 152; del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 70 de las Disposiciones Generales Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2020" Se recomienda la adjudicación de la siguiente manera:

✓
Adjudicar a DIMEX MEDICA: La partida 1 por ser el segundo oferente en menor precio y por criterio técnico del Dr. Carlos Arturo Ramos dado que este aparato cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y su manejo es más funcional para el personal que lo utilizará en la Sala de COVID-19 ya que los comandos de este aparato son de manipulación manual y no digital.


✓
MONTO TOTAL NETO: VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (LPS.25,867.70)


✓
Adjudicar a DICOSA: Para la partida 2 por ser el oferente con el menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas (Oferta 2 unidades de Lps. 40,000.00 y 2 unidades de Lps.44,000.00)

✓
MONTO TOTAL NETO: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.168,000.00)


Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, a los 4 días del mes de Junio del 2020.


DANAMY LOPEZ
JEFE DE ALMACÉN


LAURA CASTILLO
CONTROL INTERNO

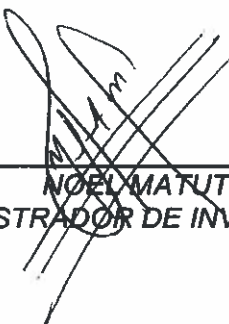
NOEL MATUTE
ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS

OPINIÓN TÉCNICA CALIFICADA:

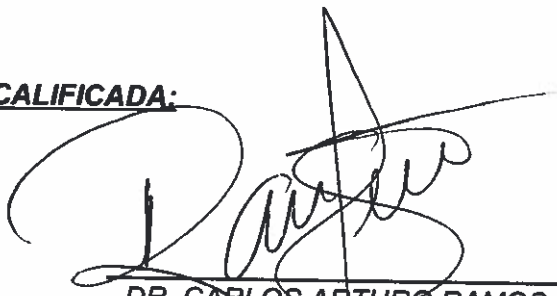
DR. CARLOS ARTURO RAMOS
MEDICO INTERNISTA DEL HOSPITAL SAN LORENZO

Anexos:

Anexo	I	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo	II	Cuadro Resumen de Ofertas
Anexo	III	Ofertas
Anexo	IV	Solicitudes de Invitaciones Cotizaciones
Anexo	V	Solicitud de Adquisición







FUNDACION DE APOYO DEL HOSPITAL SAN LORENZO, VALLE



Colonia Morazán San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781- 1434

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Tipo de Proceso: Invitación a Cotizar Personalizada

Objetivo de la compra: Adquisición de Equipo Medico

I.-Lugar, fecha y hora de apertura de las Sobres que contienen las Ofertas:

Fecha de Invitación:	03/06/2020	Fecha y hora de apertura de ofertas:	4 de Junio del 2020 a las 11 :10 a.m.
No. de oferentes invitados:	6	No. de ofertas recibidas:	3
Fecha y hora de presentación de ofertas:	3 de Junio del 2020	Lugar: Departamento de Logística y Suministros	Hospital San Lorenzo

II.- Monto de las Ofertas de los Proveedores participantes que cumplieron con los requisitos:

No.	Oferente	Monto de la oferta Lps.
1	Dimex Medica S.A. de C.V.	Lps.154,647.52 ✓
2	Distribuidora Comercial S.A.	Lps.219,535.00 ✓
3	Inversiones y Equipos S. de R.L. de C.V.	Lps.299,690.00 ✓

III.- Nombre y firma de la Comisión de Adquisiciones para la evaluación de las ofertas:

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Laura Castillo	Control Interno		04/06/2020
Noel Matute	Administrador de Inventarios		04/06/2020
Danamy López	Jefe de Almacén		04/06/2020

RESUMEN DE INVITACIÓN A COTIZAR:

N°	Cantidad	Presentación	DESCRIPCIÓN	DICOSA		DIMEX		INVERSIONES Y EQUIPOS	
				PU	PT	PU	PT	PU	PT
1	1	Unidad	Electrocardiografo Cardiovascular (Minimo 3 Canales) (Incluir 10 unidades de papel para el Electrocardiografo)	22,900.00	22,900.00	25,867.70	25,867.70	27,000.00	27,000.00
2	2	Unidad	Monitor de signos vitales de transporte adulto	40,000.00	80,000.00	54,304.20	108,608.40	58,400.00	116,800.00
3	2	Unidad	Monitor de signos vitales de transporte adulto	44,000.00	88,000.00				
4									
			MONTO TOTAL ADJUDICADO		168,000.00		25,867.70		

Observaciones: La Comisión de Evaluación de las ofertas recomienda adjudicar el Electrocardiografo Cardiovascular a la Empresa DIMEX MEDICA por criterio técnico del Dr. Carlos Arturo Ramos dado que este aparato cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y su manejo es mas funcional para el personal que lo utilizará en la Sala de COVID-19 ya que los comandos de este aparato son de manipulación manual y no digital. Para la partida 2 DICOSA (Oferente de menor precio) Oferta 2 unidades de Lps. 40,000.00 y 2 unidades de Lps.44,000.00 la Comisión de Evaluación de las ofertas recomienda adjudicarlo a este proveedor por ofertar los productos que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

DANAMY LOPEZ
JEFE DE ALMACÉN

LAURA CASTILLO
CONTROL INTERNO

NEEL MATUTE
ADMINISTRADOR DE
INVENTARIOS

OPINIÓN TÉCNICA CALIFICADA:

DR. CARLOS ARTURO RAMOS

MEDICO INTERNISTA DEL HOSPITAL SAN LORENZO



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>
Para: Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 16:22

Buenas tardes estimado Lic. Sierra,

Adjunto cotización solicitada con ficha técnica del producto.

De los monitores solo tenemos 2 unidades para entrega inmediata con parámetros y accesorios adulto, sin carro de transporte.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

 UMEC-12.pdf
392K

 EDAN_Brochure_ECG SE-1 y SE-3_ING.pdf
1269K

 169_2020_JA ELECTROCARDÍOGRAMO EDAN SE-3_+MONITOR DE SIGNOS
VITALES_HOSPITAL SAN LORENZO.pdf
129K



www.dimexmedica.com

COTIZACIÓN NO. 167_2020_JA
FECHA DE ELABORACIÓN: 2/6/2020

CONDICIONES DE OFERTA	
Casa:	EDAN(electrocardiógrafo) MINDRAY(monitores)
Entrega:	INMEDIATA
Validez:	2 DÍAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Pago:	CONTADO/CRÉDITO ACEPTAMOS ORDEN DE COMPRA

DATOS	
Señores:	HOSPITAL SAN LORENZO
Titular:	DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.
RTN	0801-9001-262611
CAI	2480C0-41177B-BC4C9C-251684-46CCDB-F6
Fecha Límite:	17/12/2020
Rango:	000-002-01-00008101-00011700
Dirección del Proveedor:	BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO #3002, ATRÁS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA.
Teléfono:	(504) 2280-4444

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT	PREC. TOTAL
1	12-104-0001	ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES SMART ECG SE-3	1	L25,867.70	L25,867.70 ✓
2	12-122-0117	MONITOR DE PARAMETROS uMEC12 M2K3B-CTO-S01 CON ACCESORIOS PARA PACIENTE ADULTO, SPO2, NIBP, ECG Y TEMP. *****ÚLTIMA LÍNEA*****	2	L54,304.20	L108,608.40
				Sub-Total	L134,476.10
				I.S.V	L20,171.42
				Total	L154,647.52

Cotización preparada por:

Julio Aguilar

(504) 3177-2490


Sitio Web:

www.dimexmedica.com

jaguilar@dimexmedica.com

Observaciones:

Precios sujetos a cambios en base a cantidades requeridas.



TEG: 2280-4444 | 2280-4445 SPS: 2553-5000 | 2553-5002
Barrio San Felipe, Calle Bustamante y Rivero, No. 3002, atrás de iglesia Medalla Milagrosa, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Oficina Regional: Zona de la Cervecería, 3era avenida 16 calle NO, local de la esquina. Esquina opuesta a Por Salud.
www.dimexmedica.com

Handwritten signature

EDAN




SE-1/SE-3

Single/Three-channel ECG



SE-1/SE-3
Single/Three-channel ECG

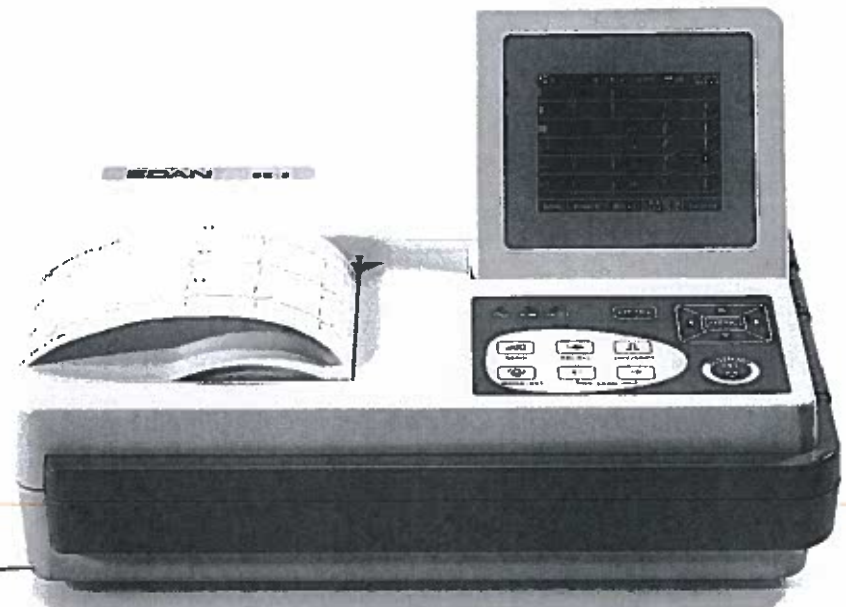

*Dr. Carlos H. Lopez
Jefe Departamento de Informatica
H-S-C*



EDAN Edan Instruments, Inc.

• 3F - B, Heshan Medical Equipment Park, Nanshi Rd 10186, Shantou, Heshan Guangdong, 518067 P.R. China
• Tel: +86-755-28895338 • Fax: +86-755-28895339 • www.edan.com.cn • Email: info@edan.com.cn

• All rights reserved. Features and specifications are subject to change without notice



BND-B00-05-1025-012-0214020

Care for Health

Handwritten signature and date: 2007

EDAN

SE-3 series Three-channel ECG



Portable & User-friendly Design

- Foldable LCD screen, vivid waveform display
- Built-in rechargeable Li-ion battery, AC/DC power supply
- Communication Interface: Ethernet/RS232/USB

Streamlined Workflow

- Support barcode scanner to simplify patient information input
- One-button operation
- Auto/Manual/Rhythm/Off work modes
- Automatic baseline adjustment
- Lead-off detection and alarm

Accurate Clinical Performances

- 12 leads simultaneous acquisition with 24-bit A/D converter optional
- Automatic ECG measurements and interpretation tested with CSE/AHA/MIT database
- Complete digital filtering, resisting baseline drift, AC and EMG interference

Flexible Printing Solutions

- Built-in high-resolution thermal printer
- Grid printing on normal thermal paper
- 12-lead grid printing on normal A4 paper through external printer

Data Management

- Large data storage up to 500 records and can be enlarged by USB flash disk
- Multiple report formats including PDF, SCP, FDA-XML, DICOM (optional)
- PC-based ECG data management software (optional)



Foldable Screen



Portable Design
(Handle Optional)



One-button Operation

Sensitivity Adjustment


Mode Switch

Start/Stop




SE-3 (Monochrome)

PC-based ECG Data Management Software

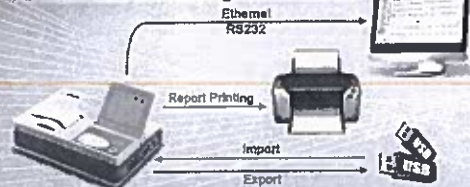

Smart ECG Viewer

Intuitive interface to improve your work efficiency

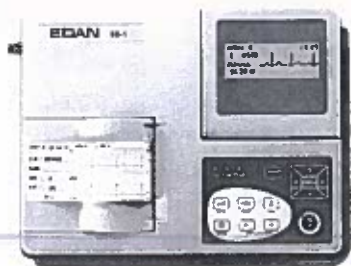

SE-1 Single-channel ECG

- Vivid waveform with foldable LCD display
- Built-in high resolution thermal printer
- Built-in rechargeable Li-ion battery, AC/DC power supply
- Well designed membrane keyboard

- Digital filtering, resisting baseline drift, AC and EMG interference
- Automatic baseline adjustment
- Auto/Manual work mode
- Lead-off detection and alarm



Carrying Bag

Rolling Stand

Especificaciones técnicas

uMEC10 Tamaño del monitor: 12.1" (305 mm x 229 mm) + 13.1" (330 mm) en posición vertical y horizontal Peso: 1.1 kg (sin cables)		Parámetros Temperatura: 0 a 50°C (32 a 122°F) Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)	
uMEC12 Tamaño del monitor: 12.1" (305 mm x 229 mm) + 13.1" (330 mm) en posición vertical y horizontal Peso: 1.1 kg (sin cables)		uMEC12 (solo para uMEC12) Temperatura: 0 a 50°C (32 a 122°F) Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)	
Pantalla Tipo: uMEC10: Pantalla LED a color de 12.1" (305 mm x 229 mm) uMEC12: Pantalla LED a color de 12.1" (305 mm x 229 mm) Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800 Panel de control: uMEC10: 12.1" (305 mm x 229 mm) uMEC12: 12.1" (305 mm x 229 mm)		CO2 (solo para uMEC12) Temperatura: 0 a 50°C (32 a 122°F) Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)	
ECG Compatibilidad: uMEC10: ECG 12 leads uMEC12: ECG 12 leads Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800		CO2 (solo para uMEC12) Temperatura: 0 a 50°C (32 a 122°F) Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)	
Respiración Tipo: uMEC10: 12.1" (305 mm x 229 mm) uMEC12: 12.1" (305 mm x 229 mm) Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800		CO2 (solo para uMEC12) Temperatura: 0 a 50°C (32 a 122°F) Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)	
Temperatura Tipo: uMEC10: 12.1" (305 mm x 229 mm) uMEC12: 12.1" (305 mm x 229 mm) Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800		CO2 (solo para uMEC12) Temperatura: 0 a 50°C (32 a 122°F) Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)	



uMEC Monitor para pacientes

Cómo eliminar los costos altos
de la atención médica de calidad



Mindray es una marca registrada o trademark owned by Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
© 2015 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Exportar, copiar, reproducir, o cualquier otro uso no autorizado es estrictamente prohibido.
P/N: ES-L1-uMEC-210285-01-20160417

mindray


mindray
healthcare within reach




Rendimiento avanzado

Con 25 años de experiencia de Mindray en el monitoreo de pacientes, los monitores para pacientes de la serie uMEC cubren las necesidades clínicas ofreciendo mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales. Cuando el monitoreo es confiable, usted puede estar más seguro al tomar decisiones clínicas.

- El Algoritmo ECG con derivaciones múltiples patentado de Mindray mejora enormemente la precisión de las mediciones y reduce falsas alarmas
- La técnica de medición rápida PNI disminuye el malestar provocado por la presión de inflado de la pulsera, especialmente en pacientes que sufren de hipertensión o hipotensión
- El algoritmo contra interferencia SpO₂ brinda una medición precisa incluso cuando el paciente está en movimiento
- La amplia capacidad para el almacenamiento de datos permite una revisión exhaustiva de la historia clínica del paciente; también admite dispositivos USB de almacenamiento externo
- 8 horas de funcionamiento con una batería de iones de litio



Mediciones fundamentales avanzadas



Enorme capacidad de datos



Batería de larga duración



De uso fácil

El monitor para pacientes fácil de usar uMEC ayuda a simplificar el flujo de trabajo y a mejorar la eficiencia. El monitor ofrece una interfaz muy intuitiva que facilita las aplicaciones de manera más rápida y sencilla, incluso para los usuarios nuevos. El personal de atención médica necesita menos tiempo para las capacitaciones y dedica más tiempo al cuidado de los pacientes.

- Pantalla LED de 10,4 pulgadas/12,1 pulgadas de alta resolución con pantalla táctil opcional
- Admite distintos diseños de la pantalla de monitoreo para diversas necesidades clínicas, incluyendo fuente de tamaño grande, pantalla completa/media, monitoreo de 7 derivaciones, vista de la otra cama, etc.
- Las configuraciones predeterminadas satisfacen los requisitos médicos generales, no es necesario ajustar las configuraciones antes del uso; ayuda a comenzar a usar el equipo rápidamente
- Estadísticas para cambios de la frecuencia cardíaca y para el control de la presión arterial ambulatoria, donde se muestran los valores altos y bajos
- El peso inferior a 3,5 kg con la batería permite transportar el equipo
- El gabinete exclusivo para accesorios permite el manejo eficiente de los mismos
- El diseño de una pieza facilita la limpieza



Análisis HR/BP



Interfaces fáciles de usar




Gabinete exclusivo para accesorios



Alta durabilidad

Para brindar eficiencia en distintos ambientes, uMEC ha superado pruebas de seguridad eléctrica y pruebas de confiabilidad estrictas. Es extremadamente duradero y tiene una larga vida útil.

- La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40°C y no es afectada por extremos
- Protección contra caídas de 0,75 m y resistencia al agua de IPX1
- Robusta cubierta de plástico que soporta el paso del tiempo y no se vuelve amarilla, es altamente resistente a la corrosión
- Bajo consumo de energía y diseño sin ventilador que lo transforma en un aparato ecológico y reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Los accesorios Mindray son altamente confiables y están fabricados con materiales y técnicas de calidad



Accesorios de alta calidad



Protección contra caídas



Compatible con múltiples agentes de limpieza





INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L DE C.V

Col. Kennedy 5ta entrada contiguo a maquilas, Complejo de Bodega Simón. Bod #3 Telefono. 22 28 50 21

Correo electronico: invequipos2014@hotmail.com

RTN:0801-9013-553050

COTIZACION N° 000207-2020

FECHA
3/6/2020

CLIENTE
Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo

DIRECCION
SAN LORENZO VALLE

CAI: 096B9D-67080E-BA4F90-042FF6-525A90-25

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	ISV S/N	TOTAL
1	1	C/U	Electrocardiógrafo Cardiovascular de 3 canales (Incluye 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	L. 27,000.00	SI	L. 27,000.00
			MARCA: ADVANCED			
			MODELO: ECG--3			
			GARANTIA: 2 AÑOS			
			ENTREGA: 25 DIAS			
2	4	C/U	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	L. 58,400.00	SI	L. 233,600.00
			MARCA: ADVANCED			
			MODELO: PM-2000M			
			GARANTIA: 2 AÑOS			
			ENTREGA: 25 DIAS			
			U.L.			
SUB TOTAL						260,600.00
ISV						39,090.00
TOTAL						299,690.00



TANIA BARAHONA
0708-1994-00177
DEPTO. DE ICITACIONES

ACEPTADO CLIENTE


[Handwritten signature]

electro- CARDIOGRAPH

ECG-3 Plus

Single/Three-channel ECG

- LCD display waveforms, parameters configurable
- Compatible with external printer for 12 leads simultaneous printing
- Interpretation database
- *Presentación de ondas de forma en LCD, parámetros configurables*
- *Compatible con impresoras externas para impresión de 12 derivaciones simultáneas*
- *Base de datos interpretativa*

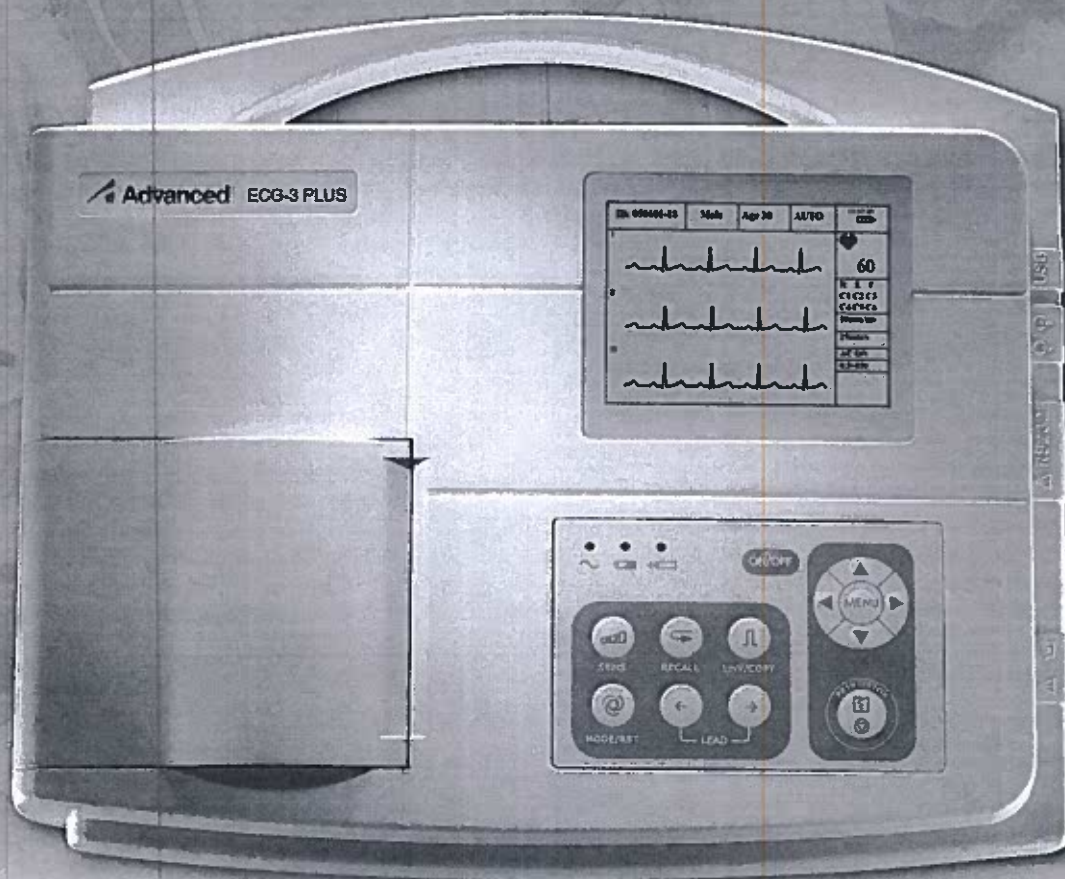

ECG-3 PLUS ELECTROCARDIOGRAPH



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INPUT CIRCUIT	Floating input circuit, protection from defibrillation and pace maker	CIRCUITO DE ENTRADA	Circuito de entrada flotante, protección de desfibrilación y pace maker
LEAD	Standard 12 leads	DERIVACIONES	12 Derivaciones estándar
ACQUISITION MODE	Simultaneous 12 lead	MODO DE ADQUISICIÓN	12 derivaciones simultáneas
A/D CONVERTER	12 bits	CONVERTIDOR A/D	12 bits
MEASUREMENT RANGE	$\pm 5\text{mVp-p}$	RANGO DE MEDICIÓN	$\pm 5\text{mVp-p}$
TIME CONSTANT	$\geq 3.2\text{sec}$	CONSTANTE DE TIEMPO	$\geq 3.2\text{seg}$
FREQUENCY RESPOND	0.05Hz - 150Hz	RESPUESTA DE FRECUENCIA	0.05Hz - 150Hz
CALIBRATION VOLTAGE	1mV $\pm 3\%$	VOLTAJE DE CALIBRACIÓN	1mV $\pm 3\%$
SENSITIVITY	2.5, 5, 10, 20, 10 (mm/mV)	SENSIBILIDAD	2.5, 5, 10, 20, 10 (mm/mV)
INPUT IMPEDANCE	50M Ω	IMPEDANCIA DE ENTRADA	50M Ω
INPUT CIRCUIT CURRENT	$\leq 50\text{nA}$	CORRIENTE DE ENTRADA AL CIRCUITO	$\leq 50\text{nA}$
NOISE LEVEL	$< 15 \mu\text{Vp-p}$	NIVEL DE RUIDO	$< 15 \mu\text{Vp-p}$
ANTI BASELINE DRIFT	Automatic	ANTI BASE	Automático
PATIENT LEAKAGE CURRENT	$< 10 \mu\text{A}$ (220V - 240V)	FUGA DE CORRIENTE A PACIENTE	$< 10 \mu\text{A}$ (220V - 240V)
PATIENT AUXILIARY CURRENT	$< 0.1 \mu\text{A}$ (DC)	CORRIENTE AUXILIAR DEL PACIENTE	$< 0.1 \mu\text{A}$ (DC)
FILTERS	EMG filter 25Hz/35Hz/45Hz (-3dB)/OFF DFT Filter 0.05/0.25 Low-pass filter 75Hz/100Hz/150Hz AC Filter 50Hz/60Hz	FILTROS	Filtro EMG 25Hz/35Hz/45Hz (-3dB)/OFF Filtro DFT 0.05/0.25 Filtro paso-bajo 75Hz/100Hz/150Hz Filtro AC 50Hz/60Hz
CMRR	$> 110\text{dB}$	CMRR	$> 110\text{dB}$
RECORDING MODES	Auto: 3CH, 3/2CH, 3CH+1R, 1CH, 1CH+1R Manual: 3CH, 3/2CH, 1CH Rhythm: Single rhythm lead	MODOS DE GRABACIÓN	Auto: 3CH, 3/2CH, 3CH+1R, 1CH, 1CH+1R Manual: 3CH, 3/2CH, 1CH Ritmo: Derivación de ritmo unitario
RHYTHM LEAD	Any lead selectable	DERIVACIÓN DE RITMO	Cualquier derivación seleccionable
SAFETY STANDARD	IEC/ICF	SEGURIDAD ESTANDAR	IEC/ICF
POWER SUPPLY	AC (100-240V@50/60Hz)	FUENTE DE PODER	AC (100-240V@50/60Hz)
BATTERY	Rechargeable Li-Ion Battery, 2200mAh, 14.4V for 3 hours continuously operation	BATERÍA	Batería recargable Li-Ion, 2200 mAh, 14.4V para 3 horas de operación continua
RECORDER	Thermal printer	IMPRESORA	Impresora Térmica
RECORDING PAPER	80mm x 20mm	PAPEL DE IMPRESIÓN	80mm x 20mm
RECORDING SPEED	5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ($\pm 3\%$)	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ($\pm 3\%$)
WEIGHT	Approximately 2.5 kg (including battery and paper)	PESO	Aproximado 2.5 Kg (batería y papel incluido)
DIMENSIONS	288mm x 210mm x 70mm	DIMENSIONES	288mm x 210mm x 70mm
DISPLAY	320x240 dpi LCD	PANTALLA	320x240 dpi LCD
EXTERNAL INPUT	$> 100\text{K} \Omega$ sensitivity 10mm/V $\pm 5\%$	ENTRADA INTERNA	$> 100\text{K} \Omega$ sensibilidad 10mm/V $\pm 5\%$
EXTERNAL OUTPUT	100K Ω sensitivity 1V/mV $\pm 5\%$	ENTRADA EXTERNA	100K Ω sensibilidad 1V/mV $\pm 5\%$
COMMUNICATION PORT	Ethernet, RS232, USB	PUERTOS DE COMUNICACIÓN	Ethernet, RS232, USB

Contact us for additional information.

Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




Advanced
Instrumentations

6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166
Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351
sales@advanced-inst.com
www.advanced-inst.com



Patient Monitor PM-200M


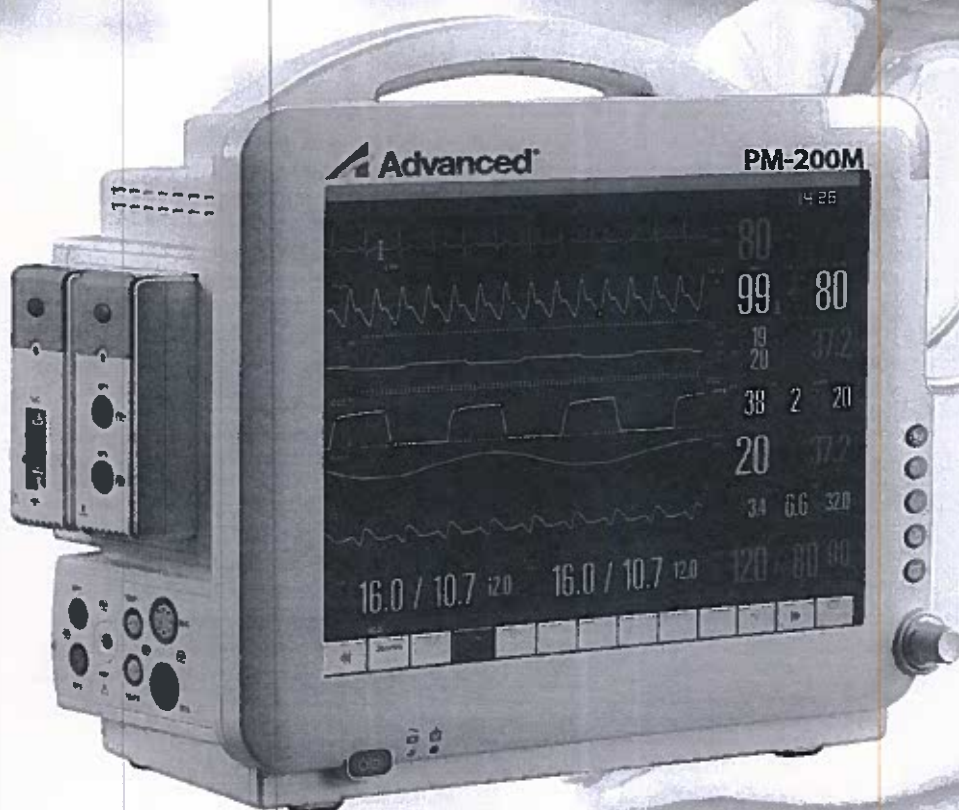


PAT

PM-200M

Patient Modular Monitor

The PM-200M is a full modular monitor designed to meet everyday clinical requirements, integrating seamlessly into the hospital work-flow. With its lightweight and plug-and-play modular design, its powerful functions and intuitive user interface, the PM-200M patient monitor is therefore the best choice for acute care.

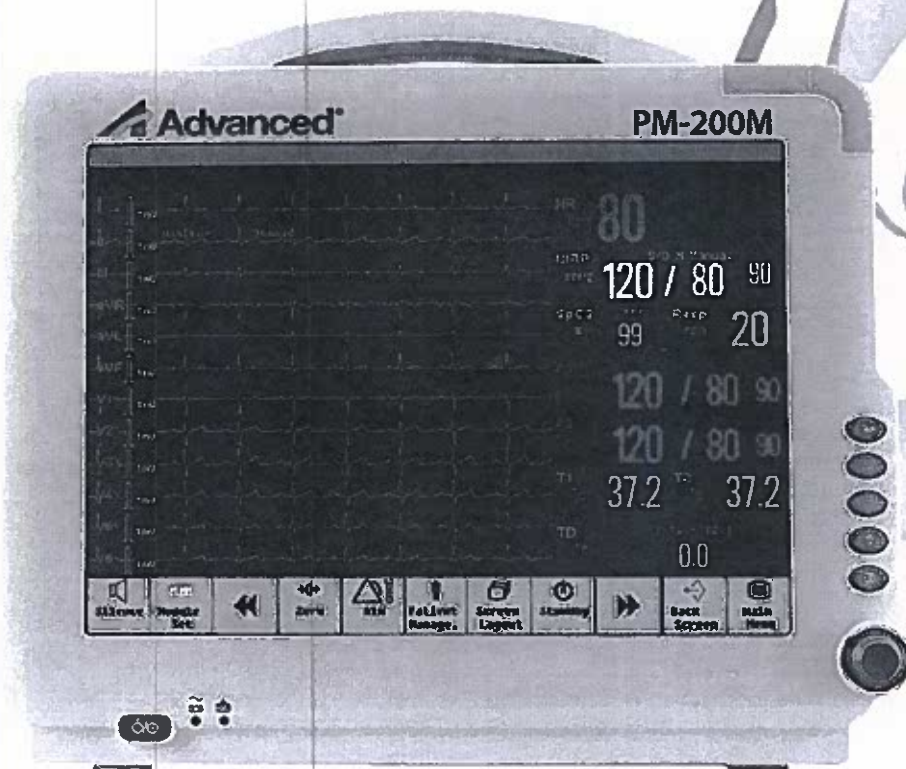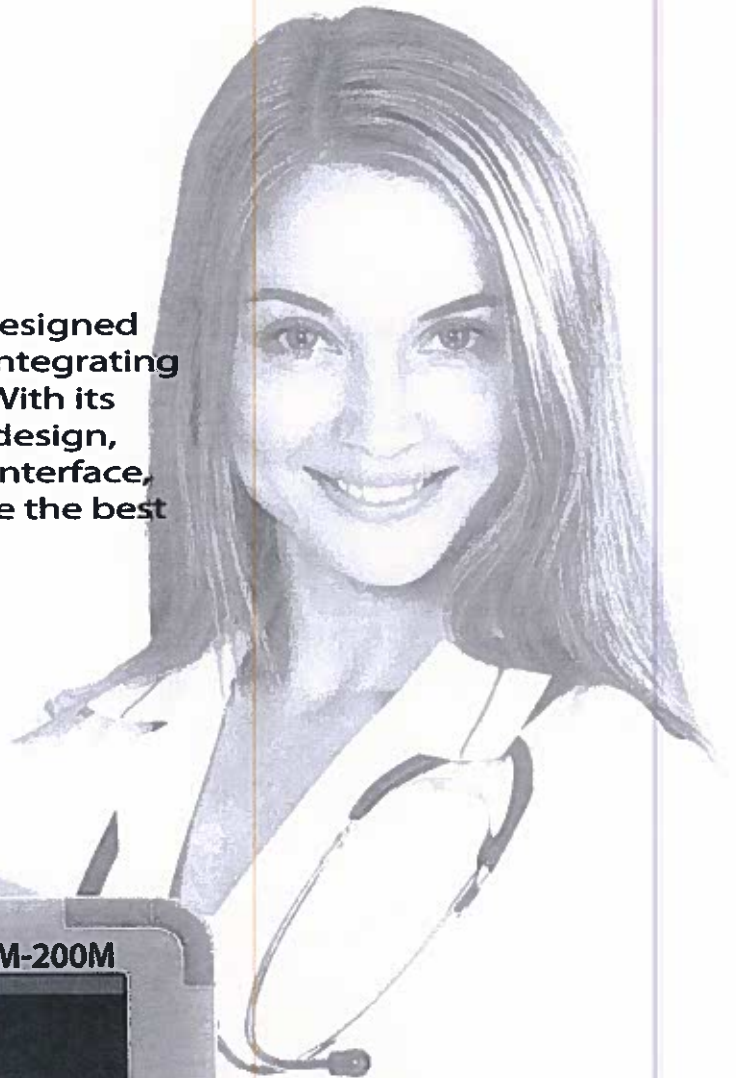

Handwritten signature

PM-200M

Patient Modular Monitor



12 lead ECG

Capture and review diagnostic 12-lead ECG waveform at one screen.



Short trend

Maximum 168 hour graphic and tabular trends




Other bed

Display other bedside monitor's all parameter and one waveform, support user defined parameter display



Oxy-CRG Screen

Oxy-cardiorespirography combines the compressed trends of heart rate, respiration, and oxygenation levels in an easy to interpret display. Oxy-CRG is an indicator of breathing efficiency and brain maturity

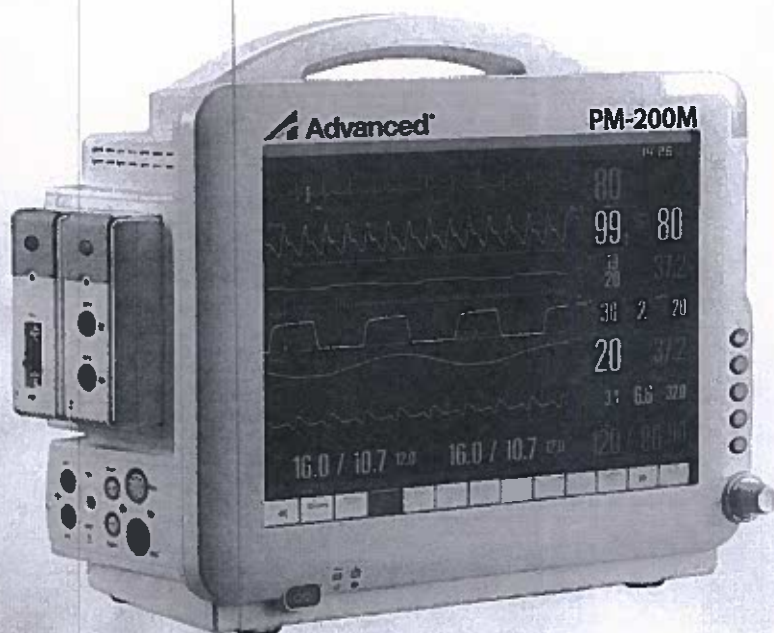

Technical Specifications

Size	318mm × 264mm × 152mm
Weight	4.5Kg
Power	
Standard According to IEC 60601-1 and IEC 60601-1-2	
Input voltage	100V-240V AC
Frequency	50Hz/60Hz
Earth leakage current	<0.3 mA
Input current	1.7A -0.8A
Fuse	T 2A/250V
Display	
Type	Color TFT LCD
Size(diagonal)	12.1 inch
Resolution	800×600 pixels
External display	
Type	Medical-Grade TFT display
Size	>15inch
Resolution	800×600 pixels
Recorder	
Type	Thermal dot array
Horizontal resolution	16 dots/mm(at 25 mm/s paper speed)
Vertical resolution	8 dots/mm
Recording speed	12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Recording waveform	Maximum 3 tracks
Recording way	Real-time / periodic / alarm recording
Battery	
Type	Rechargeable lithium ion battery 11.1V/4Ah
Operating time	> 210minutes
(1 new and fully charged battery at 25°C temperature, connecting SpO2 sensor & NIBP work on AUTO mode for 15 minutes interval)	
Charge time	6h to 100%(Standby)
Data Storage	
Alarm event	128 groups and associated waveform
Trend	168h, minimum resolution is 1min
ARR event	2h, minimum resolution is 5s
NIBP	128 groups and associated waveform
	1000 groups
Interfacing & I/O devices	
Keyboard & Mouse	Support
Barcode Scanner	Support 1D barcode (USB connector)
Touch screen	Option
Wired network	1 standard RJ45 interfaces
Wireless network	2.4G / 5G dual band (Option)
USB socket	2 sockets
Video output	1 VGA (option)
Nurse call	1 RJ11 connector
Analog signal output	Option
Defibrillation synchronization	1 BNC connector

[Handwritten signature]

[Handwritten text: 2014.11.10]

[Handwritten text: hce]

Technical Specifications

Environmental requirements

Operating temperature	5°C to +40°C
Operating humidity	15% to 85%(non condensing)
Operating air pressure	700hPa to 1060hPa
Storage temperature	-20°C to +55°C
Storage humidity	< 93%(non condensing)
Storage air pressure	500hPa to 1060hPa

ECG Lead

3 lead: I, II, III
5 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx
12 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6

Lead standard

AHA, IEC

Gain

x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4, Auto.

CMRR

Diagnostic mode ≥ 89 dB

Monitor mode ≥ 105 dB

Surgery mode ≥ 105 dB

Bandwidth (-3dB)

Diagnostic mode: 0.05 Hz to 150 Hz

Monitor mode: 0.5 Hz to 40 Hz

Surgery mode: 1 Hz to 25Hz

Input impedance

≥ 5.0 M Ω

ECG signal range

± 10.0 mV

Electrode offset potential

± 500 mV

Patient leakage current

< 10 μ A

System noise

≤ 30 μ Vpp (RTI)

Standardizing signal

1 mV $\pm 5\%$

Baseline recovery

Monitor mode: ≤ 3 s; Surgery mode: ≤ 1 s

Recovery time after defibrillation: waveform recover to baseline in 10s.

Sweep speed

6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

ST segment

Measurement Channels Calculating I, II, V- lead etc. at the same time

Default

II lead

Measurement range

-2.0 mV to +2.0 mV

Accuracy

-0.8 mV to +0.8 mV: ± 0.02 mV or $\pm 10\%$,

(whichever is greater)

Over ± 0.8 mV: unspecified

Resolution

0.01 mV

Heart Rate

Measurement range

Adult 10 bpm to 300 bpm

Pediatric & Neonatal 10 bpm to 350 bpm

Accuracy

$\pm 1\%$ or ± 1 bpm, whichever is greater

Arrhythmia analysis

Kinds

ASYSTOLE, VENT FIB/TACH, PAC, RUN PVCs, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R on T, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, MULTIPACs, PNP, PNC, NOISE, VPB, ST HIGH, ST LOW, VTACH, PVCs HIGH.

Respiration

Lead

Selected from: I (RA-LA) or II (RA-LL)

Measurement range

0 rpm to 150 rpm

Sweep speed

6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s

Accuracy

± 2 rpm or $\pm 2\%$, whichever is the greater

Delay of apnea alarm

10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60s

Handwritten signature and notes on the right margin.

Technical Specifications

NIBP

Standard	IEC 80601-2-30
Measurement way	Automatic oscillometry
Measurement mode	Manual , Auto, STAT

Intervals for Auto measurement: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90min, 2/4/8/12h.

STAT mode cycle time Keep 5 minutes, at 5 seconds interval.

Systolic range	Adult	30 to 270 mmHg
	Pediatric	30 to 235 mmHg
	Neonatal	30 to 135 mmHg
Diastolic range	Adult	10 to 220 mmHg
	Pediatric	10 to 220 mmHg
	Neonatal	10 to 110 mmHg
Mean range	Adult	20 to 235 mmHg
	Pediatric	20 to 235 mmHg
	Neonatal	20 to 125 mmHg
Cuff pressure range	0 to 280 mmHg	
Pressure accuracy	Static: ± 3 mmHg	
	Clinic: Average error ± 5 mmHg,	
	standard deviation: ≤ 8 mmHg	
PR range	40 bpm to 240 bpm	
Measurement time:	20s to 45s (depend on HR & moving interference)	
Software overpressure protection	Adult	(297 $\pm$ 3) mmHg
	Pediatric	(252 $\pm$ 3) mmHg
	Neonatal	(147 $\pm$ 3) mmHg

Digital SpO2

Measurement range	0% ~ 100%
Resolution Accuracy	1%
	70% ~ 100% $\pm 2\%$
	$\sim 69\%$ unspecified

Perfusion index

Measurement range	0.05% o 20%
PR	
Measurement range	20 bpm to 250 bpm
Resolution	1 bpm
Accuracy	$\pm 1\%$ or ± 1 bpm, whichever is the greater


IBP (option)

Standard	EN 60601-2-34 / IEC 60601-2-34
Sensitivity of transducer	5uV/V/ mmHg, $\pm 2\%$
Impedance of transducer	300 Ω to 3000 Ω
Static measurement range	-50 mmHg to +300 mmHg
Static measurement accuracy	± 1 mmHg or $\pm 2\%$ of the reading,
whichever is the greater (exclusive of transducer) ± 4 mmHg or $\pm 4\%$ of the reading, whichever	
is the greater (inclusion of transducer)	
Dynamic measurement range	-50 mmHg to +350mmHg
Dynamic measurement accuracy	± 4 mmHg or $\pm 4\%$ of the reading whichever is the greater
Resolution	1 mmHg
Unit	mmHg, kPa, cmH2O
Frequency Response	0 Hz to 20 Hz
Kinds of Measurement	ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1/P2

Handwritten signature and initials

Technical Specifications

Temperature Standard	ISO80601-2-56
Measurement way	Thermal resistance way
Measurement range	0.0°C to 50.0°C (32°F to 122°F)
Accuracy	0.0°C-50.0°C: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (not including the probe) 25.0°C-45.0°C: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (including the probe) 0.1°C or 1°F
Resolution	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (including the probe) 0.1°C or 1°F
Unit	°C or °F
C.O (Option)	
Measurement Mode	Thermal dilution method
Measurement Wave	Thermal dilution curve
Parameters	C.O., TB, TI,
Measurement Range	C.O. : 0.1 L/min ~ 20 L/min TB: 23.0 ~ 43.0°C TI: -1.0 ~ 27.0°C
Resolution	C.O.: 0.1 L/min TB: 0.1°C TI: 0.1°C
Accuracy	C.O.: 2% SD TB, TI: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

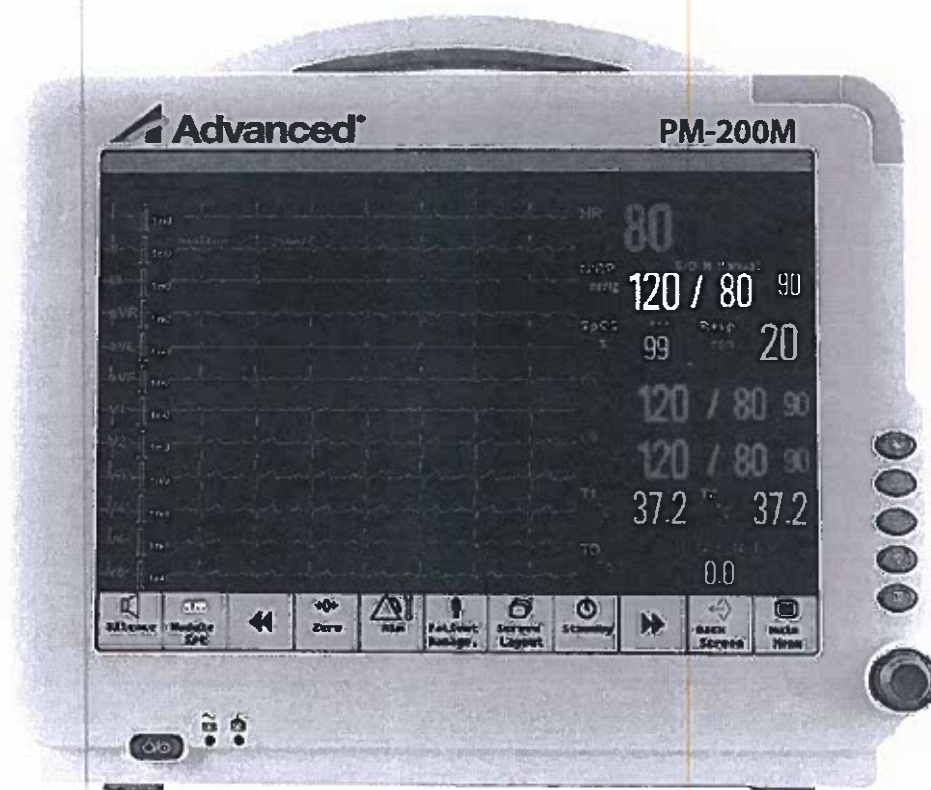

Handwritten signature and date:
 26/3/2021

2018 Advanced Instrumentations Inc. is a USA registered company -- All rights reserved.

All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation. Advanced Instrumentations reserves the right to make changes to this document and the product described herein, at any time, without obligation on Advanced Instrumentations to provide notification of such change. Actual description and specification of the product in this document may be different. Images shown here are for representational purpose only, actual may vary.


Advanced and Advanced Instrumentations trademarks and logos shown are property of Advanced Instrumentations Inc.

Success Through Quality/Since 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Success Through Quality,
a Company You Can Trust

Advanced Instrumentations manufactures leading medical technology equipment in the areas of anesthesia, cardiology, operating room, gynecology and obstetrics, IV therapy, patient monitors, hospital furniture, neonatology and ultrasound. We deliver to the healthcare industry the highest-quality standards, reliability, and patient safety in all our products through effective, and rigorous testing procedures by our own department of Biomedical Engineering in the United States. All of our equipment comes with 2 years warranty and excellent post-sale support services.


Advanced Instrumentations Inc. complies with the requirements of the ISO standards 13585-2016 following the audit by one of the most prestigious global certification companies, as it is the SGS. We comply with the requirements and are audited by the US Food and Drug Administration (FDA) an entity of the Health and Human Services of the United States of America. These certifications are the result of dedication and commitment to excellence in our products and services.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.

Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

For additional information visit us at:
www.advanced-inst.com

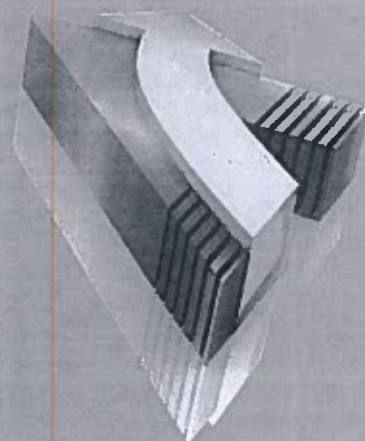

Handwritten signature



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortitelas y Keymart)
Edificio Dicosal #4002, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1970 al 73 Fax. 2221-1968, Pedidos. 2221-1967 al 74
email: info@dicosal.net www.dicosal.net

COTIZACION 018/2020

Cliente: Hospital San Lorenzo
Atención: Equipos varios
Referencia: esicra@hospitalсанlorenzo.com
e-mail: esicra@hospitalсанlorenzo.com

Fecha: 03 de Junio 2020

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	Nombre	DESCRIPCION	MARCA	CAT.	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIOS		
								UNITARIO	ISV	TOTAL
1	2	Unidad	Monitor de Signos Vitales	Monitor de Signos vitales, Sp2, ECG, temperatura, NIBP y accesorio, con camito	Edan	IM20	Inmediata a excepcion del carro en 20 dias	L. 40,000.00	si	HNL 80,000.00
2	2	Unidad	Monitor de Signos Vitales	Monitor de Signos vitales de transporte, Sp02, , temperatura, NIBP y accesorio, con carro	Edan	M3	Inmediata	L. 44,000.00	si	HNL 88,000.00
4	1	Unidad	Electrocardiografo de 3 canales	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES SE-301	Edan	SE-301	Inmediata	L. 22,900.00	si	HNL 22,900.00
								SUB TOTAL		HNL 190,900.00
								15% I.S.V.		HNL 28,635.00
										HNL 219,535.00

OBSERVACIONES:

Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos.
Para cualquier consulta no dude en contactarnos.
Estamos para Servirle!!!

Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: contra entrega
Validez de Cotización: 5 dias
Lugar de entrega: A definir por cliente



Cotizado por: Leyla Pavon
99783539
lpavon@dicosal.net

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!

EDANUSA
www.edanusa.com

SE-301

3-Channel ECG



SE-301
3-Channel ECG

About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Ultrasound imaging
- In-Vitro Diagnostics
- Patient Monitoring
- Point-of-Care Testing
- Veterinary
- OB/GYN

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



EDANUSA

4204 Jutland Drive,
Suite B, San Diego, CA 92117
Toll Free Phone Number:
888.850.4597

Care for Health

SE-301

3-Channel ECG

SE-301 is the new generation 3-channel ECG, which incorporates the benefits of the advanced technology and innovative design in an extremely compact and lightweight device. It is specifically developed for those who pursue superb portability without compromising on the quality for mobile environments. A variety of fantastic features are embodied in this amazing small unit, making it more than a basic 3 channel ECG.




Less than 1 kg



Full-touch Operation



One-button Operation

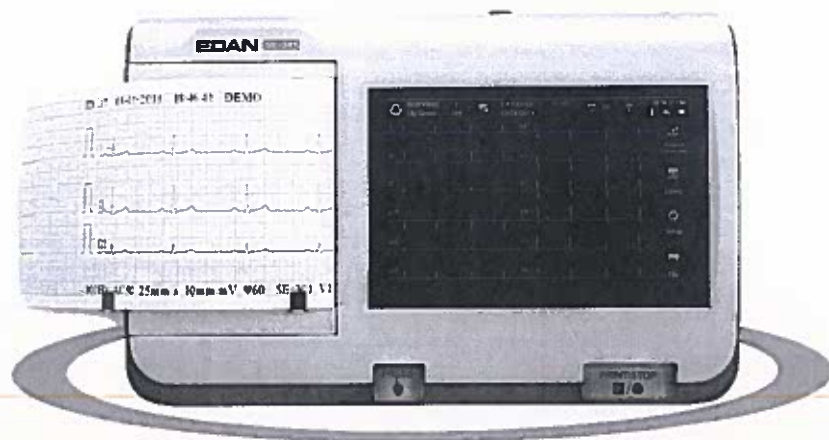

> Convenient Information Communication

Powerful External Device Support

The SE-301 is armed with two usb ports and one microSD card slot, which extends its capability by supporting various external devices such as a barcode scanner, external printer, USB memory drive or a microSD card.

Bi-directional Communication with Data Management System

Via the LAN or optional built-in Wi-Fi, SE-301 is able to receive orders from SE-1515 Data Management System and transmit ECG reports back to have further analysis, editing, saving or printing.

Multi-format Report (Optional)

The SE-301 is able to export ECG reports in standard PDF format and optional SCP, XML and DICOM format, which offers you greater capability in integrating the ECGs into different data management systems.



All for a reliable result

CMRR

A high Common Mode Rejection Ratio up to 140 dB restrains signal noises to the greatest extent, giving you excellent quality traces.

Bandwidth

A wide bandwidth from 0.01 to 300 Hz guarantees the accuracy of the ECG signal as well as the interpretation especially for pediatric patients.

Sampling Rate

The leading sampling rate as high as 16,000 Hz aims at capturing all the details to generate precise result.

Signal Quality Detection

By showing different colors to indicate normal, poor or missing signals, this function helps you to identify the signal quality even at a glance.

Reliable SEMIP® ECG Algorithm

SEMIP® ECG algorithm offers you an accurate and reliable reference to maximize clinician's confidence in making diagnosis.

Handwritten signature

SE-2003/SE-2012

Holter System



SE-2003/SE-2012

Holter System

About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Ultrasound imaging
- In-Vitro Diagnostics
- Patient Monitoring
- Point-of-Care Testing
- Veterinary
- OB/GYN

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



SE-2003/SE-2012

Holter System

EDAN Holter System offers you a lightweight and compact digital recorder, as well as fast and powerful analysis software. Optimized workflow and adjustable parameters aim to meet your different clinical needs.




The Holter Recorder reaches protection grade up to IP27, intending to prevent unexpected damages from water or dust, which maximizes patients' freedom in their daily life, even in their shower time. At the same time, it facilitates the cleaning and sterilization procedure.

Holter Recorder

- 3/12-channel digital recording
- Auto 3/12-channel identification (only SE-2012)
- OLED Screen with real-time waveform display
- Lightweight & Compact design: only 50 g
- Up to 8 days recording with one battery
- IP27 level of Waterproof & Dustproof
- Pacemaker detection
- Adjustable sampling rates



A common Holter analysis workflow always begins with the QRS Templates Analysis and ends up with the reporting. The most general functions are placed at the top toolbar to facilitate your workflow.

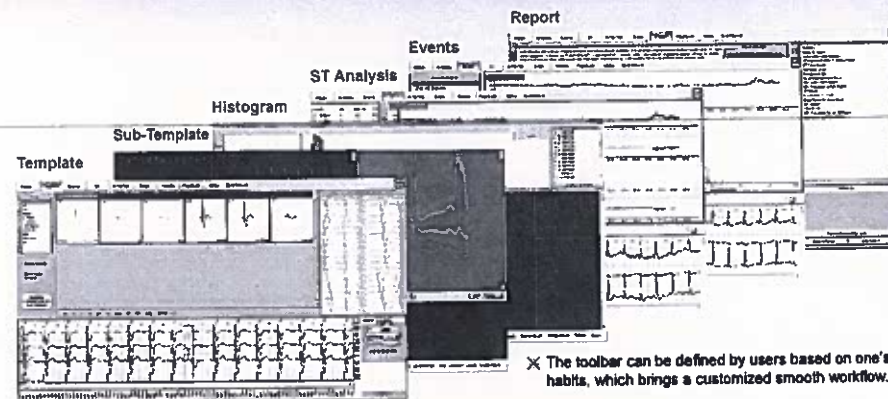

Holter Software

Data Processing

- Fast-loading: the loading time is less than 20 seconds
- Full disclosure of 24/48/96 hours and 8 days ECG data
- Download data via micro SD card or USB cable

Smooth Workflow

- User-define workflow
- Varied template categorizing with color codes
- Sub-template morphology classification
- Bulk modification and fast editing
- Comprehensive histogram
- ST segment analysis
- User-defined report contents and formats

Advanced Analysis

- Atrial Fibrillation/Flutter (A FIB/FLUT) analysis
- Heart Rate Variability (HRV) analysis
- Heart Rate Turbulence (HRT) analysis
- Obstructive Sleep Apnea (OSA) analysis


EMR Compatibility

- GDT/XML protocol support


Advanced Functions




Atrial Fibrillation/Flutter (A FIB/FLUT) analysis

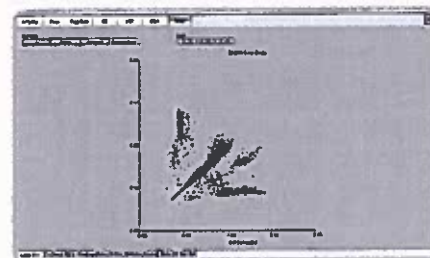

Heart Rate Variability (HRV) analysis

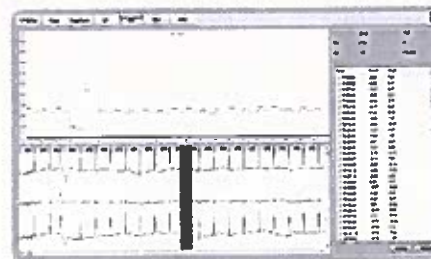

Heart Rate Turbulence (HRT) analysis

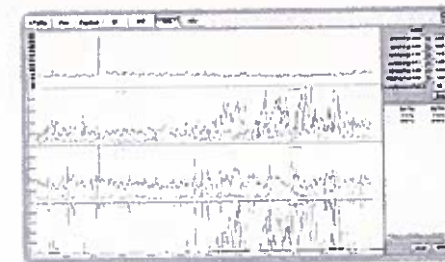

Obstructive Sleep Apnea (OSA) analysis

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

SE-1201 Electrocardiograph



SE-1201
Electrocardiograph



About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Patient Monitoring
- OB/GYN
- Ultrasound Imaging
- Point-of-Care Testing
- In-Vitro Diagnostics
- Veterinary

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



A world of potential

Global Headquarters:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com | info@edan.com.cn
U.S. and Canada Inquiries:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9918 Via Pajar, San Diego, CA 92126
+1.858.750.3066 | www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com



© Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Edan and its logo are trademarks of Edan Instruments, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries. Contact Edan for local availability.



SE-1201



12-Channel Electrocardiograph



Touch Screen



Portable Design



Seamless Connectivity



Hospital EMR/HIS/PACS

DICOM HL7



GDT-based

GDT



SE-1515 Data Management System



User-friendly Design

- 7" high resolution color touch screen
- Alphanumeric keyboard

Streamlined Workflow

- One-touch operation
- Support barcode scanner to simplify workflow

Accurate Clinical Performances

- Weak signal detection with the advanced 24-bit A/D converter technology
- Anti-noise technology with comprehensive filters and high CMRR over 140dB
- 120s real-time ECG waveform freezing and review to assist diagnosis
- The 0.01-300Hz bandwidth for pediatric patients according to AHA's recommendation
- The 16,000Hz sampling frequency maximizes the confidence in detecting pacemaker signal
- Built-in Glasgow ECG Interpretation

Flexible Printing Solutions


- Built-in high resolution thermal recorder
- Support external USB printer

Data Management

- Internal storage up to 800 ECGs and can be enlarged by USB flash disk and SD card
- Optional SE-1515 Data Management System to construct your ideal network solution
- Data transmission to PC via series port/LAN/built-in Wi-Fi
- Report formats: PDF and optional SCP/FDA/XML/DICOM data export



Rolling Stand

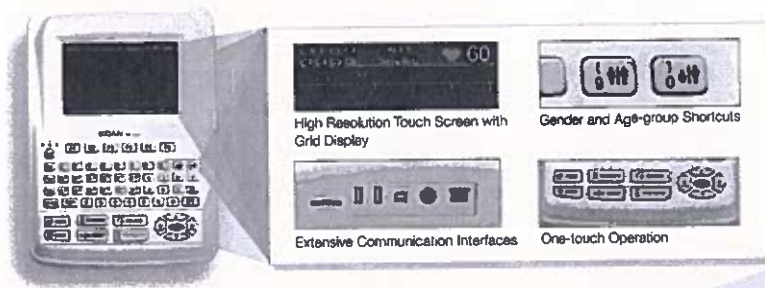

Network your ECG data with the help of EDAN SE-1515 Data Management System

- Bi-directional communication with ECG machines on workload and reports
- Cardiac consultation upon ECG reports over database sharing
- Multiple report formats output including PDF, XML, SCP, DICOM, JPG, BMP, and DOC
- Data access with HIS/EMR/PACS/CIS based on HL7/DICOM/GDT protocol

Handwritten signature and date: 2017

EDANUSA

www.edanusa.com

M3 Vital Signs Monitor



Outpatient



Transport



Ward



Portable
Design



Infrared Ear
Thermometer



Care for Health

M3

Vital Signs Monitor

Proven to be a durable and efficient solution for outpatients and general wards, the M3 brings effective vital signs monitoring to most ambulatory and regular healthcares.

- 5.6" high resolution color TFT-LCD screen
- Lightweight & portable design
- User-friendly interface
- Flexible configurations to meet different clinical needs
- Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
- Real-time measurements & trend display
- Built-in rechargeable Lithium-ion battery for 8 hours of continuous work
- USB flash disk support

30,000

NIBP Measurement Review

72 h


Trend Review

800


Alarm Review

- Barcode scanner support
- Bi-directional communication with MFM-CMS central monitoring system
- Compatible with PatientCare Viewer PC data management software
- Wired LAN/Wi-Fi support, HL7 support via XML files or MFM-CMS
- Nurse call
- Suitable for adult, pediatric and neonatal patients

Seamless Connectivity

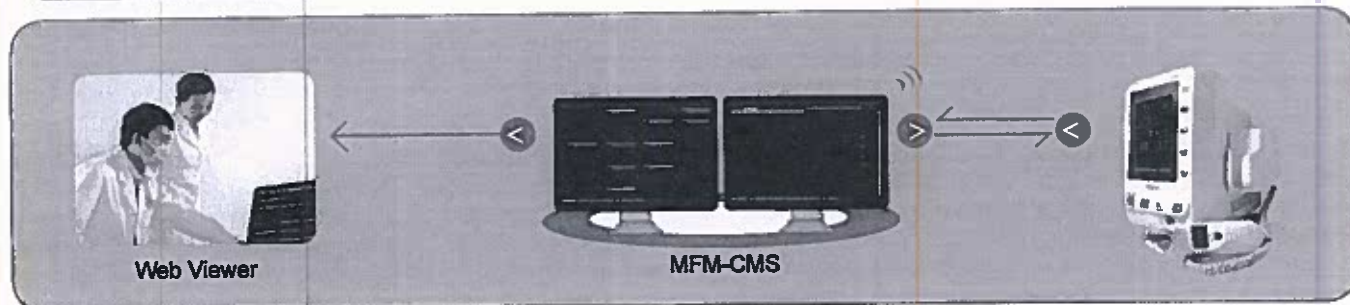

Mounting Solutions

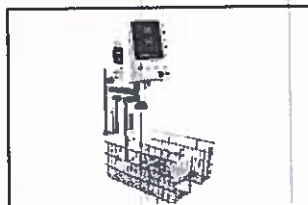

Wall Mount



Rolling Stand



Bed Rail Clamp

Specification

Configuration	SpO ₂	NIBP	Quick Temp	Infrared Ear Thermometer
M3 (SpO ₂ only)	✓	—	—	—
M3 (NIBP only)	—	✓	—	—
M3 (NIBP+Quick Temp)	—	✓	✓	—
M3 (NIBP+Infrared Ear Thermometer)	—	✓	—	✓
M3 (SpO ₂ +NIBP+Quick Temp)	✓	✓	✓	—
M3 (SpO ₂ +NIBP+Infrared Ear Thermometer)	✓	✓	—	✓

EDANUSA

4204 Jutland Drive,
Suite B, San Diego, CA 92117
Toll Free Phone Number:
888.850.4597

EDANUSA
www.edanusa.com



iM20
Patient Monitor

About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Ultrasound imaging
- In-Vitro Diagnostics
- Patient Monitoring
- Point-of-Care Testing
- Veterinary
- OB/GYN

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.

iM20

Patient Monitor



iM20 Transport Patient Monitor

Serves as both a transport monitor and a multi-parameter module for elite Series, iM20 provides a comprehensive and seamless monitoring solution both inside and outside hospital, connecting ambulatory cares to intensive cares.

Weighing less than 1.5kg with battery installed, iM20 is one of lightest transport monitor you can find on the market. Engineered strictly as to IP44 waterproof and dust proof standard, as well as a solid shock resistance performance, iM20 is suitable for patient transport in the harshest environments.

With its excellent power saving performance, iM20 requires no fan for heat expiration while the battery life is also extended for long term transport even without external power supply. In the meantime, the large non-fading built-in memory helps store the monitoring data during the whole transport session.

Though small and compact, iM20 does not only support basic parameters but also 2-channel IBP, expanding its usage for various medical cases.

The modern full-touch operation without physical buttons is unique on this kind of transport monitors, bringing user experience to a brand new level.

Unlike other conventional transport monitors on the market, iM20 comes with a built-on handle which does not need to be removed even when plugging into elite Series. On plug-and-play, iM20 switches role easily between a module and a monitor, connecting data together among different applications.

EDANUSA

4204 Julland Drive,
Suite 8, San Diego, CA 92117
Toll Free Phone Number:
888.850.4597

Care for Health

iM20


Patient Monitor



Serving as both multi-parameter module of elite V series monitors and transport monitor, iM20 provides a comprehensive and seamless monitoring solution both inside and outside hospital, connecting ambulatory cares to intensive cares.

Parameter Configurations

- iSEAP™ ECG algorithm optimized for arrhythmia detection, pacemaker detection, and HR measurement
- SEMIP® 12-lead diagnosis algorithm with 208 kinds of ECG findings in optional 12-lead ECG configuration
- iMAT™ SpO₂ algorithm with outstanding motion resistance and low perfusion resistance performance
- Signal Intensity (SI) measurement as blood perfusion indicator
- Optional Nellcor SpO₂ with SatSeconds™ technology
- iCUFFS™ NIBP algorithm optimized for cardiac patients, hypertensive patients, and neonatal patients
- Optional 2-channel invasive blood pressure with waveform overlapping function
- 2-channel temperature monitoring

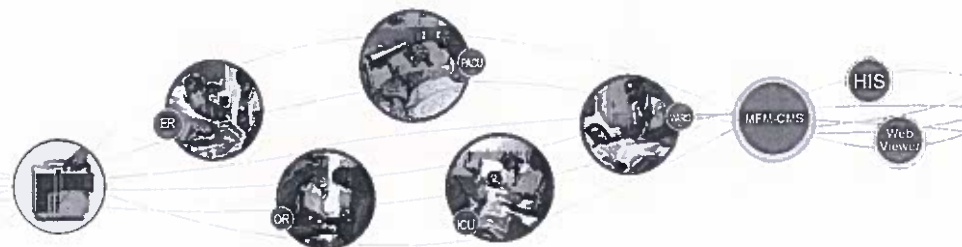

Built-in Temporary Memory



Ambulatory Designs



Designed as a robust transport monitor, iM20 is a solid companion in the harshest conditions.

- With IP44 water and dust protection, iM20 is outstanding for field medical practice, from regular emergency cares in rainy weather, to disaster controls with dusty environments.
- Designed with 1.2 meter shock resistance, unintentional falls and impacts shall not interrupt the monitoring, nor does the bumpy ride on rough road or hilly areas.
- With the ability to resist extreme temperature and altitudes, iM20 can be used in cold mountain areas as well as hot tropical places.



SE-1201 Electrocardiograph



SE-1201
Electrocardiograph



About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Ultrasound Imaging
- *In-Vitro* Diagnostics
- Patient Monitoring
- Point-of-Care Testing
- Veterinary
- OB/GYN

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



A world of potential

Global Headquarters:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com | info@edan.com.cn
U.S. and Canada Inquiries:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9918 Via Pajar, San Diego, CA 92126
+1.858.750.3065 | www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com

CE 0123

© Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries. Contact Edan for local availability.

EDAN
A world of potential

SE-1201



12-Channel Electrocardiograph



Touch Screen



Portable Design



Seamless Connectivity



Hospital EMR/HIS/PACS

DICOM HL7



CD-ROM GDT-based

GDT



SE-1515 Data Management System



User-friendly Design

- 7" high resolution color touch screen
- Alphanumeric keyboard

Streamlined Workflow

- One-touch operation
- Support barcode scanner to simplify workflow

Accurate Clinical Performances

- Weak signal detection with the advanced 24-bit A/D converter technology
- Anti-noise technology with comprehensive filters and high CMBR over 140dB
- 120s real-time ECG waveform freezing and review to assist diagnosis
- The 0.01-300Hz bandwidth for pediatric patients according to AHA's recommendation
- The 16,000Hz sampling frequency maximizes the confidence in detecting pacemaker signal
- Built-in Glasgow ECG Interpretation

Flexible Printing Solutions


- Built-in high resolution thermal recorder
- Support external USB printer

Data Management

- Internal storage up to 800 ECGs and can be enlarged by USB flash disk and SD card
- Optional SE-1515 Data Management System to construct your ideal network solution
- Data transmission to PC via series port/LAN/built-in Wi-Fi
- Report formats: PDF and optional SCP/FDA-XML/DICOM data export



Rolling Stand

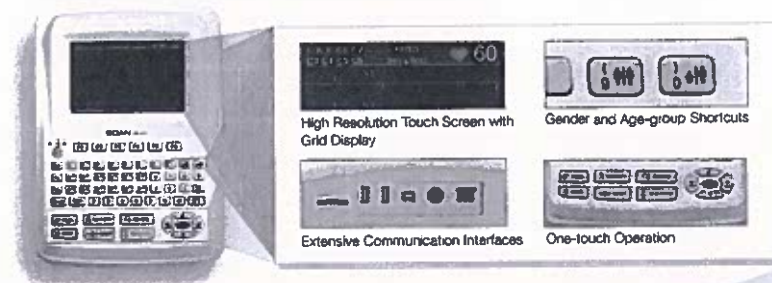

Network your ECG data with the help of EDAN SE-1515 Data Management System

- Bi-directional communication with ECG machines on worklist and reports
- Cardiac consultation upon ECG reports over database sharing
- Multiple report formats output including PDF, XML, SCP, DICOM, JPG, BMP, and DOC
- Data access with HIS/EMR/PACS/CIS based on HL7/DICOM/GDT protocol



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:32

Para: Leyla Pavon <lpavon@dicosa.net>, Yessica Mendez <ymendez@dicosa.net>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "DISTRIBUIDORA COMERCIAL"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:57

Para: "INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L." <INVEQUIPOS2014@hotmail.com>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "INVERSIONES Y EQUIPO"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo.**

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 12:09

Para: Cinthia Velasquez <c.velasquez@nostrapharma.org>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "NOSTRAPHARMA"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo.**

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN LORENZO
¡El paciente, nuestra razón de ser!



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 11:49

Para: baulilio@simedic.hn

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "SIMEDIC"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:41

Para: "AMESYS, S.A." <amesys17@yahoo.com>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "AMESY"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:34

Para: jaguilar@dimexmedica.com

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "DIMEX MÉDICA"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO

Colonia Morazán San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781- 11-58

Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios

Departamento/Unidad/Servicio/Sala/ Solicitante:	Fecha de Elaborada la solicitud
SALA DE COVID-19	02-jun-20
Dirigida A:	Fecha de Recibida
DIRECCIÓN EJECUTIVA	

No.	Descripción del Bien/Servicio (Especificaciones Técnicas)	Presentación (Tipo de Unidad)	Cantidad Solicitada
1	Electrocardiografo Cardiovascular (Mímimo 3 Canales) (Incluir 10 unidades de Papel para Electrocardiografo)	Unidad	1 ✓
2	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Unidad	4 ✓
	*****U.L.*****		

Justificación: Se esta solicitando de manera urgente los Equipos antes mencionados para la Sala de Covid del Hospital San Lorenzo, equipo que será utilizado para la debida y pronta atención de los pacientes que son atendidos en este centro hospitalario por haber adquirido el Virus Covid-19, cabe mencionar que el equipo solicitado es indispensable para la evaluación diagnostica del paciente.

SOLICITANTE

Nombre y Apellido:

Carlos Arturo Ramos

Firma y Sello del Solicitante:

Línea Presupuestaria Aprobada por Gestion Financiera

Nombre y Apellido: Lic. Miriam Reyes

Fecha , Firma y Sello:

Observacion:


Vo.Bo. Dirección Ejecutiva

Nombre y Apellido: Lic. Rosa Maria Carcamo

Fecha , Firma y Sello:

GRUPO DEL GASTO:

OBJETO DEL GASTO:

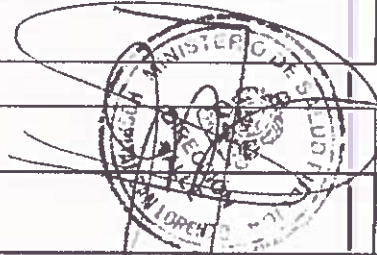



FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO
¡El paciente, nuestra razón de ser!



HOSPITAL SAN LORENZO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	OP-323-2020	AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD No.
		AD0001-66014
A FAVOR DE:	DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)	
VALOR	L.	193,200.00
EN LETRAS:	Ciento Noventa y Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	99	FUENTE	11	CUENTA	01424551	SUBCUENTA	7028695
----------	----	--------	----	--------	----------	-----------	---------

TIPO DE PAGO	CHEQUE	EMITIR					
	TRANSFERENCIA						

DESCRIPCION

DESCRIPCION	PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 183-2020, FACTURA No. 000-002-01-00009930.						
OBJETO DE GASTO	VALOR						
42400	L. 168,000.00						
ISV	L. 25,200.00						
TOTAL	L. 193,200.00						

VALOR EN LETRAS

FECHA: 15/6/2020

Ciento Noventa y Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos

Lic. William Reyes
Gestión Financiera

*El Comprador al momento de recibir los productos solicitados en la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las especificaciones así como con la calidad y entrega estipuladas en la Invitación a Cotizar, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos.

*El Proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por la Fundación, de no ser así se procederá conforme a la Ley.

*El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado la Fundación puede aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FUNDACION HOSPITAL SAN LORENZO, VALLE
Colonia Morazán San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781- 1434




ACTA DE RECEPCION

Por este medio, hacemos constar que hemos recepcionados de la Empresa : "DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOSA" los bienes y/o servicios que fueron adquiridos mediante Orden de Compra No. 183-2020 ,Según Factura No.000-002-01-00009930 y Comprobantes de Entrega No. 53775 y 53776 que se detallan a continuación:

Nº	DESCRIPCION	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD ENTREGADA UNIDAD
1	Monitor de Signos Vitales Sp 2ECG,Temperatura NIBP y Accesorios con carrito Marca: Edan Modelo IM20	Unidad	2 ✓
2	Monitor de Signos Vitales de Transporte SpO2 Temperatura,NIBP y Accesorios con carrito Marca Edan Modelo: M3	Unidad	2 ✓
3	UL.....		

Los bienes y/o servicios, antes descritos han sido previamente verificados, se encuentran físicamente en buen estado y han sido recibidos con satisfacción, por lo cual se firma la presente acta de recepción en, San Lorenzo Valle, a los 4 días del mes de Junio del año 2020

Recibí conforme: _____

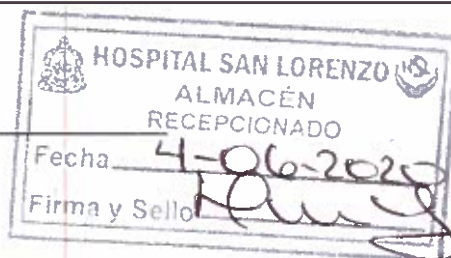

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

R.T.N. 08019002278310

606/20/28 (DICOSA)

1 de 1

FACTURA

CAI ED28E2-9687FB-50418D-564C28-9EB680-24

000-002-01- 00009930

TEGUCIGALPA FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N°. 4002, TEL.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1966,
SPS B° LOS ANDES STA CALLE 9 AVE, TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721,
CORREO: DICOSA11@DICOSA.NET

CLIENTE: 02986 "FUND. APOYO HOSPITAL SAN LORENZO" 03:5

R.N.M.D: 170896010203601

ORDEN DE COMPRA
EXENTA/CONSTANCIA
EXONERADO/REGISTRO SAG

RESPONSABLE: " " BOD:037 imp:

DIRECCION: SAN LORENZO VALLE TEL 27811434/23079344

ZONA No: 19

FECHA VENCE: 04/07/2020

CREDITO

FECHA: 04/06/2020

AGENTE No: 0-054 C-354

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1-8040	2	UNIDADES	MONITOR DE BIENESTAR VITALES IM20	40.000.0000	3	0.00	80.000.00
1-8045	2	UNIDADES	MONITOR A-PACIENTE NIVEL DE EMERGENCIA I	44.000.0000	3	1.00	88.000.00
**** ULTIMA LINEA ****							



HOSPITAL SAN LORENZO
ALMACEN
RECEPCIONADO
Fecha: 4-06-2020
Firma y Sello: [Firma]

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	1.00
IMPORTE GRAVADO 15%	136.000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO:	0.00
ISV 15%	20.200.00
ISV 18%	0.00
TOTAL:	156.200.00

TOTAL LITERAL

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CIENTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

00018880

FECHA DE RECEPCION: 04/06/2020

FANCO AUTORIZADO

FANCO DE DOCUMENTO FISCAL

FANCO DE DOCUMENTO FISCAL

00018880

00018880

REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN
VENTA DE PRODUCTOS
MÉDICOS - HOSPITALARIOS



RECIBIO ANGEL FUNEZ
1709-1977-00679

Apartado Postal No.3307 R.T.N.: 08019002278310

Tels. Teg.: 2221-1970 al 74 Fax: 2221-1968 Tels: S.P.S. 2550-7072 al 75 Fax: 2550-1721, E-mail:info@dicosa.net

COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 53775

Hemos recibido de DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. En buen estado, la cantidad de 1 Bultos
con peso de Libras, según detalle a continuación para ser entregados a el (los)
Señor (es): FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL de SAN LORENZO
Día: Carro de alquiler No. DE SAN LORENZO Motorista:

Cantidad	Unidad	Código	ARTICULO	Peso Libras
2	L		* MONITORES PARA PACIENTE M13 MARCA: EDAN SERIE: 36C124-M2C2C8100001 36C124-M2C2C8100002 CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS * CARRCOS DE TRANSPORTE o/c 183-2020	
2	L			



Fecha 04 de JUN del 20 20 Por: Factura No. 00009930 Carro No. Código UT 203

"Al Servicio de la Salud desde 1971"

REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN
VENTA DE PRODUCTOS
MÉDICOS - HOSPITALARIOS



RECIBIO ANGEL FUNEZ
1709-1977-00679


Apartado Postal No.3307 R.T.N.: 08019002278310

Tels. Teg.: 2221-1970 al 74 Fax: 2221-1968 Tels: S.P.S. 2550-7072 al 75 Fax: 2550-1721, E-mail:info@dicosa.net

COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 53776

Hemos recibido de DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. En buen estado, la cantidad de Bultos
con peso de Libras, según detalle a continuación para ser entregados a el (los)
Señor (es): FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL de SAN LORENZO
Día: Carro de alquiler No. DE SAN LORENZO Motorista:

Cantidad	Unidad	Código	ARTICULO	Peso Libras
2	L		* MONITORES DE SIGNOS VITALES M20 * MARCA EDAN SERIE: * 260374-M19B06580002 * 260374-M19B06580001 CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS o/c 183-2020	

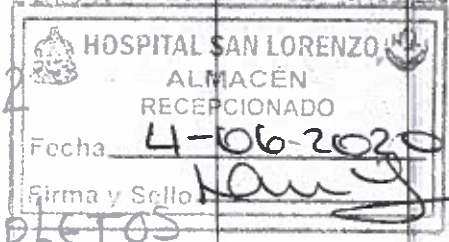

Fecha 04 de JUN del 20 20 Por: Factura No. 00009930 Carro No. Código UT 203

ORIGINAL: FACTURACIÓN / GOBIERNO
ROSADO: CLIENTE
VERDE: PEDIDO
AZUL: GOBIERNO
AMARILLO: ARCHIVO



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002278310

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Nombre Comercial: DICOSA S.A

Teléfono: 22211970

Email: dicosa11@dicosa.net

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SABANAGRANDE, CALLE: LOS PROCERES, CASA NO.: 4002, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SABANAGRANDE, LOS PROCERES, No. 4002, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00009930 ✓

Fecha de Autorización: 25/05/2020

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA ✓

Fecha de Vencimiento: 25/02/2021 ✓

CAI: ED26E2-968766-50418D-564C28-9EB680-24 ✓

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00008001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00010000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01996037

AGN SAN LORENZO SLO
Lugar y Fecha

17 JUNIO 2020

*DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOSA

****193,200.00

Páguese a la orden de

* Ciento noventa y tres mil doscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆01999289⑆1019999999999999⑆01996037



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. OC-183-2020

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

4 de junio de 2020 a las 15:57

Para: Leyla Pavon <lpavon@dicosa.net>, vanessa raudales <sraudales@dicosa.net>, Juan ramos

<dicosa5@dicosa.net>, Yessica Mendez <ymendez@dicosa.net>

CC: Juan Ramón Osorio <josorio@hospitalsanlorenzo.com>, Rosa María Cárcamo

<rcarcamo@hospitalsanlorenzo.com>, Mirian Reyes <mreyes@hospitalsanlorenzo.com>, Danamy Lopez

<dlopez@hospitalsanlorenzo.com>, Claudia Torres <ctorres@hospitalsanlorenzo.com>

ESTIMADOS SEÑORES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL "DICOSA" ✓

Por este medio Estoy Notificando la Orden de Compra que encontraran adjunta. Favor acusar recibo y uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto con ustedes para coordinar la entrega del producto.

Por favor tomar en cuenta la siguiente información al momento de elaborar la factura.

Nombre: Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo

RTN 17099010303801

Teléfono: 2781-1166

Dirección, Barrio Morazán

Así mismo entregar en almacén los siguientes documentos al momento de la entrega del producto:

Factura Original

Comprobante de entrega

Solvencia Fiscal

Constancia de Estar Sujetos Pagos A cuenta (SAR).

Si la entrega del producto es Parcial la Factura debe ser emitida por la cantidad entregada,

Nota: De no Adjuntar los documentos Solicitados no se podrá recibir el producto.

Favor acusar de recibido.

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN LORENZO
¡El paciente, nuestra razón de ser!

OC-183-2020 DICOSA.pdf
2428K



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Leyla Pavon <lpavon@dicosanet>

4 de junio de 2020 a las 15:39

Para: Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

CC: "sraudales@dicosanet" <sraudales@dicosanet>, Yessica Mendez <ymendez@dicosanet>, Juan Antonio Ramos <dicosanet5@dicosanet>, "Ing. koony Nehring" <knehring@dicosanet>

Emerson

El tiempo de Garantía es 1 año, garantía por desperfectos de fabricación.

El soporte que se ofrece es mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo de fabricante mientras este en garantía. Correctivo según llamado

Se incluye instalación y capacitación.

[Texto citado oculto]



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

4 de junio de 2020 a las 14:23

Para: Leyla Pavon <lpavon@dicosa.net>

CC: "sraudales@dicosa.net" <sraudales@dicosa.net>, Yessica Mendez <ymendez@dicosa.net>, Juan Antonio Ramos <dicosa5@dicosa.net>, "Ing. koony Nehring" <knehring@dicosa.net>

Estimado Licda. Pavón

En seguimiento a la Cotización de los equipos solicitados, favor indíquenos cuál es el tiempo de garantía que ofrecen para los equipos, y cual es el soporte o asistencia técnica que nos brindarán. (incluye capacitación e instalación de los equipos?)

Quedo atento a su pronta respuesta,

Atentamente,
[Texto citado oculto]



NO.	OC-182-2020
-----	-------------

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

[illegible]

SUB TOTAL	25,867.70
15% ISV	3,880.16
TOTAL	29,747.86

Aprobado

Pp Directed Elective

***El Comprador al momento de recibir los productos solicitados en la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las especificaciones así como con la calidad y entrega estipuladas en la Invitación a Cotizar, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos.

***El Proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por la Fundación, de no ser así se procederá conforme a la Ley.

***El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado la Fundación puede aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. OC-182-2020

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

4 de junio de 2020 a las 15:52

Para: Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>

CC: Juan Ramón Osorio <josorio@hospitalsanlorenzo.com>, Rosa María Cárcamo

<rcarcamo@hospitalsanlorenzo.com>, Mirian Reyes <mreyes@hospitalsanlorenzo.com>, Danamy Lopez

<dlopez@hospitalsanlorenzo.com>, Claudia Torres <ctorres@hospitalsanlorenzo.com>

ESTIMADOS SEÑORES: DIMEX MEDICA ✓

Por este medio Estoy Notificando la Orden de Compra que encontraran adjunta. Favor acusar recibo y uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto con ustedes para coordinar la entrega del producto.

Por favor tomar en cuenta la siguiente información al momento de elaborar la factura.

Nombre: Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo

RTN 17099010303801

Teléfono: 2781-1166

Dirección, Barrio Morazán

Así mismo entregar en almacén los siguientes documentos al momento de la entrega del producto:

Factura Original

Comprobante de entrega

Solvencia Fiscal

Constancia de Estar Sujetos Pagos A cuenta (SAR).

Si la entrega del producto es Parcial la Factura debe ser emitida por la cantidad entregada,

Nota: De no Adjuntar los documentos Solicitados no se podrá recibir el producto.

Favor acusar de recibido.

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN LORENZO
¡El paciente, nuestra razón de ser!

OC-182-2020 DIMEX MEDICA.pdf
2293K



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>

4 de junio de 2020 a las 14:30

Para: Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

Buenas tardes estimado,

Tiempo de garantía 1 año por desperfectos de fábrica, estamos en la disposición de brindar capacitación de usuario vía vídeo llamada o presencial si vienen a la oficina por el tema que estamos pasando con la emergencia nacional.

Se pueden reforzar conocimientos las veces que necesiten.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>
Para: Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>

4 de junio de 2020 a las 14:20

Estimado Ing. Aguilar

En seguimiento a la Cotización de los equipos solicitados, favor indíquenos cuál es el tiempo de garantía que ofrecen para los equipos, y cual es el soporte o asistencia técnica que nos brindarán.

Quedo atento a su pronta respuesta,

Atentamente,

El mié., 3 de jun. de 2020 a la(s) 17:06, Julio Aguilar (jaguilar@dimexmedica.com) escribió:

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION	
<i>Modalidad de Compra</i>	<i>Invitación a Cotizar Personalizada: Equipo Médico para el Hospital San Lorenzo</i>
<i>Objetivo de Compra:</i>	<i>Adquisición de Equipo Médico para el Hospital San Lorenzo</i>
<i>Fecha límite para presentación de ofertas:</i>	<i>3/06/2020</i>
<i>Lugar en que se realizó la evaluación:</i>	<i>Hospital San Lorenzo</i>
<i>Fecha de evaluación:</i>	<i>4/06/2020</i>

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Laura Castillo	Control Interno
Noel Matute	Administrador de Inventario
Danamy López	Jefe de Almacén

I. INTRODUCCION

Se procedió a enviar la solicitud de cotización a las empresas que se detallan a continuación:

- **AMESY**
- **SIMEDIC**
- **NOSTRAPHARMA**
- **INVERSIONES Y EQUIPO**
- **DISTRIBUIDORA COMERCIAL**
- **DIMEX MEDICA**

El procedimiento de evaluación acordado por los miembros de la Comisión Evaluadora fue el siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las Instrucciones Especiales pactadas en la cotización.
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones solicitadas,
- Evaluación económica.

II. EVALUACION

1. Apertura

A continuación, se detallan las empresas que presentaron oferta en respuesta a esta Solicitud a Cotizar: (Ver anexo)

- **INVERSIONES Y EQUIPO**
- **DISTRIBUIDORA COMERCIAL**
- **DIMEX MEDICA**

2. Verificación de cumplimiento de requisitos formales

- Las empresas que presentaron ofertas lo hicieron dentro del plazo fijado.

3. Evaluación Económica y Reporte de Adjudicación

Cuadro Resumen de las Ofertas (Ver anexo II)

La verificación aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos en las ofertas presentadas.

4. RECOMENDACION DE ADJUDICACION

La Adquisición de Equipo Médico para el Hospital San Lorenzo solicitados por Sub-

[Handwritten signature]

Dirección Asistencial del Hospital San Lorenzo se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización con el objeto de promover la competencia en precio, "Conforme a lo establecido en el artículo; 38 y 63 de la Ley de Contratación del Estado, artículo: 139, 152; del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 70 de las Disposiciones Generales Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2020" Se recomienda la adjudicación de la siguiente manera:

✓
Adjudicar a DIMEX MEDICA: La partida 1 por ser el segundo oferente en menor precio y por criterio técnico del Dr. Carlos Arturo Ramos dado que este aparato cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y su manejo es más funcional para el personal que lo utilizará en la Sala de COVID-19 ya que los comandos de este aparato son de manipulación manual y no digital.


✓
MONTO TOTAL NETO: VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (LPS.25,867.70)

✓
Adjudicar a DICOSA: Para la partida 2 por ser el oferente con el menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas (Oferta 2 unidades de Lps. 40,000.00 y 2 unidades de Lps.44,000.00)

✓
MONTO TOTAL NETO: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.168,000.00)


Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, a los 4 días del mes de Junio del 2020.


DANAMY LOPEZ
JEFE DE ALMACÉN

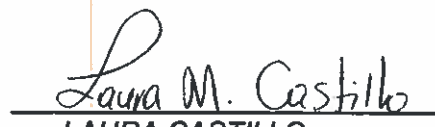
LAURA CASTILLO
CONTROL INTERNO


NOEL MATUTE
ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS

OPINIÓN TECNICA CALIFICADA:

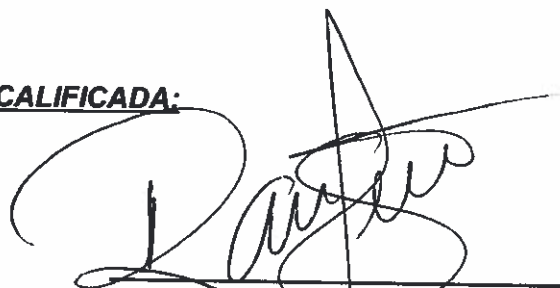

DR. CARLOS ARTURO RAMOS
MEDICO INTERNISTA DEL HOSPITAL SAN LORENZO

Anexos:

Anexo	I	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo	II	Cuadro Resumen de Ofertas
Anexo	III	Ofertas
Anexo	IV	Solicitudes de Invitaciones Cotizaciones
Anexo	V	Solicitud de Adquisicion





FUNDACION DE APOYO DEL HOSPITAL SAN LORENZO, VALLE



Colonia Morazán San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781- 1434

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Tipo de Proceso: Invitación a Cotizar Personalizada

Objetivo de la compra: Adquisición de Equipo Medico

I.-Lugar, fecha y hora de apertura de las Sobres que contienen las Ofertas:

Fecha de Invitación:	03/06/2020	Fecha y hora de apertura de ofertas:	4 de Junio del 2020 a las 11 :10 a.m.
No. de oferentes invitados:	6	No. de ofertas recibidas:	3
Fecha y hora de presentación de ofertas:	3 de Junio del 2020	Lugar: Departamento de Logística y Suministros	Hospital San Lorenzo

II.- Monto de las Ofertas de los Proveedores participantes que cumplieron con los requisitos:

No.	Oferente	Monto de la oferta Lps.
1	Dimex Medica S.A. de C.V.	Lps.154,647.52 ✓
2	Distribuidora Comercial S.A.	Lps.219,535.00 ✓
3	Inversiones y Equipos S. de R.L. de C.V.	Lps.299,690.00 ✓

III.- Nombre y firma de la Comisión de Adquisiciones para la evaluación de las ofertas:

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Laura Castillo	Control Interno		04/06/2020
Noel Matute	Administrador de Inventarios		04/06/2020
Danamy López	Jefe de Almacén		04/06/2020

RESUMEN DE INVITACIÓN A COTIZAR:

N°	Cantidad	Presentación	DESCRIPCIÓN	DICOSA		DIMEX		INVERSIONES Y EQUIPOS	
				PU	PT	PU	PT	PU	PT
1	1	Unidad	Electrocardiografo Cardiovascular (Minimo 3 Canales) (Incluir 10 unidades de papel para el Electrocardiografo)	22,900.00	22,900.00	25,867.70	25,867.70	27,000.00	27,000.00
2	2	Unidad	Monitor de signos vitales de transporte adulto	40,000.00	80,000.00	54,304.20	108,608.40	58,400.00	116,800.00
3	2	Unidad	Monitor de signos vitales de transporte adulto	44,000.00	88,000.00				
4									
			MONTO TOTAL ADJUDICADO		168,000.00		25,867.70		

Observaciones: La Comisión de Evaluación de las ofertas recomienda adjudicar el Electrocardiografo Cardiovascular a la Empresa DIMEX MEDICA por criterio técnico del Dr. Carlos Arturo Ramos dado que este aparato cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y su manejo es mas funcional para el personal que lo utilizará en la Sala de COVID-19 ya que los comandos de este aparato son de manipulación manual y no digital. Para la partida 2 DICOSA (Oferente de menor precio) Oferta 2 unidades de Lps. 40,000.00 y 2 unidades de Lps.44,000.00 la Comisión de Evaluación de las ofertas recomienda adjudicarlo a este proveedor por ofertar los productos que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

DANAMY LOPEZ
JEFE DE ALMACÉN

LAURA CASTILLO
CONTROL INTERNO

NEEL MATUTE
ADMINISTRADOR DE
INVENTARIOS

OPINIÓN TÉCNICA CALIFICADA:

DR. CARLOS ARTURO RAMOS

MEDICO INTERNISTA DEL HOSPITAL SAN LORENZO



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Julio Aguilar <jaguilar@dimexmedica.com>
Para: Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 16:22

Buenas tardes estimado Lic. Sierra,

Adjunto cotización solicitada con ficha técnica del producto.

De los monitores solo tenemos 2 unidades para entrega inmediata con parámetros y accesorios adulto, sin carro de transporte.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

 UMEC-12.pdf
392K

 EDAN_Brochure_ECG SE-1 y SE-3_ING.pdf
1269K

 169_2020_JA ELECTROCARDÍOGRAMO EDAN SE-3_+MONITOR DE SIGNOS
VITALES_HOSPITAL SAN LORENZO.pdf
129K



www.dimexmedica.com

COTIZACIÓN NO. 167_2020_JA
FECHA DE ELABORACIÓN: 2/6/2020

CONDICIONES DE OFERTA	
Casa:	EDAN(electrocardiógrafo) MINDRAY(monitores)
Entrega:	INMEDIATA
Validez:	2 DÍAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
Pago:	CONTADO/CRÉDITO ACEPTAMOS ORDEN DE COMPRA

DATOS	
Señores:	HOSPITAL SAN LORENZO
Titular:	DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.
RTN	0801-9001-262611
CAI	2480C0-41177B-BC4C9C-251684-46CCDB-F6
Fecha Límite:	17/12/2020
Rango:	000-002-01-00008101-00011700
Dirección del Proveedor:	BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO #3002, ATRÁS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA.
Teléfono:	(504) 2280-4444

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT	PREC. TOTAL
1	12-104-0001	ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES SMART ECG SE-3	1	L25,867.70	L25,867.70
2	12-122-0117	MONITOR DE PARAMETROS uMEC12 M2K3B-CTO-S01 CON ACCESORIOS PARA PACIENTE ADULTO, SPO2, NIBP, ECG Y TEMP. *****ÚLTIMA LÍNEA*****	2	L54,304.20	L108,608.40
				Sub-Total	L134,476.10
				I.S.V	L20,171.42
				Total	L154,647.52

Cotización preparada por:

Julio Aguilar

(504) 3177-2490


Sitio Web:

www.dimexmedica.com

jaguilar@dimexmedica.com

Observaciones:

Precios sujetos a cambios en base a cantidades requeridas.



TEG: 2280-4444 | 2280-4445 SPS: 2553-5000 | 2553-5002
Barrio San Felipe, Calle Bustamante y Rivero, No. 3002, atrás de iglesia Medalla Milagrosa, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Oficina Regional: Zona de la Cervecería, 3era avenida 16 calle NO, local de la esquina. Esquina opuesta a Por Salud.
www.dimexmedica.com

Handwritten signature

EDAN




SE-1/SE-3

Single/Three-channel ECG



SE-1/SE-3
Single/Three-channel ECG

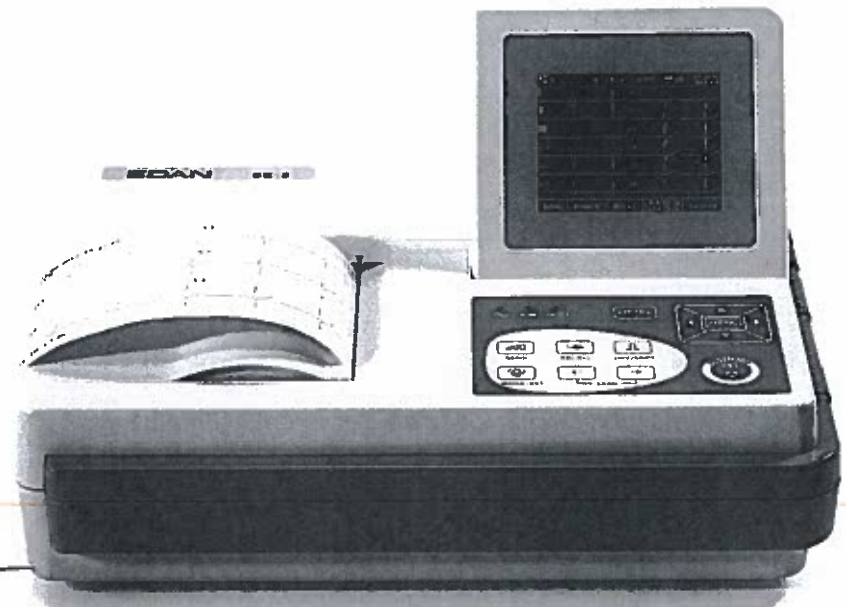

*Dr. Carlos H. Lopez
Jefe Departamento de Informatica
H-S-C*



EDAN Edan Instruments, Inc.

• 3F - B, Heshan Medical Equipment Park, Nanshi Rd 10186, Shantou, Heshan Shenzhen, 518067 P.R. China
• Tel: +86-755-26895338 • Fax: +86-755-26895339 • www.edan.com.cn • Email: info@edan.com.cn

• All rights reserved. Features and specifications are subject to change without notice



BND-B00-05-1025-0-12-0214020

Care for Health

Handwritten signature and date: 2007

EDAN

SE-3 series Three-channel ECG



Portable & User-friendly Design

- Foldable LCD screen, vivid waveform display
- Built-in rechargeable Li-ion battery, AC/DC power supply
- Communication Interface: Ethernet/RS232/USB

Streamlined Workflow

- Support barcode scanner to simplify patient information input
- One-button operation
- Auto/Manual/Rhythm/Off work modes
- Automatic baseline adjustment
- Lead-off detection and alarm

Accurate Clinical Performances

- 12 leads simultaneous acquisition with 24-bit A/D converter optional
- Automatic ECG measurements and interpretation tested with CSE/AHA/MIT database
- Complete digital filtering, resisting baseline drift, AC and EMG interference

Flexible Printing Solutions

- Built-in high-resolution thermal printer
- Grid printing on normal thermal paper
- 12-lead grid printing on normal A4 paper through external printer

Data Management

- Large data storage up to 500 records and can be enlarged by USB flash disk
- Multiple report formats including PDF, SCP, FDA-XML, DICOM (optional)
- PC-based ECG data management software (optional)



Foldable Screen



Portable Design
(Handle Optional)



One-button Operation

Sensitivity Adjustment


Mode Switch

Start/Stop




SE-3 (Monochrome)

PC-based ECG Data Management Software

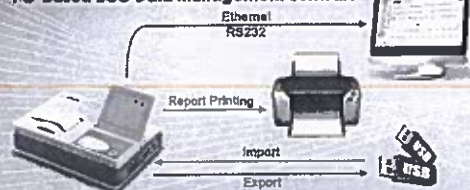

Smart ECG Viewer

Intuitive interface to improve your work efficiency

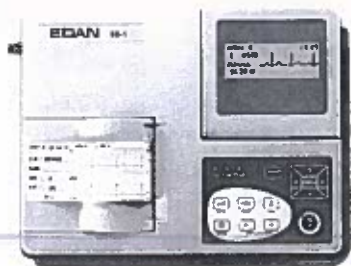

SE-1 Single-channel ECG

- Vivid waveform with foldable LCD display
- Built-in high resolution thermal printer
- Built-in rechargeable Li-ion battery, AC/DC power supply
- Well designed membrane keyboard

- Digital filtering, resisting baseline drift, AC and EMG interference
- Automatic baseline adjustment
- Auto/Manual work mode
- Lead-off detection and alarm



Carrying Bag

Rolling Stand

Especificaciones técnicas

uMEC10 Tamaño del monitor: 15.5" (39.2 cm) x 10.2" (25.9 cm) Peso: 1.5 kg (3.3 lb) (sin cables) Peso: 1.5 kg (3.3 lb) (con cables)		Parámetros Temperatura: 0.1°C a 37.5°C (32°F a 100°F) Presión arterial: 0.1 mmHg a 177.9 mmHg	
uMEC12 Tamaño del monitor: 15.5" (39.2 cm) x 10.2" (25.9 cm) Peso: 1.5 kg (3.3 lb) (sin cables) Peso: 1.5 kg (3.3 lb) (con cables)		uMEC12 (solo para uMEC12) Temperatura: 0.1°C a 37.5°C (32°F a 100°F) Presión arterial: 0.1 mmHg a 177.9 mmHg	
Pantalla Tipo: uMEC10: Pantalla LCD a color de 15.5" (39.2 cm) x 10.2" (25.9 cm) uMEC12: Pantalla LCD a color de 15.5" (39.2 cm) x 10.2" (25.9 cm) Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800 Panel táctil: uMEC10: 10 toques uMEC12: 10 toques		CO (solo para uMEC12) Temperatura: 0.1°C a 37.5°C (32°F a 100°F) Presión arterial: 0.1 mmHg a 177.9 mmHg	
ECG Compatibilidad: uMEC10: ECG de 12 derivadas uMEC12: ECG de 12 derivadas Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800		CO (solo para uMEC12) Temperatura: 0.1°C a 37.5°C (32°F a 100°F) Presión arterial: 0.1 mmHg a 177.9 mmHg	
Respiración Tipo: uMEC10: Respiración de 12 derivadas uMEC12: Respiración de 12 derivadas Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800		CO (solo para uMEC12) Temperatura: 0.1°C a 37.5°C (32°F a 100°F) Presión arterial: 0.1 mmHg a 177.9 mmHg	
Temperatura Tipo: uMEC10: Temperatura de 12 derivadas uMEC12: Temperatura de 12 derivadas Resolución: uMEC10: 1280 x 800 uMEC12: 1280 x 800		CO (solo para uMEC12) Temperatura: 0.1°C a 37.5°C (32°F a 100°F) Presión arterial: 0.1 mmHg a 177.9 mmHg	



uMEC Monitor para pacientes

Cómo eliminar los costos altos
de la atención médica de calidad



Mindray es una marca registrada o trademark owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.
© 2015 Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Exportar, copiar, reproducir, o cualquier otro uso sin el consentimiento escrito de Mindray es estrictamente prohibido.

mindray


mindray
healthcare within reach




Rendimiento avanzado

Con 25 años de experiencia de Mindray en el monitoreo de pacientes, los monitores para pacientes de la serie uMEC cubren las necesidades clínicas ofreciendo mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales. Cuando el monitoreo es confiable, usted puede estar más seguro al tomar decisiones clínicas.

- El Algoritmo ECG con derivaciones múltiples patentado de Mindray mejora enormemente la precisión de las mediciones y reduce falsas alarmas
- La técnica de medición rápida PNI disminuye el malestar provocado por la presión de inflado de la pulsera, especialmente en pacientes que sufren de hipertensión o hipotensión
- El algoritmo contra interferencia SpO₂ brinda una medición precisa incluso cuando el paciente está en movimiento
- La amplia capacidad para el almacenamiento de datos permite una revisión exhaustiva de la historia clínica del paciente; también admite dispositivos USB de almacenamiento externo
- 8 horas de funcionamiento con una batería de iones de litio



Mediciones fundamentales avanzadas



Enorme capacidad de datos



Batería de larga duración



De uso fácil

El monitor para pacientes fácil de usar uMEC ayuda a simplificar el flujo de trabajo y a mejorar la eficiencia. El monitor ofrece una interfaz muy intuitiva que facilita las aplicaciones de manera más rápida y sencilla, incluso para los usuarios nuevos. El personal de atención médica necesita menos tiempo para las capacitaciones y dedica más tiempo al cuidado de los pacientes.


- Pantalla LED de 10,4 pulgadas/12,1 pulgadas de alta resolución con pantalla táctil opcional
- Admite distintos diseños de la pantalla de monitoreo para diversas necesidades clínicas, incluyendo fuente de tamaño grande, pantalla completa/media, monitoreo de 7 derivaciones, vista de la otra cama, etc.
- Las configuraciones predeterminadas satisfacen los requisitos médicos generales, no es necesario ajustar las configuraciones antes del uso; ayuda a comenzar a usar el equipo rápidamente
- Estadísticas para cambios de la frecuencia cardíaca y para el control de la presión arterial ambulatoria, donde se muestran los valores altos y bajos
- El peso inferior a 3,5 kg con la batería permite transportar el equipo
- El gabinete exclusivo para accesorios permite el manejo eficiente de los mismos
- El diseño de una pieza facilita la limpieza



Análisis HR/BP



Interfaces fáciles de usar




Gabinete exclusivo para accesorios



Alta durabilidad

Para brindar eficiencia en distintos ambientes, uMEC ha superado pruebas de seguridad eléctrica y pruebas de confiabilidad estrictas. Es extremadamente duradero y tiene una larga vida útil.


- La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40°C y no es afectada por extremos
- Protección contra caídas de 0,75 m y resistencia al agua de IPX1
- Robusta cubierta de plástico que soporta el paso del tiempo y no se vuelve amarilla, es altamente resistente a la corrosión
- Bajo consumo de energía y diseño sin ventilador que lo transforma en un aparato ecológico y reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Los accesorios Mindray son altamente confiables y están fabricados con materiales y técnicas de calidad



Accesorios de alta calidad



Protección contra caídas



Compatible con múltiples agentes de limpieza





INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L DE C.V

Col. Kennedy 5ta entrada contiguo a maquilas, Complejo de Bodega Simón. Bod #3 Telefono. 22 28 50 21

Correo electronico: invequipos2014@hotmail.com

RTN:0801-9013-553050

COTIZACION N° 000207-2020

FECHA
3/6/2020

CLIENTE
Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo

DIRECCION
SAN LORENZO VALLE

CAI: 096B9D-67080E-BA4F90-042FF6-525A90-25

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	ISV S/N	TOTAL
1	1	C/U	Electrocardiógrafo Cardiovascular de 3 canales (Incluye 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	L. 27,000.00	SI	L. 27,000.00
			MARCA: ADVANCED			
			MODELO: ECG--3			
			GARANTIA: 2 AÑOS			
			ENTREGA: 25 DIAS			
2	4	C/U	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	L. 58,400.00	SI	L. 233,600.00
			MARCA: ADVANCED			
			MODELO: PM-2000M			
			GARANTIA: 2 AÑOS			
			ENTREGA: 25 DIAS			
			U.L.			
SUB TOTAL						260,600.00
ISV						39,090.00
TOTAL						299,690.00



TANIA BARAHONA
0708-1994-00177
DEPTO. DE ICITACIONES

ACEPTADO CLIENTE


[Handwritten signature]

electro- CARDIOGRAPH

ECG-3 Plus

Single/Three-channel ECG

- LCD display waveforms, parameters configurable
- Compatible with external printer for 12 leads simultaneous printing
- Interpretation database
- *Presentación de ondas de forma en LCD, parámetros configurables*
- *Compatible con impresoras externas para impresión de 12 derivaciones simultáneas*
- *Base de datos interpretativa*

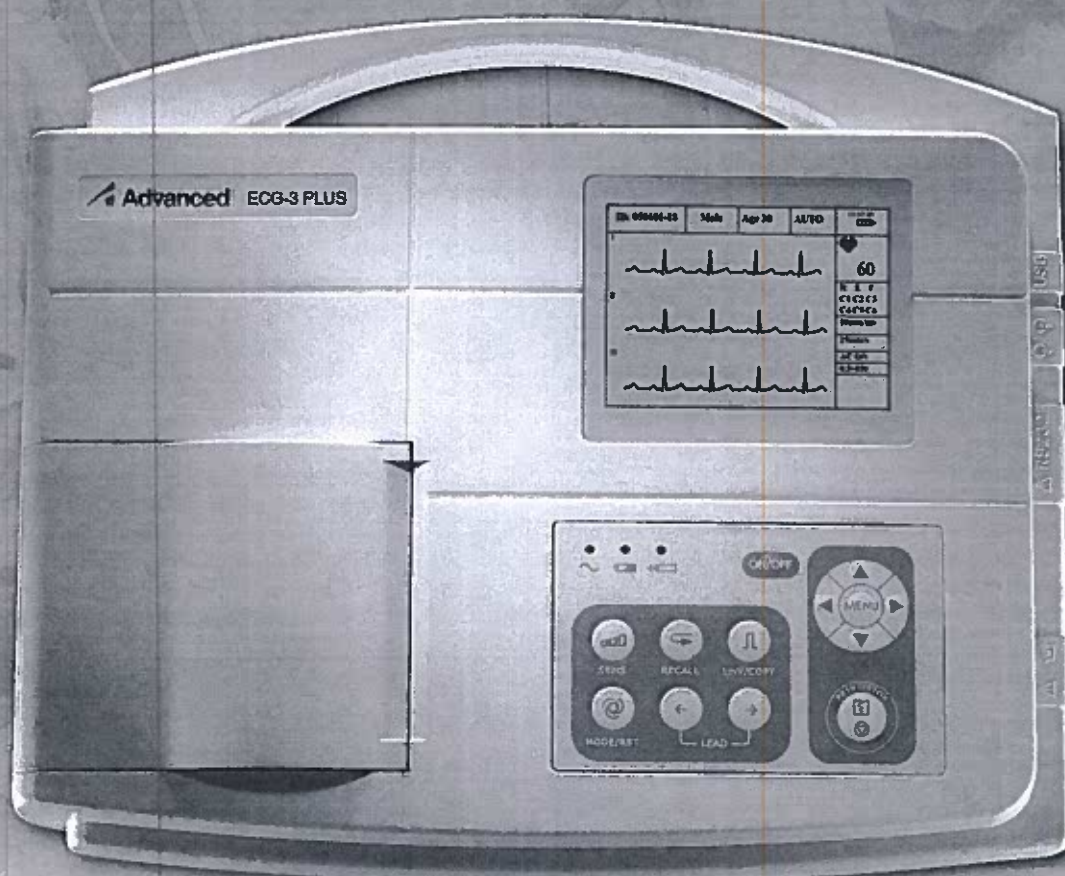

SB-ECG3PLUS
REV.01
MAY 2013

 **Advanced®**

ECG-3 PLUS ELECTROCARDIOGRAPH



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INPUT CIRCUIT	Floating input circuit, protection from defibrillation and pace maker	CIRCUITO DE ENTRADA	Circuito de entrada flotante, protección de desfibrilación y pace maker
LEAD	Standard 12 leads	DERIVACIONES	12 Derivaciones estándar
ACQUISITION MODE	Simultaneous 12 lead	MODO DE ADQUISICIÓN	12 derivaciones simultáneas
A/D CONVERTER	12 bits	CONVERTIDOR A/D	12 bits
MEASUREMENT RANGE	$\pm 5\text{mVp-p}$	RANGO DE MEDICIÓN	$\pm 5\text{mVp-p}$
TIME CONSTANT	$\geq 3.2\text{sec}$	CONSTANTE DE TIEMPO	$\geq 3.2\text{seg}$
FREQUENCY RESPOND	0.05Hz - 150Hz	RESPUESTA DE FRECUENCIA	0.05Hz - 150Hz
CALIBRATION VOLTAGE	1mV $\pm 3\%$	VOLTAJE DE CALIBRACIÓN	1mV $\pm 3\%$
SENSITIVITY	2.5, 5, 10, 20, 10 (mm/mV)	SENSIBILIDAD	2.5, 5, 10, 20, 10 (mm/mV)
INPUT IMPEDANCE	50M Ω	IMPEDANCIA DE ENTRADA	50M Ω
INPUT CIRCUIT CURRENT	$\leq 50\text{nA}$	CORRIENTE DE ENTRADA AL CIRCUITO	$\leq 50\text{nA}$
NOISE LEVEL	$< 15 \mu\text{Vp-p}$	NIVEL DE RUIDO	$< 15 \mu\text{Vp-p}$
ANTI BASELINE DRIFT	Automatic	ANTI BASE	Automático
PATIENT LEAKAGE CURRENT	$< 10 \mu\text{A}$ (220V - 240V)	FUGA DE CORRIENTE A PACIENTE	$< 10 \mu\text{A}$ (220V - 240V)
PATIENT AUXILIARY CURRENT	$< 0.1 \mu\text{A}$ (DC)	CORRIENTE AUXILIAR DEL PACIENTE	$< 0.1 \mu\text{A}$ (DC)
FILTERS	EMG filter 25Hz/35Hz/45Hz (-3dB)/OFF DFT Filter 0.05/0.25 Low-pass filter 75Hz/100Hz/150Hz AC Filter 50Hz/60Hz	FILTROS	Filtro EMG 25Hz/35Hz/45Hz (-3dB)/OFF Filtro DFT 0.05/0.25 Filtro paso-bajo 75Hz/100Hz/150Hz Filtro AC 50Hz/60Hz
CMRR	$> 110\text{dB}$	CMRR	$> 110\text{dB}$
RECORDING MODES	Auto: 3CH, 3/2CH, 3CH+1R, 1CH, 1CH+1R Manual: 3CH, 3/2CH, 1CH Rhythm: Single rhythm lead	MODOS DE GRABACIÓN	Auto: 3CH, 3/2CH, 3CH+1R, 1CH, 1CH+1R Manual: 3CH, 3/2CH, 1CH Ritmo: Derivación de ritmo unitario
RHYTHM LEAD	Any lead selectable	DERIVACIÓN DE RITMO	Cualquier derivación seleccionable
SAFETY STANDARD	IEC/ICF	SEGURIDAD ESTANDAR	IEC/ICF
POWER SUPPLY	AC (100-240V@50/60Hz)	FUENTE DE PODER	AC (100-240V@50/60Hz)
BATTERY	Rechargeable Li-Ion Battery, 2200mAh, 14.4V for 3 hours continuously operation	BATERÍA	Batería recargable Li-Ion, 2200 mAh, 14.4V para 3 horas de operación continua
RECORDER	Thermal printer	IMPRESORA	Impresora Térmica
RECORDING PAPER	80mm x 20mm	PAPEL DE IMPRESIÓN	80mm x 20mm
RECORDING SPEED	5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ($\pm 3\%$)	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ($\pm 3\%$)
WEIGHT	Approximately 2.5 kg (including battery and paper)	PESO	Aproximado 2.5 Kg (batería y papel incluido)
DIMENSIONS	288mm x 210mm x 70mm	DIMENSIONES	288mm x 210mm x 70mm
DISPLAY	320x240 dpi LCD	PANTALLA	320x240 dpi LCD
EXTERNAL INPUT	$> 100\text{K} \Omega$ sensitivity 10mm/V $\pm 5\%$	ENTRADA INTERNA	$> 100\text{K} \Omega$ sensibilidad 10mm/V $\pm 5\%$
EXTERNAL OUTPUT	100K Ω sensitivity 1V/mV $\pm 5\%$	ENTRADA EXTERNA	100K Ω sensibilidad 1V/mV $\pm 5\%$
COMMUNICATION PORT	Ethernet, RS232, USB	PUERTOS DE COMUNICACIÓN	Ethernet, RS232, USB

Contact us for additional information.

Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




Advanced
Instrumentations

6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166
Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351
sales@advanced-inst.com
www.advanced-inst.com



Patient Monitor PM-200M


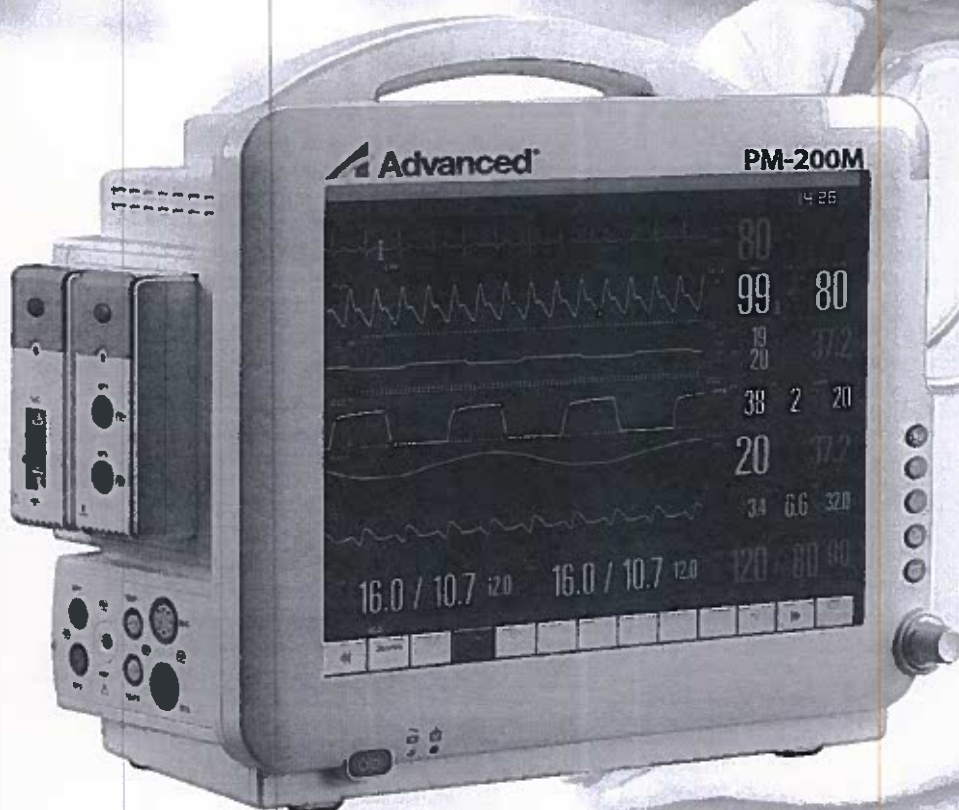


Patient Monitors

PM-200M

Patient Modular Monitor

The PM-200M is a full modular monitor designed to meet everyday clinical requirements, integrating seamlessly into the hospital work-flow. With its lightweight and plug-and-play modular design, its powerful functions and intuitive user interface, the PM-200M patient monitor is therefore the best choice for acute care.

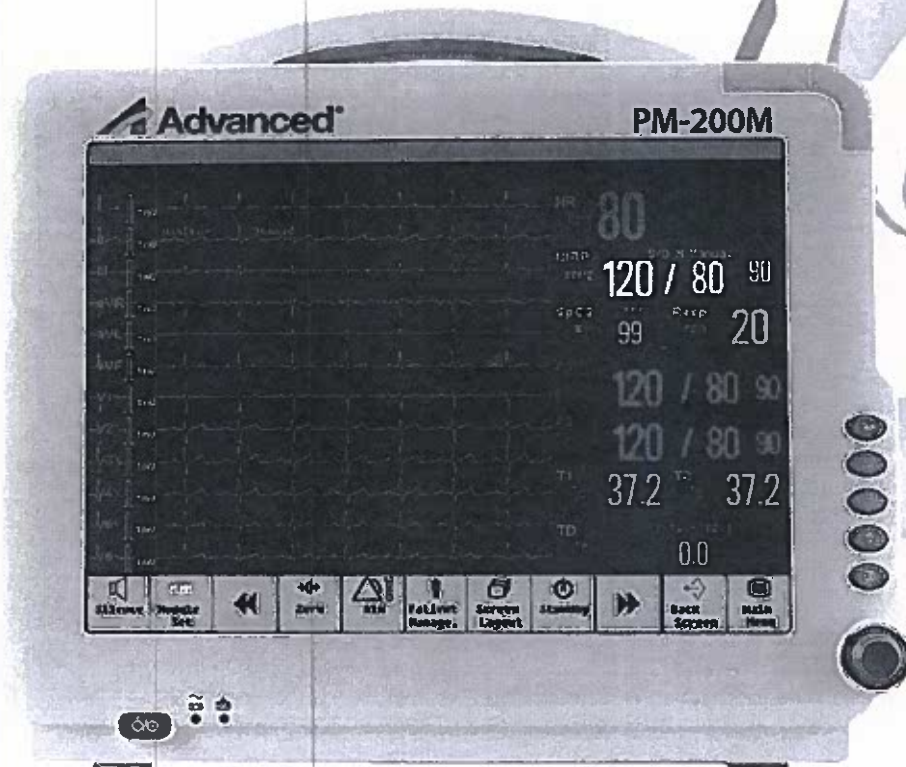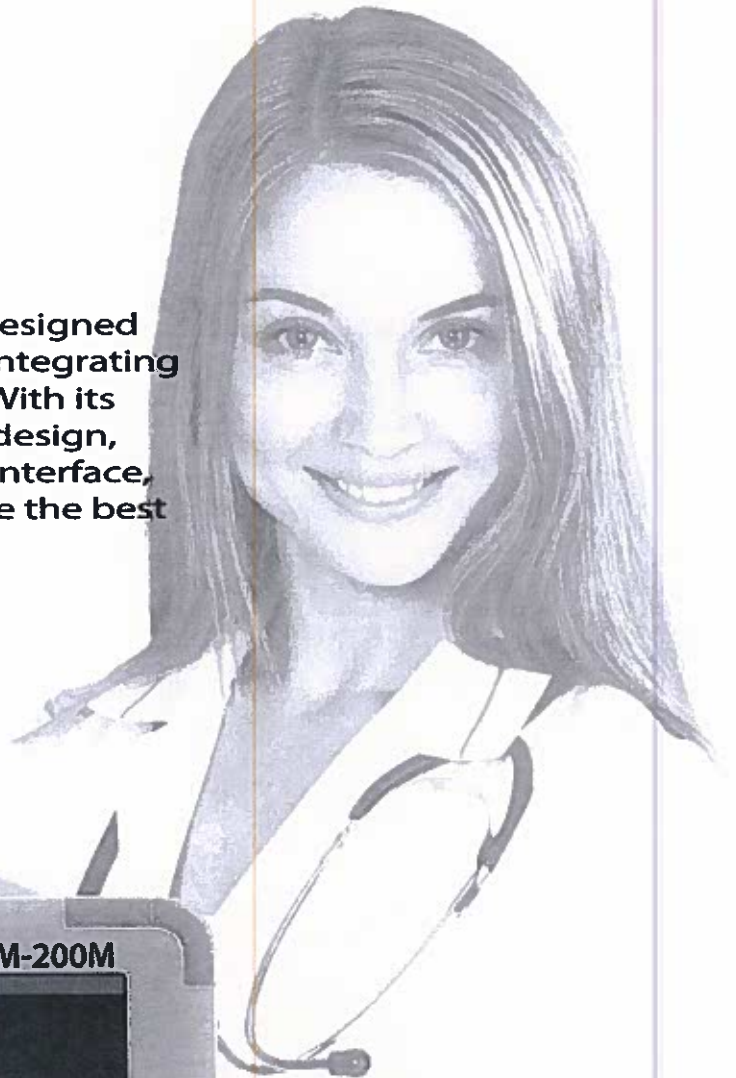

Handwritten signature

PM-200M

Patient Modular Monitor



12 lead ECG

Capture and review diagnostic 12-lead ECG waveform at one screen.



Short trend

Maximum 168 hour graphic and tabular trends




Other bed

Display other bedside monitor's all parameter and one waveform, support user defined parameter display



Oxy-CRG Screen

Oxy-cardiorespirography combines the compressed trends of heart rate, respiration, and oxygenation levels in an easy to interpret display. Oxy-CRG is an indicator of breathing efficiency and brain maturity

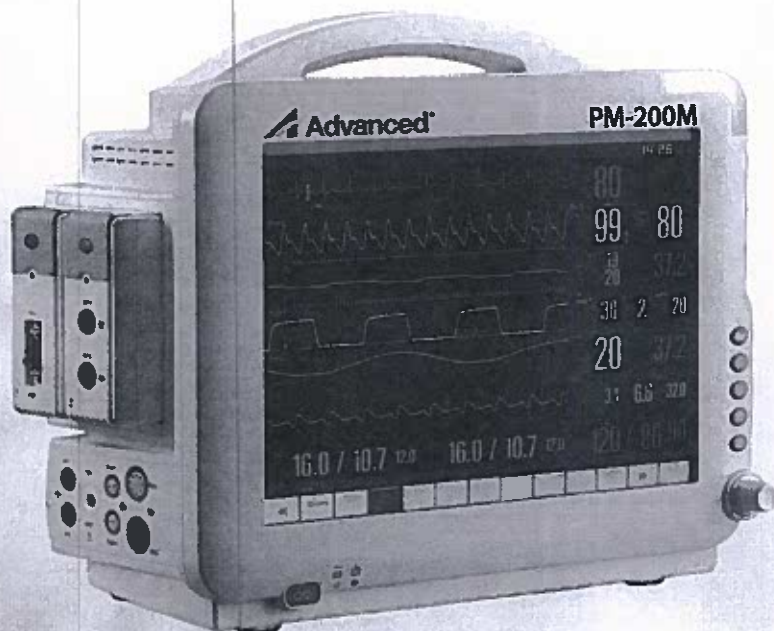

Signature

Technical Specifications

Size	318mm × 264mm × 152mm
Weight	4.5Kg
Power	
Standard According to IEC 60601-1 and IEC 60601-1-2	
Input voltage	100V-240V AC
Frequency	50Hz/60Hz
Earth leakage current	<0.3 mA
Input current	1.7A -0.8A
Fuse	T 2A/250V
Display	
Type	Color TFT LCD
Size(diagonal)	12.1 inch
Resolution	800×600 pixels
External display	
Type	Medical-Grade TFT display
Size	>15inch
Resolution	800×600 pixels
Recorder	
Type	Thermal dot array
Horizontal resolution	16 dots/mm(at 25 mm/s paper speed)
Vertical resolution	8 dots/mm
Recording speed	12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Recording waveform	Maximum 3 tracks
Recording way	Real-time / periodic / alarm recording
Battery	
Type	Rechargeable lithium ion battery 11.1V/4Ah
Operating time	> 210minutes
(1 new and fully charged battery at 25°C temperature, connecting SpO2 sensor & NIBP work on AUTO mode for 15 minutes interval)	
Charge time	6h to 100%(Standby)
Data Storage	
Alarm event	128 groups and associated waveform
Trend	168h, minimum resolution is 1min
ARR event	2h, minimum resolution is 5s
NIBP	128 groups and associated waveform
	1000 groups
Interfacing & I/O devices	
Keyboard & Mouse	Support
Barcode Scanner	Support 1D barcode (USB connector)
Touch screen	Option
Wired network	1 standard RJ45 interfaces
Wireless network	2.4G / 5G dual band (Option)
USB socket	2 sockets
Video output	1 VGA (option)
Nurse call	1 RJ11 connector
Analog signal output	Option
Defibrillation synchronization	1 BNC connector

[Handwritten signature]

[Handwritten text: 2014.10.15]

[Handwritten text: hce]

Technical Specifications

Environmental requirements

Operating temperature	5°C to +40°C
Operating humidity	15% to 85%(non condensing)
Operating air pressure	700hPa to 1060hPa
Storage temperature	-20°C to +55°C
Storage humidity	< 93%(non condensing)
Storage air pressure	500hPa to 1060hPa

ECG Lead

3 lead: I, II, III
5 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx
12 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6

Lead standard

AHA, IEC

Gain

x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4, Auto.

CMRR

Diagnostic mode ≥ 89 dB

Monitor mode ≥ 105 dB

Surgery mode ≥ 105 dB

Bandwidth (-3dB)

Diagnostic mode: 0.05 Hz to 150 Hz

Monitor mode: 0.5 Hz to 40 Hz

Surgery mode: 1 Hz to 25Hz

Input impedance

≥ 5.0 M Ω

ECG signal range

± 10.0 mV

Electrode offset potential

± 500 mV

Patient leakage current

< 10 μ A

System noise

≤ 30 μ Vpp (RTI)

Standardizing signal

1 mV $\pm 5\%$

Baseline recovery

Monitor mode: ≤ 3 s; Surgery mode: ≤ 1 s

Recovery time after defibrillation: waveform recover to baseline in 10s.

Sweep speed

6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

ST segment

Measurement Channels Calculating I, II, V- lead etc. at the same time

Default

II lead

Measurement range

-2.0 mV to +2.0 mV

Accuracy

-0.8 mV to +0.8 mV: ± 0.02 mV or $\pm 10\%$,

(whichever is greater)

Over ± 0.8 mV: unspecified

Resolution

0.01mV

Heart Rate

Measurement range

Adult 10 bpm to 300 bpm

Pediatric & Neonatal 10 bpm to 350 bpm

Accuracy

$\pm 1\%$ or ± 1 bpm, whichever is greater

Arrhythmia analysis

Kinds

ASYSTOLE, VENT FIB/TACH, PAC, RUN PVCs, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R on T, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, MULTIPACs, PNP, PNC, NOISE, VPB, ST HIGH, ST LOW, VTACH, PVCs HIGH.

Respiration

Lead

Selected from: I (RA-LA) or II (RA-LL)

Measurement range

0 rpm to 150 rpm

Sweep speed

6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s

Accuracy

± 2 rpm or $\pm 2\%$, whichever is the greater

Delay of apnea alarm

10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60s

Handwritten signature and notes on the right margin.

Technical Specifications

NIBP

Standard	IEC 80601-2-30
Measurement way	Automatic oscillometry
Measurement mode	Manual , Auto, STAT
Intervals for Auto measurement: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90min, 2/4/8/12h.	
STAT mode cycle time Keep 5 minutes, at 5 seconds interval.	
Systolic range	Adult 30 to 270 mmHg Pediatric 30 to 235 mmHg Neonatal 30 to 135 mmHg
Diastolic range	Adult 10 to 220 mmHg Pediatric 10 to 220 mmHg Neonatal 10 to 110 mmHg
Mean range	Adult 20 to 235 mmHg Pediatric 20 to 235 mmHg Neonatal 20 to 125 mmHg
Cuff pressure range	0 to 280 mmHg
Pressure accuracy	Static: ± 3 mmHg Clinic: Average error ± 5 mmHg, standard deviation: ≤ 8 mmHg
PR range	40 bpm to 240 bpm
Measurement time:	20s to 45s (depend on HR & moving interference)
Software overpressure protection	Adult (297 $\pm$ 3) mmHg Pediatric (252 $\pm$ 3) mmHg Neonatal (147 $\pm$ 3) mmHg

Digital SpO2

Measurement range	0% ~ 100%
Resolution Accuracy	1%
	70% ~ 100% $\pm 2\%$ 0%
	~ 69% unspecified

Perfusion index

Measurement range	0.05% o 20%
PR	
Measurement range	20 bpm to 250 bpm
Resolution	1 bpm
Accuracy	$\pm 1\%$ or ± 1 bpm, whichever is the greater


IBP (option)

Standard	EN 60601-2-34 / IEC 60601-2-34
Sensitivity of transducer	5uV/V/ mmHg, $\pm 2\%$
Impedance of transducer	300 Ω to 3000 Ω
Static measurement range	-50 mmHg to +300 mmHg
Static measurement accuracy	± 1 mmHg or $\pm 2\%$ of the reading, whichever is the greater (exclusive of transducer) ± 4 mmHg or $\pm 4\%$ of the reading, whichever is the greater (inclusion of transducer)
Dynamic measurement range	-50 mmHg to +350mmHg
Dynamic measurement accuracy	± 4 mmHg or $\pm 4\%$ of the reading whichever is the greater
Resolution	1 mmHg
Unit	mmHg, kPa, cmH2O
Frequency Response	0 Hz to 20 Hz
Kinds of Measurement	ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1/P2

Handwritten signature and initials

Technical Specifications

Temperature Standard	ISO80601-2-56
Measurement way	Thermal resistance way
Measurement range	0.0°C to 50.0°C (32°F to 122°F)
Accuracy	0.0°C-50.0°C: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (not including the probe) 25.0°C-45.0°C: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (including the probe) 0.1°C or 1°F
Resolution	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (including the probe) 0.1°C or 1°F
Unit	°C or °F
C.O (Option)	
Measurement Mode	Thermal dilution method
Measurement Wave	Thermal dilution curve
Parameters	C.O., TB, TI,
Measurement Range	C.O. : 0.1 L/min ~ 20 L/min TB: 23.0 ~ 43.0°C TI: -1.0 ~ 27.0°C
Resolution	C.O.: 0.1 L/min TB: 0.1°C TI: 0.1°C
Accuracy	C.O.: 2% SD TB, TI: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

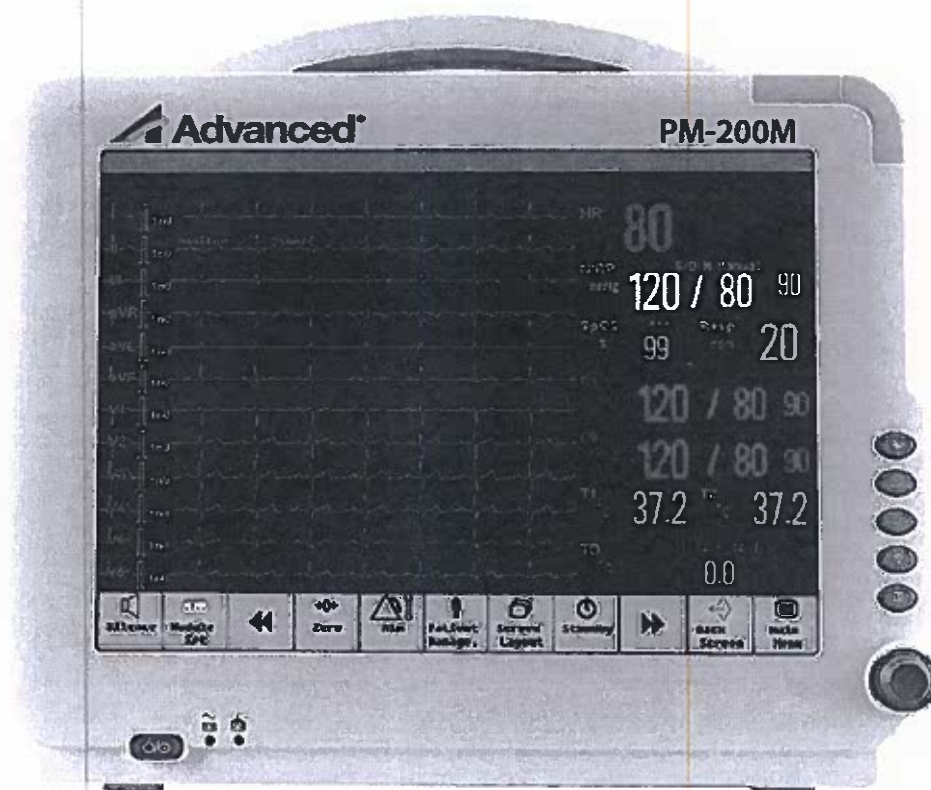

Handwritten signature and date:
 26/3
 [Signature]

2018 Advanced Instrumentations Inc. is a USA registered company -- All rights reserved.

All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation. Advanced Instrumentations reserves the right to make changes to this document and the product described herein, at any time, without obligation on Advanced Instrumentations to provide notification of such change. Actual description and specification of the product in this document may be different. Images shown here are for representational purpose only, actual may vary.


Advanced and Advanced Instrumentations trademarks and logos shown are property of Advanced Instrumentations Inc.

Success Through Quality/Since 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Success Through Quality,
a Company You Can Trust

Advanced Instrumentations manufactures leading medical technology equipment in the areas of anesthesia, cardiology, operating room, gynecology and obstetrics, IV therapy, patient monitors, hospital furniture, neonatology and ultrasound. We deliver to the healthcare industry the highest-quality standards, reliability, and patient safety in all our products through effective, and rigorous testing procedures by our own department of Biomedical Engineering in the United States. All of our equipment comes with 2 years warranty and excellent post-sale support services.


Advanced Instrumentations Inc. complies with the requirements of the ISO standards 13585-2016 following the audit by one of the most prestigious global certification companies, as it is the SGS. We comply with the requirements and are audited by the US Food and Drug Administration (FDA) an entity of the Health and Human Services of the United States of America. These certifications are the result of dedication and commitment to excellence in our products and services.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.

Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

For additional information visit us at:
www.advanced-inst.com

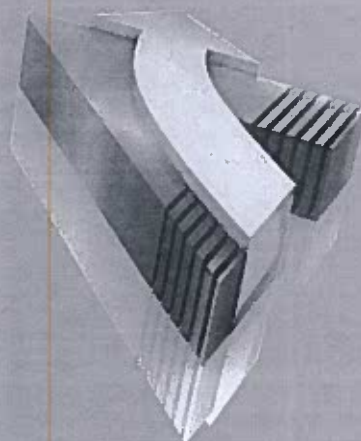

Handwritten signature



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortitelas y Keymart)
Edificio Dicosá #4002, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1970 al 73 Fax. 2221-1968, Pedidos. 2221-1967 al 74
email: info@dicosá.net www.dicosá.net

COTIZACION 018/2020

Cliente: Hospital San Lorenzo
Atención: Equipos varios
Referencia: esicra@hospitalсанlorenzo.com
e-mail: esicra@hospitalсанlorenzo.com

Fecha: 03 de Junio 2020

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	Nombre	DESCRIPCION	MARCA	CAT.	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIOS		
								UNITARIO	ISV	TOTAL
1	2	Unidad	Monitor de Signos Vitales	Monitor de Signos vitales, Sp2, ECG, temperatura, NIBP y accesorio, con camito	Edan	IM20	Inmediata a excepcion del carro en 20 dias	L. 40,000.00	si	HNL 80,000.00
2	2	Unidad	Monitor de Signos Vitales	Monitor de Signos vitales de transporte, Sp02, , temperatura, NIBP y accesorio, con carro	Edan	M3	Inmediata	L. 44,000.00	si	HNL 88,000.00
4	1	Unidad	Electrocardiografo de 3 canales	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES SE-301	Edan	SE-301	Inmediata	L. 22,900.00	si	HNL 22,900.00
OBSERVACIONES: Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. Estamos para Servirle!!!								SUB TOTAL	HNL	190,900.00
								15% I.S.V.	HNL	28,635.00
									HNL	219,535.00

Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: contra entrega
Validez de Cotización: 5 dias
Lugar de entrega: A definir por cliente



Cotizado por: Leyla Pavon
99783539
lpavon@dicosá.net

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!

EDANUSA
www.edanusa.com

SE-301

3-Channel ECG



SE-301
3-Channel ECG

About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Ultrasound imaging
- In-Vitro Diagnostics
- Patient Monitoring
- Point-of-Care Testing
- Veterinary
- OB/GYN

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



EDANUSA

4204 Jutland Drive,
Suite B, San Diego, CA 92117
Toll Free Phone Number:
888.850.4597

Care for Health

SE-301

3-Channel ECG

SE-301 is the new generation 3-channel ECG, which incorporates the benefits of the advanced technology and innovative design in an extremely compact and lightweight device. It is specifically developed for those who pursue superb portability without compromising on the quality for mobile environments. A variety of fantastic features are embodied in this amazing small unit, making it more than a basic 3 channel ECG.




Less than 1 kg



Full-touch Operation



One-button Operation

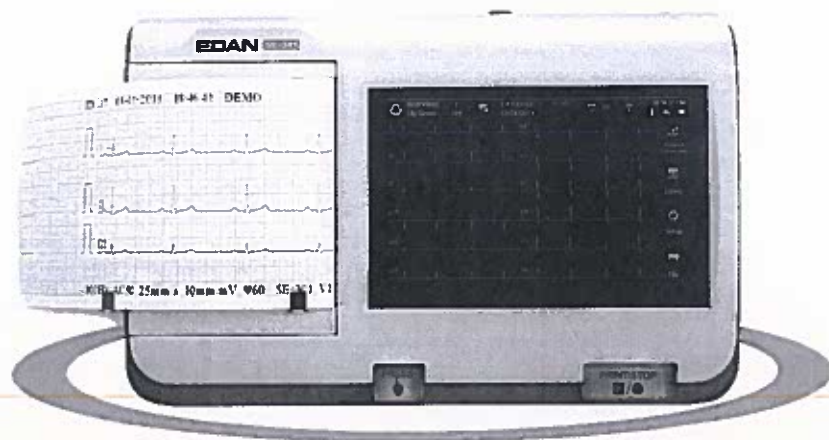

> Convenient Information Communication

Powerful External Device Support

The SE-301 is armed with two usb ports and one microSD card slot, which extends its capability by supporting various external devices such as a barcode scanner, external printer, USB memory drive or a microSD card.

Bi-directional Communication with Data Management System

Via the LAN or optional built-in Wi-Fi, SE-301 is able to receive orders from SE-1515 Data Management System and transmit ECG reports back to have further analysis, editing, saving or printing.

Multi-format Report (Optional)

The SE-301 is able to export ECG reports in standard PDF format and optional SCP, XML and DICOM format, which offers you greater capability in integrating the ECGs into different data management systems.



All for a reliable result

CMRR

A high Common Mode Rejection Ratio up to 140 dB restrains signal noises to the greatest extent, giving you excellent quality traces.

Bandwidth

A wide bandwidth from 0.01 to 300 Hz guarantees the accuracy of the ECG signal as well as the interpretation especially for pediatric patients.

Sampling Rate

The leading sampling rate as high as 16,000 Hz aims at capturing all the details to generate precise result.

Signal Quality Detection

By showing different colors to indicate normal, poor or missing signals, this function helps you to identify the signal quality even at a glance.

Reliable SEMIP® ECG Algorithm

SEMIP® ECG algorithm offers you an accurate and reliable reference to maximize clinician's confidence in making diagnosis.

SE-2003/SE-2012

Holter System



SE-2003/SE-2012

Holter System

About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Ultrasound imaging
- In-Vitro Diagnostics
- Patient Monitoring
- Point-of-Care Testing
- Veterinary
- OB/GYN

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



SE-2003/SE-2012

Holter System

EDAN Holter System offers you a lightweight and compact digital recorder, as well as fast and powerful analysis software. Optimized workflow and adjustable parameters aim to meet your different clinical needs.




The Holter Recorder reaches protection grade up to IP27, intending to prevent unexpected damages from water or dust, which maximizes patients' freedom in their daily life, even in their shower time. At the same time, it facilitates the cleaning and sterilization procedure.

Holter Recorder

- 3/12-channel digital recording
- Auto 3/12-channel identification (only SE-2012)
- OLED Screen with real-time waveform display
- Lightweight & Compact design: only 50 g
- Up to 8 days recording with one battery
- IP27 level of Waterproof & Dustproof
- Pacemaker detection
- Adjustable sampling rates



A common Holter analysis workflow always begins with the QRS Templates Analysis and ends up with the reporting. The most general functions are placed at the top toolbar to facilitate your workflow.

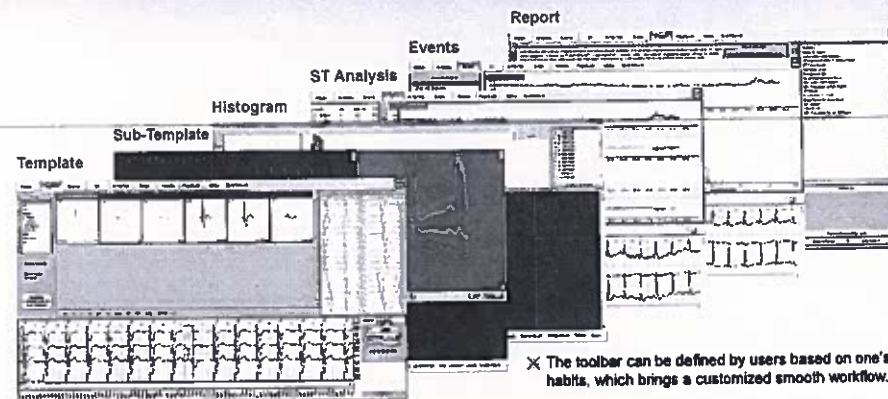

Holter Software

Data Processing

- Fast-loading: the loading time is less than 20 seconds
- Full disclosure of 24/48/96 hours and 8 days ECG data
- Download data via micro SD card or USB cable

Smooth Workflow

- User-define workflow
- Varied template categorizing with color codes
- Sub-template morphology classification
- Bulk modification and fast editing
- Comprehensive histogram
- ST segment analysis
- User-defined report contents and formats

Advanced Analysis

- Atrial Fibrillation/Flutter (A FIB/FLUT) analysis
- Heart Rate Variability (HRV) analysis
- Heart Rate Turbulence (HRT) analysis
- Obstructive Sleep Apnea (OSA) analysis


EMR Compatibility

- GDT/XML protocol support


Advanced Functions




Atrial Fibrillation/Flutter (A FIB/FLUT) analysis

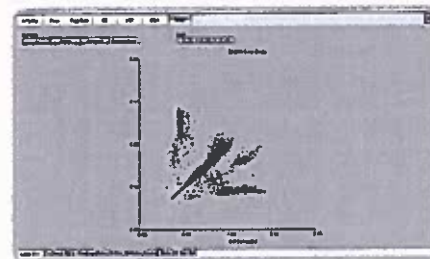

Heart Rate Variability (HRV) analysis

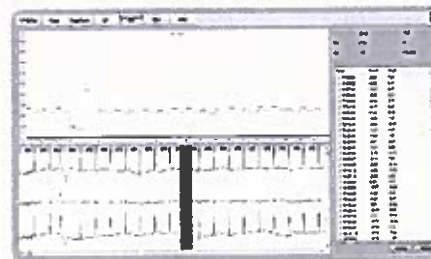

Heart Rate Turbulence (HRT) analysis

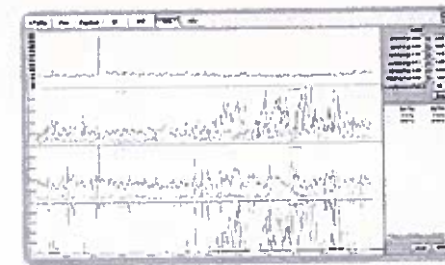

Obstructive Sleep Apnea (OSA) analysis

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

SE-1201 Electrocardiograph



SE-1201
Electrocardiograph



About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Patient Monitoring
- OB/GYN
- Ultrasound Imaging
- Point-of-Care Testing
- In-Vitro Diagnostics
- Veterinary

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



A world of potential

Global Headquarters:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com | info@edan.com.cn
U.S. and Canada Inquiries:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9918 Via Pajar, San Diego, CA 92126
+1.858.750.3066 | www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com



© Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Edan and its products are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries. Contact Edan for local availability.



SE-1201



12-Channel Electrocardiograph



Touch Screen



Portable Design



Seamless Connectivity



Hospital EMR/HIS/PACS

DICOM HL7



GDT-based

GDT



SE-1515 Data Management System



User-friendly Design

- 7" high resolution color touch screen
- Alphanumeric keyboard

Streamlined Workflow

- One-touch operation
- Support barcode scanner to simplify workflow

Accurate Clinical Performances

- Weak signal detection with the advanced 24-bit A/D converter technology
- Anti-noise technology with comprehensive filters and high CMRR over 140dB
- 120s real-time ECG waveform freezing and review to assist diagnosis
- The 0.01-300Hz bandwidth for pediatric patients according to AHA's recommendation
- The 16,000Hz sampling frequency maximizes the confidence in detecting pacemaker signal
- Built-in Glasgow ECG Interpretation

Flexible Printing Solutions

- Built-in high resolution thermal recorder
- Support external USB printer

Data Management

- Internal storage up to 800 ECGs and can be enlarged by USB flash disk and SD card
- Optional SE-1515 Data Management System to construct your ideal network solution
- Data transmission to PC via series port/LAN/built-in Wi-Fi
- Report formats: PDF and optional SCP/FDA/XML/DICOM data export



Rolling Stand



Network your ECG data with the help of EDAN SE-1515 Data Management System

- Bi-directional communication with ECG machines on workload and reports
- Cardiac consultation upon ECG reports over database sharing
- Multiple report formats output including PDF, XML, SCP, DICOM, JPG, BMP, and DOC
- Data access with HIS/EMR/PACS/CIS based on HL7/DICOM/GDT protocol

Handwritten signature and date: 2017

EDANUSA

www.edanusa.com

M3 Vital Signs Monitor



Outpatient



Transport



Ward



Portable
Design



Infrared Ear
Thermometer



Care for Health

M3

Vital Signs Monitor

Proven to be a durable and efficient solution for outpatients and general wards, the M3 brings effective vital signs monitoring to most ambulatory and regular healthcares.

- 5.6" high resolution color TFT-LCD screen
- Lightweight & portable design
- User-friendly interface
- Flexible configurations to meet different clinical needs
- Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
- Real-time measurements & trend display
- Built-in rechargeable Lithium-ion battery for 8 hours of continuous work
- USB flash disk support

30,000

NIBP Measurement Review

72 h


Trend Review

800


Alarm Review

- Barcode scanner support
- Bi-directional communication with MFM-CMS central monitoring system
- Compatible with PatientCare Viewer PC data management software
- Wired LAN/Wi-Fi support, HL7 support via XML files or MFM-CMS
- Nurse call
- Suitable for adult, pediatric and neonatal patients

Seamless Connectivity

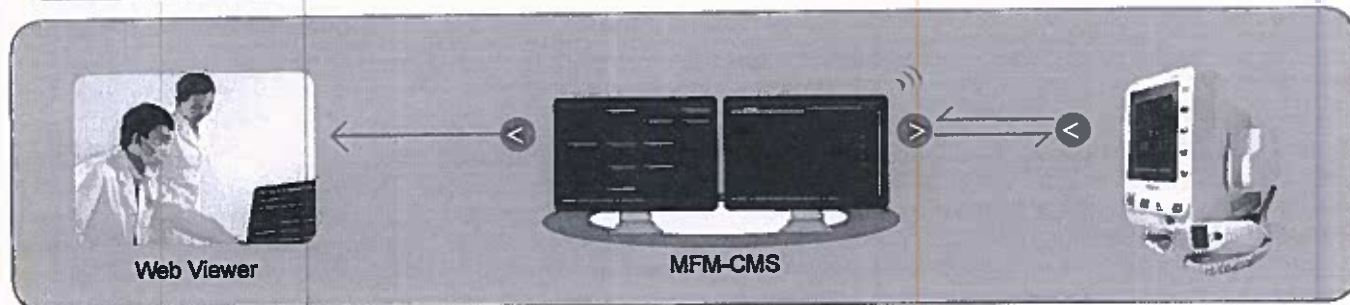

Mounting Solutions

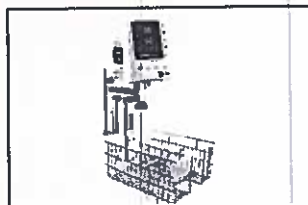

Wall Mount



Rolling Stand



Bed Rail Clamp

Specification

Configuration	SpO ₂	NIBP	Quick Temp	Infrared Ear Thermometer
M3 (SpO ₂ only)	✓	—	—	—
M3 (NIBP only)	—	✓	—	—
M3 (NIBP+Quick Temp)	—	✓	✓	—
M3 (NIBP+Infrared Ear Thermometer)	—	✓	—	✓
M3 (SpO ₂ +NIBP+Quick Temp)	✓	✓	✓	—
M3 (SpO ₂ +NIBP+Infrared Ear Thermometer)	✓	✓	—	✓

EDANUSA

4204 Jutland Drive,
Suite B, San Diego, CA 92117
Toll Free Phone Number:
888.850.4597

EDANUSA
www.edanusa.com



iM20
Patient Monitor

About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Ultrasound imaging
- In-Vitro Diagnostics
- Patient Monitoring
- Point-of-Care Testing
- Veterinary
- OB/GYN

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.

iM20

Patient Monitor



iM20 Transport Patient Monitor

Serves as both a transport monitor and a multi-parameter module for elite Series, iM20 provides a comprehensive and seamless monitoring solution both inside and outside hospital, connecting ambulatory cares to intensive cares.

Weighing less than 1.5kg with battery installed, iM20 is one of lightest transport monitor you can find on the market. Engineered strictly as to IP44 waterproof and dust proof standard, as well as a solid shock resistance performance, iM20 is suitable for patient transport in the harshest environments.

With its excellent power saving performance, iM20 requires no fan for heat expiration while the battery life is also extended for long term transport even without external power supply. In the meantime, the large non-fading built-in memory helps store the monitoring data during the whole transport session.

Though small and compact, iM20 does not only support basic parameters but also 2-channel IBP, expanding its usage for various medical cases.

The modern full-touch operation without physical buttons is unique on this kind of transport monitors, bringing user experience to a brand new level.

Unlike other conventional transport monitors on the market, iM20 comes with a built-on handle which does not need to be removed even when plugging into elite Series. On plug-and-play, iM20 switches role easily between a module and a monitor, connecting data together among different applications.

EDANUSA

4204 Julland Drive,
Suite 8, San Diego, CA 92117
Toll Free Phone Number:
888.850.4597

Care for Health

iM20


Patient Monitor



Serving as both multi-parameter module of elite V series monitors and transport monitor, iM20 provides a comprehensive and seamless monitoring solution both inside and outside hospital, connecting ambulatory cares to intensive cares.

Parameter Configurations

- iSEAP™ ECG algorithm optimized for arrhythmia detection, pacemaker detection, and HR measurement
- SEMIP® 12-lead diagnosis algorithm with 208 kinds of ECG findings in optional 12-lead ECG configuration
- iMAT™ SpO₂ algorithm with outstanding motion resistance and low perfusion resistance performance
- Signal Intensity (SI) measurement as blood perfusion indicator
- Optional Nellcor SpO₂ with SatSeconds™ technology
- iCUFFS™ NIBP algorithm optimized for cardiac patients, hypertensive patients, and neonatal patients
- Optional 2-channel invasive blood pressure with waveform overlapping function
- 2-channel temperature monitoring

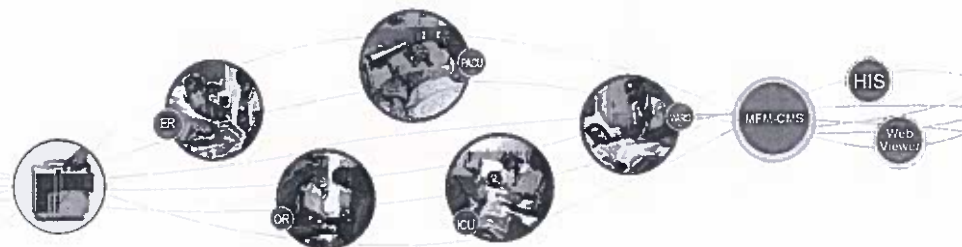

Built-in Temporary Memory



Ambulatory Designs



Designed as a robust transport monitor, iM20 is a solid companion in the harshest conditions.

- With IP44 water and dust protection, iM20 is outstanding for field medical practice, from regular emergency cares in rainy weather, to disaster controls with dusty environments.
- Designed with 1.2 meter shock resistance, unintentional falls and impacts shall not interrupt the monitoring, nor does the bumpy ride on rough road or hilly areas.
- With the ability to resist extreme temperature and altitudes, iM20 can be used in cold mountain areas as well as hot tropical places.



Handwritten signature

SE-1201 Electrocardiograph



SE-1201
Electrocardiograph



About Edan

Edan is a healthcare company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and services. For over 20 years, Edan has been pioneering a comprehensive line of medical solutions that address a broad range of healthcare practices including:

- Diagnostic ECG
- Patient Monitoring
- OB/GYN
- Ultrasound Imaging
- Point-of-Care Testing
- *In-Vitro* Diagnostics
- Veterinary

Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies and outstanding customer support.



A world of potential

Global Headquarters:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com | info@edan.com.cn
U.S. and Canada Inquiries:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9918 Via Pajar, San Diego, CA 92126
+1.858.750.3065 | www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com

CE 0123

© Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries. Contact Edan for local availability.

EDAN
A world of potential

SE-1201



12-Channel Electrocardiograph



Touch Screen



Portable Design



Seamless Connectivity



Hospital EMR/HIS/PACS

DICOM HL7



CD-ROM GDT-based

GDT



SE-1515 Data Management System



User-friendly Design

- 7" high resolution color touch screen
- Alphanumeric keyboard

Streamlined Workflow

- One-touch operation
- Support barcode scanner to simplify workflow

Accurate Clinical Performances

- Weak signal detection with the advanced 24-bit A/D converter technology
- Anti-noise technology with comprehensive filters and high CMRR over 140dB
- 120s real-time ECG waveform freezing and review to assist diagnosis
- The 0.01-300Hz bandwidth for pediatric patients according to AHA's recommendation
- The 16,000Hz sampling frequency maximizes the confidence in detecting pacemaker signal
- Built-in Glasgow ECG Interpretation

Flexible Printing Solutions


- Built-in high resolution thermal recorder
- Support external USB printer

Data Management

- Internal storage up to 800 ECGs and can be enlarged by USB flash disk and SD card
- Optional SE-1515 Data Management System to construct your ideal network solution
- Data transmission to PC via series port/LAN/built-in Wi-Fi
- Report formats: PDF and optional SCP/FDA-XML/DICOM data export



Rolling Stand

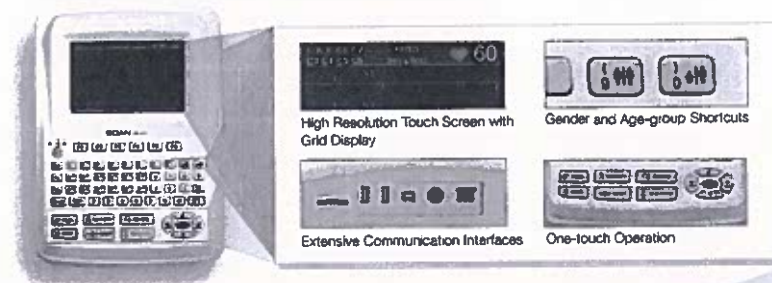

Network your ECG data with the help of EDAN SE-1515 Data Management System

- Bi-directional communication with ECG machines on worklist and reports
- Cardiac consultation upon ECG reports over database sharing
- Multiple report formats output including PDF, XML, SCP, DICOM, JPG, BMP, and DOC
- Data access with HIS/EMR/PACS/CIS based on HL7/DICOM/GDT protocol



Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:32

Para: Leyla Pavon <lpavon@dicosa.net>, Yessica Mendez <ymendez@dicosa.net>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "DISTRIBUIDORA COMERCIAL"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:57

Para: "INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L." <INVEQUIPOS2014@hotmail.com>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "INVERSIONES Y EQUIPO"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo.**

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 12:09

Para: Cinthia Velasquez <c.velasquez@nostrapharma.org>

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "NOSTRAPHARMA"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 11:49

Para: baudilio@simedic.hn

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "SIMEDIC"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

1 mensaje

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>
 Para: "AMESYS, S.A." <amesys17@yahoo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:41

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "AMESY"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo**.

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608





Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO

Emerson Sierra <esierra@hospitalsanlorenzo.com>

3 de junio de 2020 a las 10:34

Para: jaguilar@dimexmedica.com

BUEN DÍA ESTIMADOS SEÑORES: "DIMEX MÉDICA"

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo les invita a participar y presentar Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO"**

Por lo que solicitamos muy amablemente nos puedan enviar Cotización Formal a nombre de **LA Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo.**

Especificaciones de los Equipos:

No. Item	Cantidad	Descripción del Producto	Tiempo Entrega Requerido	Observación
1	1	Electrocardiógrafo Cardiovascular (Mínimo 3 Canales)(Incluir 10 Unidades de Papel para el Electrocardiógrafo)	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto
2	4	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Entrega Inmediata	Enviar Ficha Técnica del Producto

Quedamos atentos de recibir la Cotización a la brevedad posible,

Atentamente,

Licdo. Emerson Sierra
Jefe Logística y Suministros
Hospital San Lorenzo, Valle
Tel: +504 9443-2608



FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO

Colonia Morazán San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781- 11-58

Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios

Departamento/Unidad/Servicio/Sala/ Solicitante:	Fecha de Elaborada la solicitud
SALA DE COVID-19	02-jun-20
Dirigida A:	Fecha de Recibida
DIRECCIÓN EJECUTIVA	

No.	Descripción del Bien/Servicio (Especificaciones Técnicas)	Presentación (Tipo de Unidad)	Cantidad Solicitada
1	Electrocardiografo Cardiovascular (Mímimo 3 Canales) (Incluir 10 unidades de Papel para Electrocardiografo)	Unidad	1 ✓
2	Monitor de Signos Vitales de Transporte Adulto	Unidad	4 ✓
	*****U.L.*****		

Justificación: Se esta solicitando de manera urgente los Equipos antes mencionados para la Sala de Covid del Hospital San Lorenzo, equipo que será utilizado para la debida y pronta atención de los pacientes que son atendidos en este centro hospitalario por haber adquirido el Virus Covid-19, cabe mencionar que el equipo solicitado es indispensable para la evaluación diagnostica del paciente.

SOLICITANTE

Nombre y Apellido:

Carlos Arturo Ramos

Firma y Sello del Solicitante:

Línea Presupuestaria Aprobada por Gestion Financiera

Nombre y Apellido: Lic. Miriam Reyes

Fecha , Firma y Sello:

Observacion:

Vo.Bo. Dirección Ejecutiva

Nombre y Apellido: Lic. Rosa Maria Carcamo

Fecha , Firma y Sello:

GRUPO DEL GASTO:

OBJETO DEL GASTO:

